

ROTANTA 460 /460 R/ 460 RC / 460 RF



Inhalt des Dokuments / content of the document

Ръководство за употреба (BG)

Instrucțiuni de folosire (RO)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

Ръководство за употреба

ROTANTA 460 /460 R/ 460 RC / 460 RF



Превод на оригиналното ръководство за употреба



©2023 - Всички права запазени

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstrasse 12

D-78532 Тутлинген/Германия

Телефон: +49 (0)7461/705-0

Факс: +49 (0)7461/705-1125

e-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Интернет: www.hettichlab.com

Съдържание

1	За този документ.	6
1.1	Употреба на този документ.	6
1.2	Указание за използваните родове.	6
1.3	Символи и обозначения в този документ.	6
2	Безопасност.	6
2.1	Предназначение.	6
2.2	Изисквания към персонала.	7
2.3	Отговорност на оператора.	8
2.4	Указания за безопасност.	8
3	Преглед на устройството.	11
3.1	Технически данни.	11
3.2	Европейска регистрация.	17
3.3	Важни табелки на опаковката.	17
3.4	Важни табелки на устройството.	18
3.5	Елементи за обслужване и индикация.	19
3.5.1	Управление.	19
3.5.2	Индикаторни елементи.	19
3.5.3	Елементи за обслужване.	20
3.6	Оригинални резервни части.	22
3.7	Обхват на доставката.	22
3.8	Връщане.	23
4	Транспорт и съхранение.	23
4.1	Условия за транспорт и съхранение.	23
4.2	Закрепване на транспортна осигуровка.	24
5	Пускане в експлоатация.	27
5.1	Разопаковане на центрофугата.	27
5.2	Отстраняване на транспортната осигуровка.	29
5.3	Разполагане и свързване на центрофугата.	31
5.4	Включване и изключване на центрофугата.	33
6	Обслужване	34
6.1	Отваряне и затваряне на капака.	34
6.2	Демонтаж и монтаж на ротора.	35
6.3	Поставяне и снемане на носачи.	36
6.4	Поставяне и сваляне на адаптер.	36
6.5	Зареждане.	37
6.6	Отваряне и затваряне на система за биобезопасност.	39
6.6.1	Пояснение.	39
6.6.2	Капак с винтово затваряне и отвор	40
6.6.3	Капак със скоба и затваряне с обтегач.	40
6.6.4	Капак с винтово затваряне.	41
6.6.5	Капак със затваряне с обтегач	41
6.7	Инструкция за опаковане HettLiner.	42

6.8	Центрофугиране.	44
6.8.1	Центрофугиране с продължителна работа.	44
6.8.2	Центрофугиране с предварителен избор на време.	44
6.8.3	Краткотрайно центрофугиране.	45
6.8.4	Промяна на настройки по време на центрофугиране.	45
6.9	Функция бързо спиране.	45
7	Обслужване на софтуера.	46
7.1	Параметър на центрофугиране.	46
7.1.1	Параметри на пускане и спиране.	46
7.1.2	Време на работа TIME.	47
7.1.3	Обороти RPM.	48
7.1.4	Интегрално RCF.	48
7.1.5	Температура (при центрофуги с охлаждане).	49
7.1.6	Относително ускорение на центрофугата RCF.	49
7.1.7	Относително ускорение на центрофугата RCF и радиус на центрофугиране RAD.	49
7.1.8	Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm ³	50
7.2	Програмиране.	50
7.2.1	Защита срещу запис за програмите.	50
7.2.2	Изберете или заредете програма.	50
7.2.3	Въвеждане или промяна на програма.	51
7.2.4	Автоматична междинна памет.	51
7.3	Разпознаване на ротора.	51
7.4	Охлаждане (при центрофуги с охлаждане).	52
7.4.1	Указания за охлаждане.	52
7.4.2	Охлаждане в режим на готовност.	52
7.4.3	Предварително охлаждане на ротора.	52
7.4.4	Забавено охлаждане.	53
7.4.5	Предотвратяване на включване на охлаждането по време на спиране.	53
7.4.6	Мониторинг на температурата.	54
7.5	Отопление (при центрофуги с отопление).	54
7.6	Машинно меню.	55
7.6.1	Запитване за системна информация.	55
7.6.1.1	Адрес на центрофугата.	56
7.6.2	Брояч на циклите.	56
7.6.3	Запитване на работните часове, циклите на центрофугиране и брояча на цикли.	58
7.6.4	Активиране или деактивиране на Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето).	59
7.6.5	Активиране или деактивиране на степени на спиране В.	60
7.6.6	Активиране или деактивиране на времената на пускане и времената на спиране.	60
7.6.7	Заклучване на програма.	61

7.6.8	PIN (персонален идентификационен номер).	62
7.6.9	Звуков сигнал.	63
7.6.9.1	Обща информация.	63
7.6.9.2	Активиране или деактивиране на звуковия сигнал. . .	63
7.6.10	Показани данни за центрофугиране след включване.	64
7.6.11	Настройка на температурата (при центрофуги с охлаждане)	64
7.6.12	Фоново осветление на индикацията.	65
7.7	Програмни връзки.	66
7.7.1	Свързване на програми или промяна на програмна връзка.	66
7.7.2	Извикване на програмна връзка.	67
7.7.3	Активиране или деактивиране на програмни връзки.	67
8	Почистване и полагане на грижи.	67
8.1	Таблица за преглед.	67
8.2	Указания за почистване и дезинфекция.	68
8.3	Почистване.	69
8.4	Дезинфекция.	70
8.5	Поддръжка.	71
9	Отстраняване на неизправности.	72
9.1	Описание на грешката.	72
9.2	Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ.	75
9.3	Аварийно деблокиране.	75
9.4	Включване на предпазния автомат	76
10	Изхвърляне.	76
10.1	Общи указания.	76
11	Индекс.	78

1 За този документ

1.1 Употреба на този документ

- Преди да използвате устройството за първи път, прочетете този документ напълно и внимателно.
Ако е необходимо, обърнете внимание на приложените допълнителни информационни листове.
- Този документ е част от устройството и трябва да се съхранява на леснодостъпно място.
- Приложете този документ, когато предавате устройството на трети страни.
- Актуалната версия на документа на наличните езици можете да намерите на уебсайта на производителя: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

1.2 Указание за използваните родове

Използваният мъжки или женски род се употребява за по-лесна четливост. По отношение на равното третиране, съответните понятия се отнасят за всички полове и не предполагат оценка.

1.3 Символи и обозначения в този документ

Общи символи

Следните маркировки се използват в този документ за подчертаване на инструкции, резултати, списъци, препратки и други елементи:

Обозначение	Пояснение
1.  2.  3.  ... 	Инструкции за действие стъпка по стъпка
	Резултати от действията стъпка по стъпка
	Препратки към раздели на документа и към други приложими документи
■ ... ■ ...	Списъци без определен ред
[Бутон]	Елементи за обслужване (например: бутони, превключватели)
„Индикация“	Индикаторни елементи (например: сигнални светлини, елементи на екрана)

2 Безопасност

2.1 Предназначение

Предназначение

Това устройство е лабораторна центрофуга, подходяща за медицински приложения.

Нейната изключителна терапевтична цел е да центрофугират кръв в системи с кръвни торбички. Отделените кръвни съставки се прехвърлят от друго устройство (сепаратор) в съответните сателитни торбички. Отделните компоненти, получени по този начин, след това се използват за трансфузия или автотрансфузия.

Центрофугата може да бъде използвана само от специализиран персонал в пунктове за кръводаряване или болници

Центрофугата е предназначена само за посочените по-горе цели на употреба.

Всяка друга употреба или употреба извън тази се счита за неправилна. Andreas Hettich GmbH & Co. KG не носи отговорност за щети, произтичащи от това.

Към употребата по предназначение спада също съблюдаването на всички указания от ръководството за употреба и спазването на изискванията за проверка и интервалите за техническо обслужване.

Употреба не по предназначение

- Центрофугата не е подходяща за използване в потенциално експлозивни, радиоактивни, биологично или химически замърсени атмосфери.
- При центрофугиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.
Производителят обикновено препоръчва използването само на центрофужни епруветки със специални винтови капачки за опасни вещества. При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Производителят не препоръчва центрофугиране с възпламеняеми или експлозивни материали.
- Производителят не препоръчва центрофугиране с материали, които реагират химически с висока енергия.

Предвидима погрешна употреба

В рамките на предназначението производителят препоръчва да се използват само одобрени от него аксесоари.

Работете с центрофугата само под наблюдение.

2.2 Изисквания към персонала

Необходими квалификации

Потребителят е прочел изцяло инструкциите за употреба и се е запознал с устройството.



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството от неупълномощен персонал

- Интервенциите и промените на устройствата от неупълномощени лица са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.

Обучен потребител

Потребителят е образован или обучен в лабораторната област и е в състояние да изпълнява възложената му работа и самостоятелно да разпознава и избягва възможните опасности.

Лична предпазна екипировка

Липсата или неподходящата лична предпазна екипировка увеличава риска от увреждане на здравето и наранявания.

- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е в изрядно състояние.
- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е адаптирана към човека (напр. по размер).
- Спазвайте указанията за друга предпазна екипировка при специфични дейности.

2.3 Отговорност на оператора



За правилно и безопасно използване на устройството следвайте инструкциите в този документ.

Запазете ръководството за употреба за по-късна справка.

Предоставяне на информация

- Следването на инструкциите в този документ ще помогне:
 - за избягване на опасни ситуации.
 - за намаляване на разходите за ремонт и престоеите.
 - за увеличаване на надеждността и дълготрайността на устройството.
- Операторът е отговорен за спазването на експлоатационните предписания, стандарти и националното законодателство.
- Отбележете и запазете редакцията на документа отделно от документа. При загуба документът може да бъде заменен в правилната редакция.
- Съхранявайте ръководството за употреба на разположение на мястото на използване на устройството.
- Ако устройството бъде продадено, предайте ръководството за употреба на купувача.

Инструктиране на персонала

Поради липсата на знания при работа с устройството може сериозно да бъдат наранени или убити хора.

- Инструктирайте персонала в съответствие с ръководството за техните задачи и свързаните с тях рискове.

2.4 Указания за безопасност



Доклади за сериозни събития и произшествия, подлежащи на докладване

В случай на сериозни инциденти или произшествия с устройството или неговите принадлежности, които изискват докладване, те трябва да бъдат докладвани на производителя и, ако е необходимо, на компетентния орган, в който е установен потребителят и/или пациентът.



ОПАСНОСТ

Риск от замърсяване за потребителя поради недостатъчно почистване или неспазване на указанията за почистване.

- Спазвайте указанията за почистване.
- При почистване на устройството носете лична предпазна екипировка.
- Спазвайте лабораторните разпоредби (напр. TRBA, IfSG, хигиенен план) за работа с биологични агенти.



ОПАСНОСТ

Опасност от пожар и експлозия поради опасни вещества в пробите.

- Спазвайте съответните разпоредби и указания за работа с химикали и опасни вещества.
- Не използвайте агресивни химикали (например: опасни, корозивни екстрахиращи средства като хлороформ, силни киселини).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности поради недостатъчна или несвоевременно проведена поддръжка.

- Спазвайте интервалите за поддръжка.
- Проверявайте устройството за видими повреди или недостатъци.
При видими повреди или недостатъци извеждайте устройството от експлоатация и информирайте сервизния техник.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар поради проникване на вода или други течности.

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не изливайте никакви течности във вътрешността на устройството.
- Извършвайте транспортиране с оригиналната опаковка.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Замърсяване с опасни вещества или смеси от вещества!**

В случай на вещества и смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни и/или замърсени с патогенни микроорганизми, спазвайте следните мерки:

- По принцип използвайте само центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Без използване на система за биологична безопасност, устройството не е микробиологично херметично по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.
- При необходимост се свържете с производителя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Опасност от нараняване и повреди на устройството поради разхлабен ротор.**

- Когато монтирате ротора, водачът на вала на ротора трябва да лежи правилно в жлеба на ротора.
- Затегнете на ръка гайката за закрепване на ротора.
- Проверете ротора за добро затягане.
- Спазвайте интервалите за поддръжка.

**ВНИМАНИЕ****Опасност от нараняване поради въртящ се ротор**

Ако роторът се движи ръчно, дълга коса и дрехи могат да бъдат захванати от ротора.

- Привързвайте дългата коса.
- Не допускайте дрехи да висят в камерата на центрофужната.

**УКАЗАНИЕ****Повреди на електрониката на устройството поради грешно напрежение или честота на защитния прекъсвач на устройството.**

- Използвайте устройството с правилни мрежово напрежение и мрежова честота.
Стойността трябва да се намери в техническите данни и на фирмената табелка.

**УКАЗАНИЕ**

Повреди на устройството и пробите поради преждевременно прекъсване на програмата.

Програмата може да бъде прекъсната преждевременно, ако има прекъсване на електрозахранването, машината бъде изключена, докато програмата работи, или щепселът бъде изваден от контакта.

- Не изключвайте устройството по време на изпълнение на програма.
- Не освобождавайте аварийно устройството по време на изпълнение на програма.
- По време на изпълнение на програма не изваждайте щепсела от контакта.

3 Преглед на устройството

3.1 Технически данни

Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген	
Модел	ROTANTA 460	
Тип	5650	5650-01
Мрежово напрежение (±10%)	200-240 V 1~	100-127 V 1~
Мрежова честота	50-60 Hz	50-60 Hz
Присъединителна стойност	1000 VA	1100 VA
Консумация на ток	5,0 A	11,0 A
макс. капацитет	4 x 1000 ml	
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm ³	
макс. обороти (об./мин.)	15000	
макс. ускорение (RCF)	24400	
макс. кинетична енергия	41000 Nm	
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да	
Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):		
Място на инсталиране	само на закрито	
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище	

Околна температура	2 °C до 35 °C			
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.			
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II			
Степен на замърсяване	2			
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взривоопасна среда.			
EMC:				
Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас B		FCC Клас B	
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤68 dB(A)			
Размери:				
Широчина	554 mm			
Дълбочина	706 mm		715 mm	
Надморска височина	456 mm			
Тегло	прибл. 101 kg		прибл. 111 kg	
Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген			
Модел	ROTANTA 460 R			
Тип	5660 5660-50	5660-20 5660-70	5660-07	5660-77
Мрежово напрежение (±10%)	200-240 V 1~		200-240 V 1~	
Мрежова честота	50 Hz		60 Hz	
Присъединителна стойност	1800 VA		1900 VA	
Консумация на ток	8,5 A		9,2 A	
Хладилен агент	R452A			
макс. капацитет	4 x 1000 ml			
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm ³			

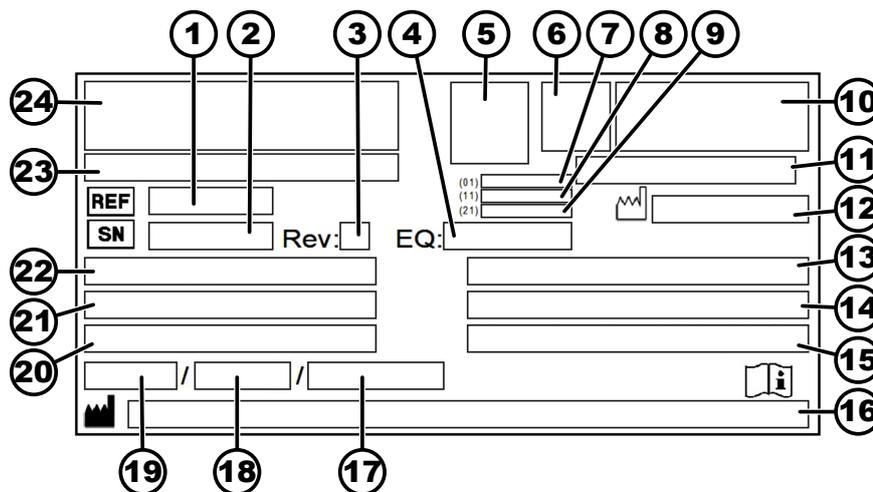
макс. обороти (об./мин.)	15000			
макс. ускорение (RCF)	24400			
макс. кинетична енергия	51000 Nm			
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да			
Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):				
Място на инсталиране	само на закрито			
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище			
Околна температура	5 °C до 35 °C			
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.			
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II			
Степен на замърсяване	2			
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взривоопасна среда.			
EMC:				
Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас B			
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤66 dB(A)			
Размери:				
Широчина	770 mm			
Дълбочина	706 mm	723 mm	706 mm	723 mm
Надморска височина	456 mm	481 mm	456 mm	481 mm
Тегло	прибл. 141 kg			
Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген			
Модел	ROTANTA 460 R		ROTANTA 460 RC	
Тип	5660-01 5660-51		5670 5670-50	

Мрежово напрежение (±10%)	100-127 V 1~	100 V 1~	200-240 V 1~
Мрежова честота	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Присъединителна стойност	макс. 2000 VA		1800 VA
Консумация на ток	-		8,5 A
Хладилен агент	R452A		
макс. капацитет	4 x 1000 ml		
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm ³		
макс. обороти (об./мин.)	15000		
макс. ускорение (RCF)	24400		
макс. кинетична енергия	51000 Nm		
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да		
Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):			
Място на инсталиране	само на закрито		
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище		
Околна температура	5 °C до 35 °C		
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.		
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II		
Степен на замърсяване	2		
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взривоопасна среда.		
EMC:			
Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	FCC Клас B		EN / IEC 61326-1 Клас B
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤66 dB(A)		≤68 dB(A)
Размери:			

Широчина	7700 mm	554 mm
Дълбочина	715 mm	697 mm
Надморска височина	456 mm	683 mm
Тегло	прибл. 151 kg	прибл. 140 kg
Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген	
Модел	ROTANTA 460 RF	
Тип	5675 5675-50	5675-01 5675-51
Мрежово напрежение (±10%)	200-240 V 1~	100-127 V 1~ 100 V 1~
Мрежова честота	50 Hz	60 Hz 50 Hz
Присъединителна стойност	1800 VA	макс. 2000 VA
Консумация на ток	8,5 A	
Хладилен агент	R452A	
макс. капацитет	4 x 1000 ml	
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm ³	
макс. обороти (об./мин.)	15000	
макс. ускорение (RCF)	24400	
макс. кинетична енергия	51000 Nm	
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да	
Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):		
Място на инсталиране	само на закрито	
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище	
Околна температура	5 °C до 35 °C	
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.	
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II	

Степен на замърсяване	2	
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взривоопасна среда.	
EMC:		
Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас B	FCC Клас B
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤68 dB(A)	
Размери:		
Широчина	554 mm	
Дълбочина	697 mm	
Надморска височина	961mm	
Тегло	прибл. 164 kg	прибл. 174 kg

Фирмена табелка



Фиг. 1: Фирмена табелка

- 1 Артикулен номер
- 2 Сериен номер
- 3 Редакция
- 4 Номер на оборудването
- 5 Datamatrix код
- 6 евент. Обозначение на медицинското изделие или ин витро диагностиката
- 7 Глобален търговски номер на изделието (GTIN)
- 8 Дата на производство
- 9 Сериен номер
- 10 евент. ЕАС маркировка, СЕ маркировка
- 11 Страна на производство
- 12 Дата на производство
- 13 Мрежова честота
- 14 Максимална кинетична енергия
- 15 Максимално допустимо относително тегло

- 16 Адрес на производителя
- 17 евент. Налягане на кръга на хладилния агент
- 18 евент. Количество на пълнене на хладилния агент
- 19 евент. Тип на хладилния агент
- 20 Обороти в минута
- 21 Стойности на производителността
- 22 Мрежово напрежение
- 23 евент. Обозначение на устройството
- 24 Лого на производителя

3.2 Европейска регистрация

Съответствие на устройството



Съответствие на устройството съгласно директивите на ЕС.

Нотифициран орган:

mdc medical device certification GmbH - нотифициран орган CE 0483

Тел.: +49 (0)711 253597 0

Факс: +49 (0)711 258597 10

Имейл адрес: mdc@mdc-ce.de

Уебсайт: www.mdc-ce.de

Адрес: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Германия


Самостоятелен регистрационен номер

SRN: DE-MF-000010680

Базова UDI-DI


Базова UDI-DI	Разпределение на устройството
040506740100039N	ROTANTA 460 / 460R / 460RC / 460RF (медицинско изделие)

3.3 Важни табелки на опаковката



НАГОРЕ

Това е правилното изправено положение на транспортния контейнер за транспортиране и/или съхранение.




ЧУПЛИВА ОПАКОВАНА СТОКА

Съдържанието на транспортната опаковка е чупливо, така че трябва да се работи внимателно с нея.



ЗАЩИТЕТЕ ОТ ВЛАГА

Транспортната опаковка трябва да бъде пазена от дъжд и съхранявана в суха среда.



ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ
 Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указания температурен диапазон (-20 °C до +60 °C).



ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА
 Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указания диапазон на влажността на въздуха (10 % до 80 %).



ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА СТИФИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ ИЗДЕЛИЯ
 Максимален брой идентични опаковани изделия, които могат да бъдат подредени върху долното опаковано изделие, където "n" е разрешеният брой опаковани изделия. Най-долното опаковано изделие не се съдържа в "n".

3.4 Важни табелки на устройството



Стикерите на устройството не трябва да се премахват, облепват или покриват.



Внимание, зона с обща опасност.
 Преди да използвате устройството, не забравяйте да прочетете инструкциите за пускане в експлоатация и работа и спазвайте инструкциите за безопасност!



Предупреждение за биологична опасност.



Предупреждение за горещи повърхности.
 Неспазването на това указание може да доведе до материални щети и наранявания на хора.



Посока на въртене на ротора.
 Посоката на стрелката указва посоката на въртене на ротора.



Символ за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване, съгласно Директива 2012/19/ЕС (WEEE).
 Използване в страните от Европейския Съюз, в Норвегия и Швейцария.



Центрофугата е оборудвана с интерфейс RS232.

Интерфейсът RS232 е обозначен със символ.

Чрез интерфейса центрофугата може да бъде управлявана и да бъдат правени заявки за данни. Бутонът [PROG] свети по време на комуникация на данни.



Еквипотенциал: Щепселен конектор (РА щепсел) за изравняване на потенциала (само за центрофуги с РА щепсел).

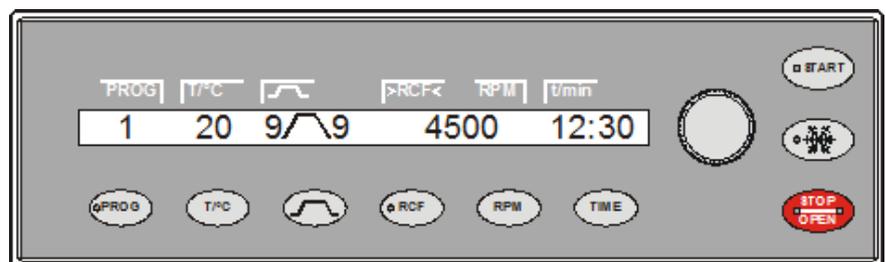
F2
↓

Предпазен автомат

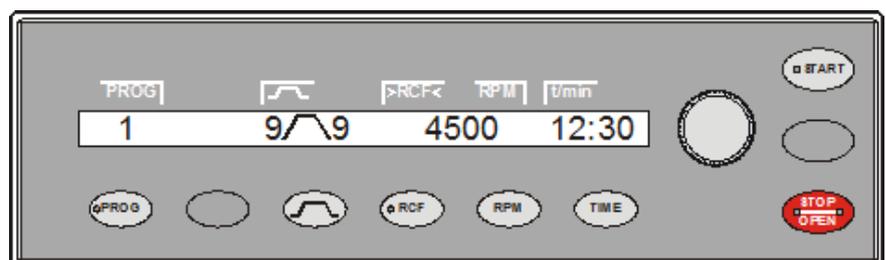
↑
F2

3.5 Елементи за обслужване и индикация

3.5.1 Управление



Фиг. 2: Управление (устройство с охлаждане)



Фиг. 3: Управление (устройство без охлаждане)

3.5.2 Индикаторни елементи



Фиг. 4: Бутон [Охлаждане]

- Бутонът мига, докато роторът бъде прочетен.
- Бутонът свети по време на работата на центрофугата за предварително охлаждане на ротора, докато роторът още не е спрял.



Фиг. 5: Бутон [PROG]

- Бутонът свети, когато е налице предаване на данни.



Фиг. 6: Бутон [RCF]

- Бутонът свети, когато е показано RCF.



Фиг. 7: Бутон [START]

- Бутонът мига, докато роторът бъде прочетен.
- Бутонът свети по време на работата на центрофугата, докато роторът още не е спрял.



Фиг. 8: Бутон [STOP/OPEN]

- Дясната страна на бутона свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране. Роторът още не е спрял.
- Лявата страна на бутона свети, когато роторът спре.
- Светлината от лявата страна на бутона изгасва, когато капакът бъде отключен.

3.5.3 Елементи за обслужване



Фиг. 9: [Въртящ се бутон]

- Настройка на отделните параметри.
Завъртане обратно на часовниковата стрелка намалява стойността.
Завъртане по часовниковата стрелка увеличава стойността.



Фиг. 10: [Превключвател на захранването]

- Включване и изключване на устройството.



Фиг. 11: Бутон [Параметри на пускане и спиране]

- Параметри на пускане
Степен 9 = най-кратко време на пускане, степен 1 = най-продължително време на пускане.
- Време на пускане, параметър
Настройва се на стъпки по 1 секунда.
- Спирачни степени, параметър
1-9 = Линейна крива на спиране
1b-9b = подобна на експоненциална крива на спиране
Степен 9, 9b = най-кратко време на спиране, ...степен 1, 1b = продължително време на спиране, степен 0 = спиране без спирачка.
- Време на спиране, параметър
Настройва се на стъпки по 1 секунда.
- Обороти на изключване на спирачката, параметър N Brake
Настройва се от 50 об./мин. до максималните обороти на ротора (N_{max}), на стъпки от по 10. След достигане на тези обороти се извършва спиране без спирачки.



Фиг. 12: Бутон [Охлаждане]



Фиг. 13: Бутон [PROG]



Фиг. 14: Бутон [RCF]



Фиг. 15: Бутон [RPM]



Фиг. 16: Бутон [START]



Фиг. 17: Бутон [T/°C]

- Стартиране на цикъл на центрофугиране за предварително охлаждане на ротора (само при устройства с охлаждане).
- Цикъл на центрофугиране за предварително охлаждане на ротора, извършван автоматично с програмата PREC (ПРЕДВАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ).
- Извикване на програми и програмни връзки, параметър RCL(Recall).
Програми: Програмни места от 1 до 99. Програмни връзки: Програмни места от A до Z.
- Запаметяване на програми и програмни връзки, параметър STO (Store).
Могат да бъдат запаметени 99 програми (програмни места от 1 до 99).
Програмното място 0 служи като междинна памет за данните от центрофугирането от последните пускания на центрофугата. В това програмно място не могат да бъдат запаметявани програми.
Могат да бъдат запаметени 25 програмни връзки (програмни места от A до Z, програмно място J липсва). Една програмна връзка може да се състои от 20 програми.
- Свързване на програми, параметър EDIT.
- Извикайте „Машинно меню“.
- Прелистване напред в менюто.
- Относително ускорение на центрофугата, параметър RCF.
RCF се показва в скоби > <.
Може да се регулира числена стойност, която задава оборотите между 50 об./мин. и максималните обороти на ротора (N_{max}).
Настройва се на стъпки по 1.
- Радиус на центрофугиране, параметър RAD.
Настройва се от 10 mm до 330 mm, на стъпки от 1 милиметър.
- Запитване за интегралното RCF.
Запитване за интегралното RCF е възможно само, когато индикацията на интегралното RCF е активирана.
- Превключване на стойността на RCF.
- Обороти, параметър RPM.
Настройва се от 50 об./мин. до максималните обороти на ротора (N_{max}), на стъпки от по 10.
- Превключване на стойността на RPM.
- Стартирайте работата на центрофугата.
- Запаметете въвежданията и промените.
- В „Машинно меню“ извикайте подменюто.
- Температура (при центрофуги с охлаждане)
Настройва се в градуси по Целзий (°C) или в градуси по Фаренхайт (°F).
Параметър T/°C=градуси по Целзий (°C). Настройва се от -20°C до +40°C, на стъпки от 1°C.
Параметър T/°F=градуси по Фаренхайт (°F). Настройва се от -4°F до +104°F, на стъпки от 1°F.
Най-ниската достижима температура зависи от ротора.
- Температура (при центрофуги с отопление)



Фиг. 18: Бутон [TIME]

Активиране или деактивиране на отоплението, параметър Heater (Отоплител).

- Прелистване в менюто назад (при центрофуги без охлаждане бутонът е празен).
- Време на работа, параметър t/hms.
h: Часове от 1 h до 99 h, на стъпки от 1 час-.
m: Минути: от 1 min до 59 min, на стъпки 1 минута-.
s: Секунди: от 1 s до 59 s, на стъпки от 1 секунда-.
- Продължителна работа "∞"
- Започва настройката на отброяването на времето на работа.
- Завършване на работата на центрофугата.
Роторът се забавя с предварително избрания параметър на забавяне.
- Двукратно натискане на бутона задейства функцията за бързо спиране.
- Отключване на капака.
- Напускане на въвеждането на параметри и менюто.



Фиг. 19: Бутон [STOP/OPEN]

3.6 Оригинални резервни части

Използвайте само оригиналните резервни части на производителя и разрешените принадлежности.

3.7 Обхват на доставката

Следните принадлежности се доставят с центрофугата:

- 1 смазочна грес за носещата шийка
- 1 шестостепенен шифтов ключ (SW5 x 170)
- 1 ъглова отвертка с вътрешен шестостепен (SW2,5)
- 1 ъглов ключ с вътрешен шестостепен къс (T20 SG)
- 1 захранващ кабел
- 1 ръководство за употреба
- 1 информационен лист за транспортна безопасност

Допълнително при устройство с азот:

- 1 информационен лист за свързване на азот
- 1 пистолет за уплътняване
- 1 силикон

Допълнително при тип 5675:

- 1 единичен гаечен ключ SW 10
- 1 двоен гаечен ключ SW 17/19

Допълнително при доставка в Германия:

- 1 наръчник за изпитване

Ротори и съответните принадлежности се доставят по поръчка.

3.8 Връщане

За връщане трябва винаги да се изисква оригинален формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA) на производителя. Без оригинален формуляр за връщане на производителя не е възможно безопасно приемане на стоките и регистриране на стоките при производителя. Формулярът за връщане (RMA) съдържа декларация за липса на възражения (UBE), която трябва да бъде попълнена изцяло и приложена при връщането.

Ако устройството и/или принадлежностите се връщат на производителя, цялото количество за връщане трябва да бъде почистено и обеззаразено от подателя на връщането. Ако върнатите изделия не са почистени или са недостатъчно почистени и/или недостатъчно обеззаразени, това ще бъде извършено от производителя и изпращачът ще бъде таксуван.

Оригиналните транспортни закрепвания трябва да бъдат прикрепени за връщане, вижте ➔ Глава 4 „Транспорт и съхранение“ на страница 23. Устройството трябва да се изпрати в оригиналната опаковка.

4 Транспорт и съхранение

4.1 Условия за транспорт и съхранение

Условия за транспорт



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството поради неизползвани транспортни закрепвания.

- Закрепете транспортните закрепвания преди транспортиране на устройството.



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството поради конденз.

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образуваният се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа. или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

- Преди транспортиране закрепете транспортните закрепвания и разкачете устройството от електрическия контакт.
- Температурата на транспортиране трябва да бъде между $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %
- Обърнете внимание на теглото на устройството.
- При транспортиране с транспортно помощно средство (например транспортна количка) транспортното помощно средство трябва да е с товароносимост най-малко 1,6 пъти по-голяма от транспортното тегло на устройството.
- Обезопасете устройството по време на транспортиране срещу преобръщане и падане.
- Не транспортирайте устройството никога странично или обърнато наобратно.

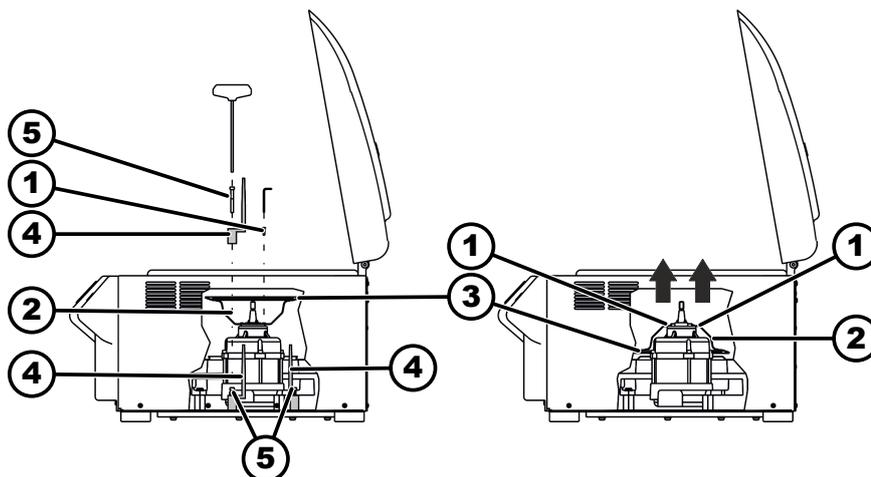
Условия на съхранение

- Устройството трябва да бъде съхранявано в оригиналната опаковка.
- Съхранявайте устройството само в сухи помещения.
- Температурата на съхранение трябва да бъде между -20 °C и +60 °C.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %

4.2 Закрепване на транспортна осигуровка

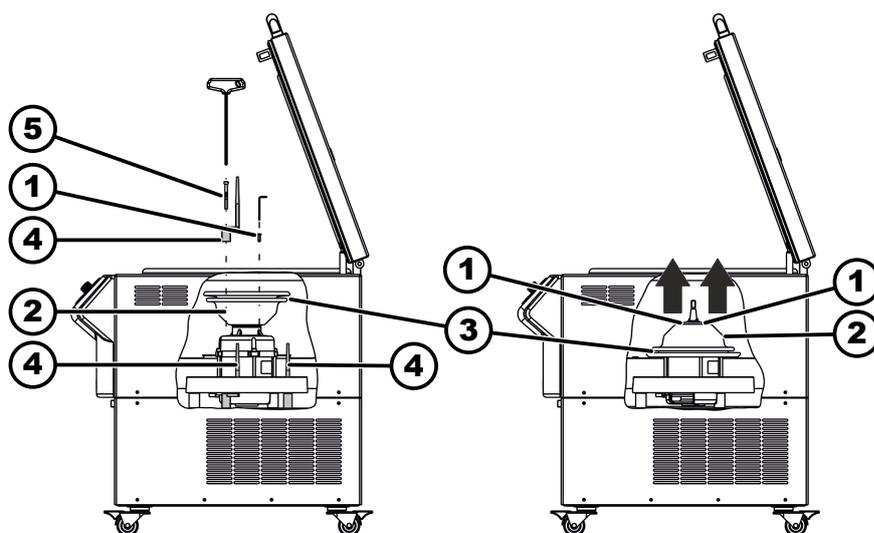
Персонал:

- Обучен потребител



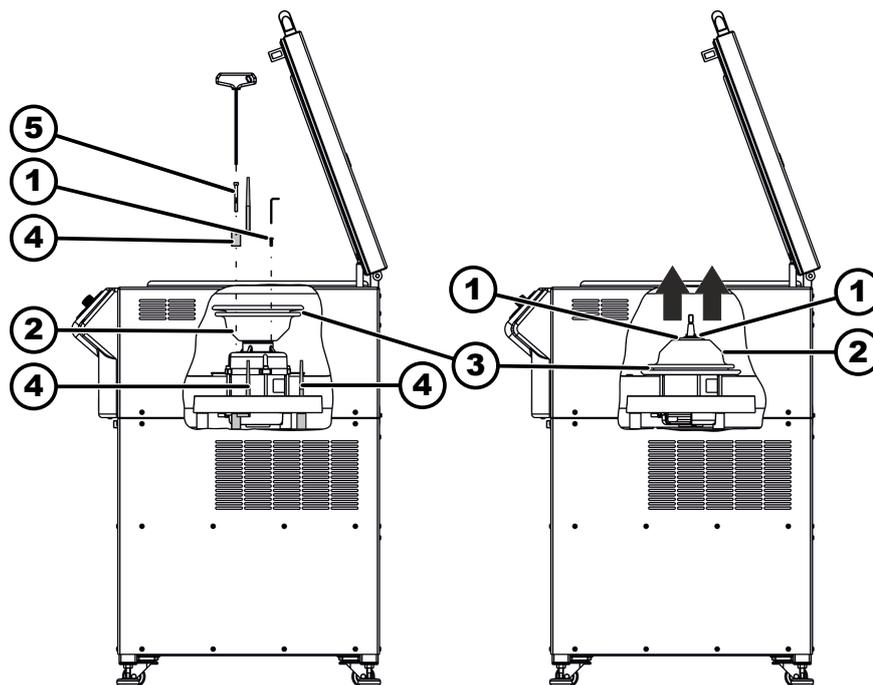
Фиг. 20: Транспортна осигуровка ROTANTA 460

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон (само при центрофуга с охлаждане)
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове на транспортната осигуровка



Фиг. 21: Транспортна осигуровка ROTANTA 460 RC

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове за транспортната осигуровка



Фиг. 22: Транспортна осигуровка ROTANTA 460 RF

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове за транспортната осигуровка

1. ➤ Отворете капака.
2. ➤ Развийте винтовете на капака на двигателя (2).
3. ➤ При ROTANTA 460 R / RC / RF:
Отстранете маншона (3).
4. ➤ Завинтете 3-те транспортни осигуровки (4) с 3-те винта на транспортните осигуровки (5).
5. ➤ Завинтете и поставете капака на двигателя (2).
6. ➤ Завийте 4 винта (1).
7. ➤ При ROTANTA 460 R / RC / RF:
Обърнете маншона (3) върху периферията на капака на двигателя (2).

5 Пускане в експлоатация

5.1 Разопаковане на центрофугата



ВНИМАНИЕ

Опасност от премазване поради падащи части от транспортната опаковка.

- По време на процеса на разопаковане винаги поддържайте устройството в равновесие.
- Отваряйте опаковката само на предвидените за това места.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради вдигане на тежки товари.

- Подгответе указания брой помощници.
- Обърнете внимание на теглото. Вижте ➔ Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 11.



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството поради неправилно повдигане.

- Не повдигайте центрофугата за контролния панел или държача на контролния панел.

Персонал:

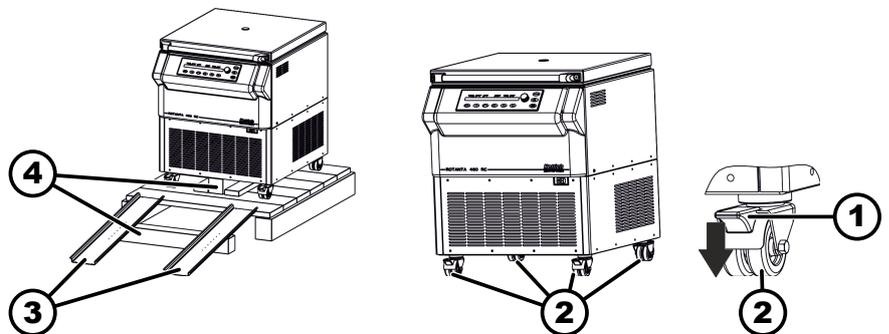
- Обучен потребител

1. ➤ Ако е необходимо: Отстранете лентите на опаковката.
2. ➤ Вдигнете кашона нагоре и отстранете облицовката.
3. ➤ Извадете принадлежностите и ги съхранете.
4. ➤ Поставете устройството върху стабилна и равна основа.

Разопаковане 5670

Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 23: Разопаковане 5670

- 1 Спирачка
- 2 Направляващи ролки
- 3 Метална шина
- 4 Дървени греди

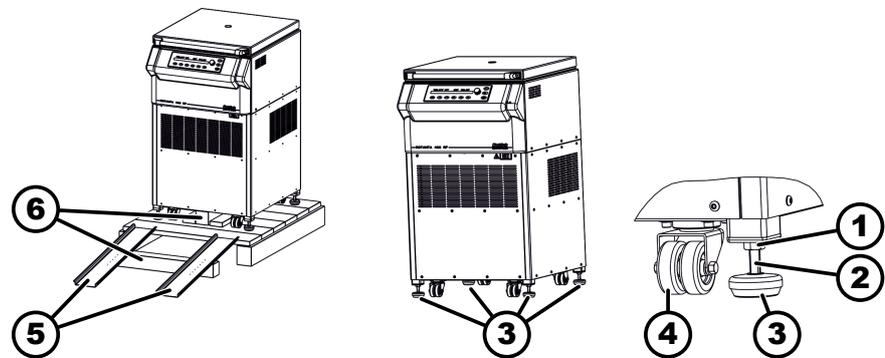
1. ➤ Отстранете опаковката.

2. ➤ Отстранете дървените греди (4).
3. ➤ Закрепете металните шини (3) с по два пирона към дървения палет.
4. ➤ Избутайте дървените греди (4) под металните шини (3), за да ги подпрете.
5. ➤ Избутайте нагоре спирачката (1) към направляващите ролки (2), за да я освободите.
6. ➤ Изтъркаляйте центрофугата по металните шини (3) внимателно от дървения палет.
7. ➤ Избутайте центрофугата до нейното място на разполагане.
8. ➤ Избутайте надолу спирачката (1) към направляващите ролки (1), за да я фиксирате.

Разопаковане 5675

Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 24: Разопаковане 5675

- 1 Шестостенна гайка
- 2 Плоска част
- 3 Крака на устройството
- 4 Направляваща ролка
- 5 Метална шина
- 6 Дървени греди

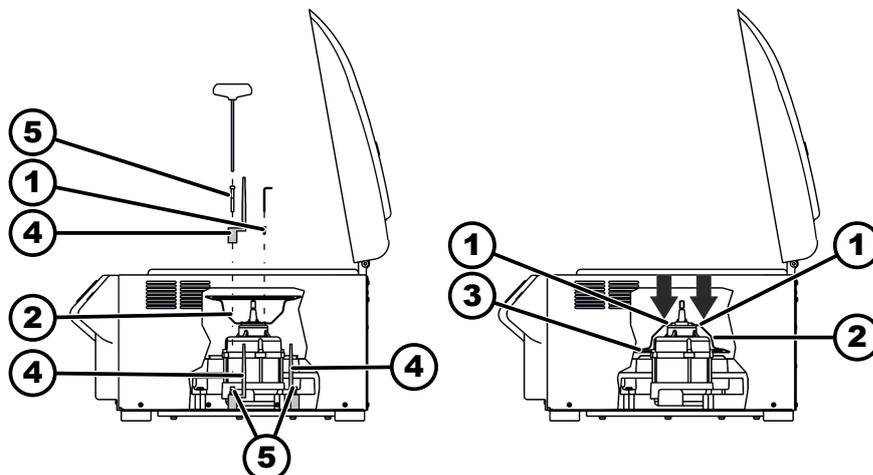
1. ➤ Отстранете опаковката.
2. ➤ Отстранете дървените греди (6).
3. ➤ Закрепете металните шини (5) с по два пирона към дървения палет.
4. ➤ Избутайте дървените греди (6) под металните шини (5), за да ги подпрете.
5. ➤ Поставете един гаечен ключ (размер 10 mm) върху плоската част (2) и завъртете краката на устройството (3) доколкото е възможно нагоре.
6. ➤ Изтъркаляйте центрофугата по металните шини (5) внимателно от дървения палет.
7. ➤ Избутайте центрофугата до нейното място на разполагане.
8. ➤ Поставете един гаечен ключ (размер 10 mm) върху плоската част (2) и завъртете краката на устройството (3), доколкото е възможно надолу, докато направляващите ролки (4) престанат да имат контакт с пода.
9. ➤ Нивелирайте хоризонтално центрофугата чрез завъртане на краката на устройството (3).

10. ▶ Завъртете шестостенните гайки (1) с доставения гаечен ключ (размер 19 mm) нагоре и ги завийте, за да фиксирате позицията на краката на устройството (3).

5.2 Отстраняване на транспортната осигуровка

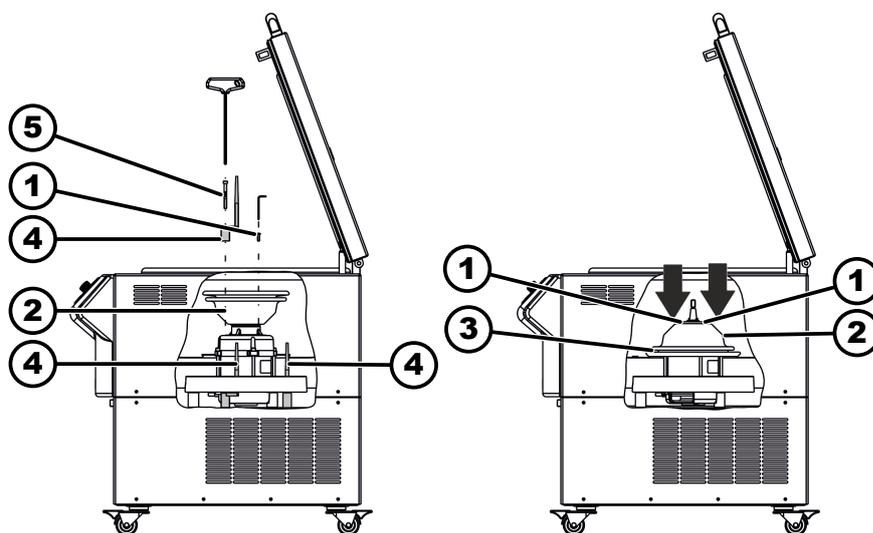
Персонал:

- Обучен потребител



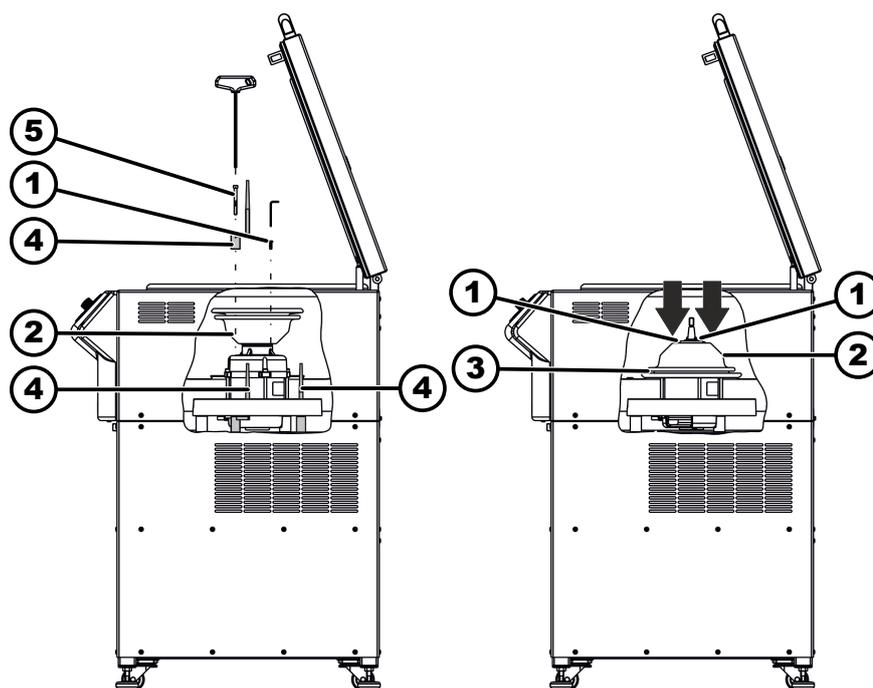
Фиг. 25: Транспортна осигуровка ROTANTA 460

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон (само при центрофуга с охлаждане)
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове на транспортната осигуровка



Фиг. 26: Транспорт на ROTANTA 460 RC

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове за транспортната осигуровка



Фиг. 27: Транспорт на ROTANTA 460 RF

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове за транспортната осигуровка

1. Отворете капака.
2. Развийте 4-те винта (1).
3. Свалете капака на двигателя (2).
4. Развийте 3-те транспортни осигуровки (4) с 3-те винта на транспортните осигуровки (5).
5. Съхранете сигурно винтовете и транспортните осигуровки.
6. Завинтете и поставете капака на двигателя (2). Обърнете внимание на изреза за кабела.
7. При ROTANTA 460 R / RC / RF:
Обърнете маншона (3) върху периферията на камерата на центрофугата.
8. Завийте 4 винта (1).

5.3 Разполагане и свързване на центрофугата

Разполагане на центрофугата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради малко отстояние до центрофугата.

- По време на цикъл на центрофугиране съгласно EN / IEC 61010-2-020 в **зона на безопасност от 300 mm** около центрофугата не трябва да има хора, опасни вещества и опасни предмети.
- Трябва да се спазва отстояние от **300 mm** до въздушните прорези и въздушните отвори на центрофугата.



ВНИМАНИЕ

Опасност от премазване и повреди на устройството поради падане вследствие на свързани с вибрации промени на положението.

- Поставете устройството върху стабилна и равна повърхност.
- Изберете място за разполагане в зависимост от теглото на устройството.



УКАЗАНИЕ

Повреди на пробите и устройството поради превишаване или недостигане на максимално допустимата околна температура.

- Спазвайте максималната и минималната допустима околна температура за разполагане на устройството.
- Не разполагайте устройството близо до източник на топлина.
- Устройството не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
- Устройството не трябва да се излага на студ.

Персонал:

- Обучен потребител

1. ► Поставете устройството върху стабилна и равна основа.
2. ► Около устройството трябва да се спазва отстояние от 300 mm.
3. ► Спазвайте условията на околната среда в техническите данни (→ Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 17).

Свързване на центрофугата



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството от неупълномощен персонал

- Интервенциите и промените на устройствата от неупълномощени лица са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.

**УКАЗАНИЕ****Повреди на устройството поради конденз.**

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образуваният се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа. или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

Персонал:

- Обучен потребител

1. ► Ако уредът в сградната инсталация допълнително се предпазва с прекъсвач за остатъчен ток, трябва да се използва прекъсвач за остатъчен ток от тип В.

При използване на друг тип прекъсвачът за остатъчен ток може или да не изключи уреда, когато е повреден, или да го изключи, въпреки че не е повреден.

2. ► Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на данните на фирмената табелка.
3. ► Свържете устройството с мрежовия кабел към стандартизиран мрежов контакт.

Свържете центрофугата към
захранване с азот

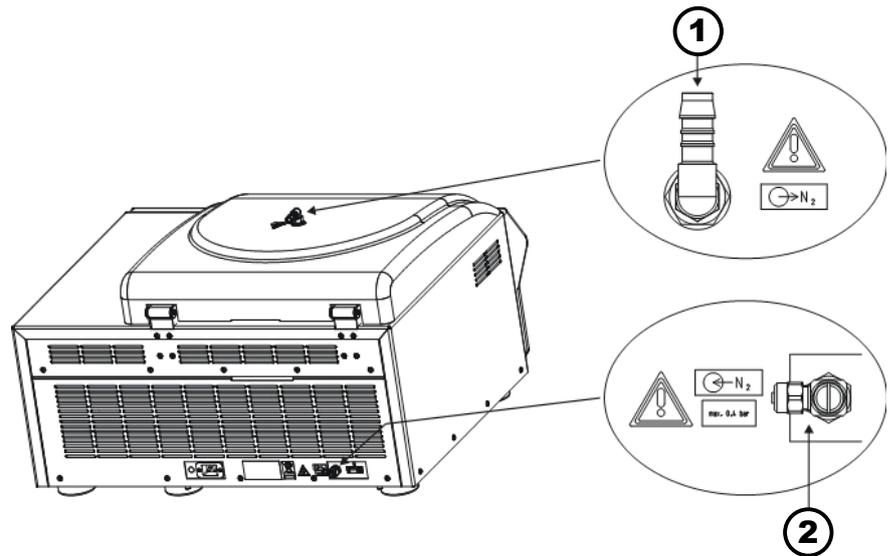
Отнася се само за модел със захранване с азот.

- За да се уверите, че в центрофугата не се създава възпламенима смес, трябва да използвате устройство за проследяване на концентрацията на кислород с допълнително гранично изключване.
- Операторът трябва да има разрешение за приложението на "центрофугата и устройството за проследяване", одобрено от акредитиран институт за изпитване (в Европа, напр. TÜV) в съответствие с Приложение II на Директива 94/9/ЕС (ATEX-95). Това включва и дефинирането на използваните материали, вида на защитата срещу запалване и създаването на оценка на риска.
- Системата се използва с поемане на риска от оператора.
- Специални бележки относно херметичността на частите на центрофугата по отношение на продухването с азот. Операторът трябва да осигури херметичността и функционалността на следните преходи:
 - Уплътнение между капака и камерата на центрофугата.
 - Уплътнение между камерата на центрофугата и капака на двигателя.
 - Уплътнение на съединенията за подаване и отвеждане на инертизирането с азот.

Персонал:

- Обучен потребител

1. ► Центрофугата е подготвена за свързване към захранване с азот.



- 1 Изходящ отвор за азот
- 2 Входящ отвор за азот, дроселен клапан

2. ► Входящият отвор за азот (2) се намира в задната част на машината и е свързан чрез пневматична винтова връзка с бързо освобождаване с 6 mm пневматичен маркуч.
3. ► Изходящият отвор за азот (1) се намира на капака и е снабден с 12 mm връзка за маркуч. Вмъкнете маркуча върху щуцера на ъгловото винтово съединение.
4. ► Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на данните на фирмената табелка.
5. ► Свържете устройството с мрежовия кабел към стандартизиран мрежов контакт.

Проследяване на дебита на азот

Операторът е отговорен за проследяването на дебита на азот.

Технически изисквания

Входящ отвор за азот: налягане пред дроселния клапан 0,4 bar.

5.4 Включване и изключване на центрофугата

Включване на центрофугата

Персонал:

- Обучен потребител

- > Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [//].
 - ➔ Бутоните мигат според типа на центрофугата.

Според типа на центрофугата една след друга се появяват следните индикации:

 - моделът на центрофугата
 - програмната версия и мрежовото напрежение
 - кодът на ротора (Rotor), максималните обороти (maxRPM) и радиусът на центрофугиране (R) на последния разпознат ротор от разпознаването на ротора.

Показаният радиус на центрофугиране е стандартна стойност, която трябва да бъде адаптирана към използваната принадлежност.
 - Когато капакът е затворен: Индикация „OPEN ОТВАРЯНЕ“
 - Когато капакът е отворен: Данни за центрофугирането на последната използвана програма или програма 1.

Незабавно показване на данните за центрофугирането след включване

1. —> Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [//].
2. —> При първата визуална промяна на индикацията (инвертирана индикация) натиснете и задръжте натиснат произволен бутон.
 - ➔ Показват се данните за центрофугирането.

Изключване на центрофугата

- Роторът е спрял.
- > Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [0].

6 Обслужване

6.1 Отваряне и затваряне на капака

Отваряне на капака

- Персонал:**
- Обучен потребител
- Центрофугата е включена
- Роторът е спрял.
- > Натиснете бутона [STOP/OPEN].
 - ➔ Капакът се освобождава с двигател.
- Светлината от лявата страна на бутона [STOP/OPEN] изгасва.

Затваряне на капака




ВНИМАНИЕ

Опасност от премазване при затваряне на капака.

Риск от премазване на пръсти, когато двигателят за затваряне издърпа капака срещу уплътнението.

- При затваряне на капака не трябва да има части от тялото в опасната зона на капака.
- За затваряне на капака натиснете капака отгоре.



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството поради рязко затваряне на капака.

- Затваряйте бавно капака.
- Не затваряйте капака рязко.



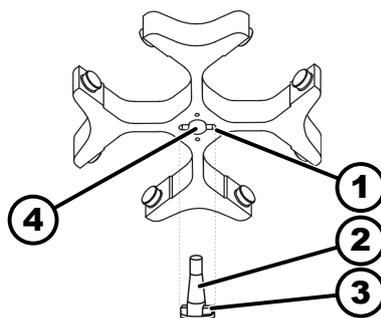
Когато лявата страна на бутона [STOP/OPEN] мига, натиснете бутона [STOP/OPEN], който привежда моторната блокировка на капака отново в основно положение (отворен).

Персонал:

- Обучен потребител
 - Затворете капака и притиснете предния ръб на капака леко надолу.
 - ➔ Капакът се блокира с двигател.
- Лявата страна на бутона [STOP/OPEN] свети.

6.2 Демонтаж и монтаж на ротора

Демонтаж на ротор със затягаща гайка



Фиг. 28: Монтаж и демонтаж на ротора

- 1 Жлеб
- 2 Вал на двигателя
- 3 Водач
- 4 Отвор

Монтаж на ротор със затягаща гайка

Персонал:

- Обучен потребител
- 1. → Отворете капака.
- 2. → Развийте затягащата гайка на ротора с доставения ключ.
 - ➔ След преодоляване на точката на повдигане, роторът се отделя от конуса на вала на двигателя (2).
- 3. → Въртете затягащата гайка, докато роторът може да се повдигне от вала на двигателя.
- 4. → Свалете ротора.

Персонал:

- Обучен потребител
- Капакът е отворен.
1. → Почистете вала на двигателя (2) и отвора на ротора (4).
 2. → Гресирайте леко вала на двигателя (2), вижте ➔ Глава 8.2 „Указания за почистване и дезинфекция“ на страница 68.
 3. → Поставете ротора вертикално върху вала на двигателя (2).
Водачът (3) на вала на двигателя трябва да се намира в жлеба (1) на ротора. Ориентацията на жлеба е отбелязана върху ротора.
 4. → Затегнете на ръка затягащата гайка на ротора с доставения ключ.
 5. → Проверете ротора за добро затягане.

6.3 Поставяне и снемане на носачи

Поставяне на носачи



УКАЗАНИЕ

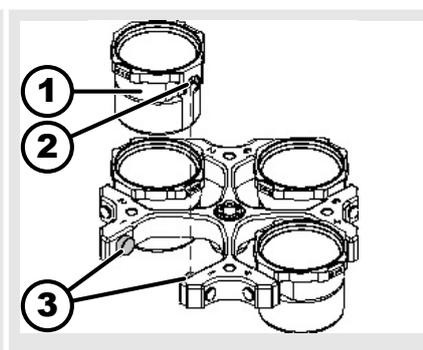
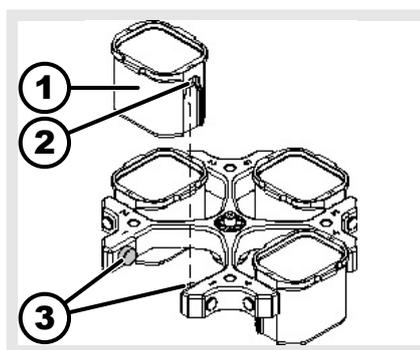
Повреда на устройството, причинена от дисбаланси, причинени от неправилно зареждане на ротора.

- Заредете всички места на роторите с променлив ъгъл с подходящи носачи.



Носачи, които са обозначени с номерата на местата на ротора, трябва да бъдат поставяни само там.

Носачи, които са обозначени с комплект номера, трябва да бъдат използвани само заедно.



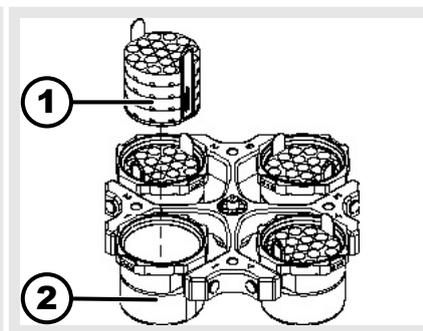
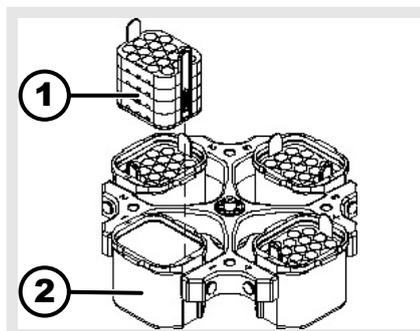
1. Проверете ротора за добро затягане.
2. Гресируйте носещата шийка (3).
3. Поставете носачите (1) отгоре в ротора. Носещата шийка (3) трябва да се намира в жлебовете (2).
4. Натиснете носачите (1) до упор надолу.

Сваляне на носачи

- Издърпайте носачите (1) вертикално нагоре от ротора.

6.4 Поставяне и сваляне на адаптер

Адаптер



поставяне

- Поставете адаптера (1) вертикално отгоре в носачите (2).

сваляне

- Извадете адаптера (1) вертикално нагоре от носачите (2).

6.5 Зареждане

Пълнене на центрофужните епруветки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване от замърсен материал на проби.

Замърсеният материал на пробата излиза от епруветката за пробата по време на центрофугирането.

- Използвайте центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- В случай на материали в рисковите групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на СЗО (Световната здравна организация)).



УКАЗАНИЕ

Повреди на устройството поради силно корозирали вещества.

Силно корозирали вещества могат да влошат механичната якост на ротори, носачи и принадлежности.

- Не центрофугирайте силно корозирали вещества.



Стандартните центрофужни епруветки могат да се натоварват до RZB 4000 (DIN 58970 Част 2).

Персонал:

- Обучен потребител

→ Пълнете центрофужните епруветки извън центрофугата.

Посоченото от производителя максимално количество на пълнене на центрофужните епруветки не трябва да бъде превишавано.

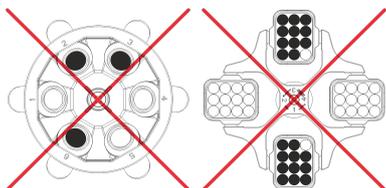
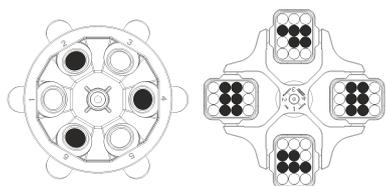
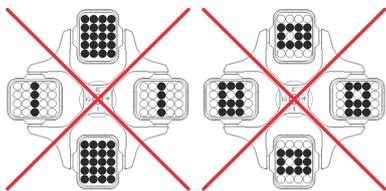
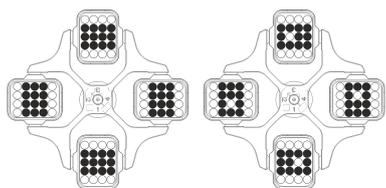
В случай на ъглови ротори центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.

За да се запазят разликите в теглото в центрофужните епруветки възможно най-малки, важно е да се гарантира, че епруветките са напълнени равномерно.

Зареждане на ротори с променлив ъгъл

Персонал:

- Обучен потребител



При употреба на торбички с кръв трябва да се внимава за следното:

Зареждане на ъглови ротори

1. ► Проверете ротора за добро затягане.
2. ► Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени симетрично и равномерно на всички места на ротора.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

При зареждане на носачите и завъртане на носачите по време на центрофугирането не трябва да попада течност в носачите и камерата на центрофугата.

В случай на контейнери с гумени вложки винаги трябва да има еднакъв брой гумени вложки под центрофужните епруветки.

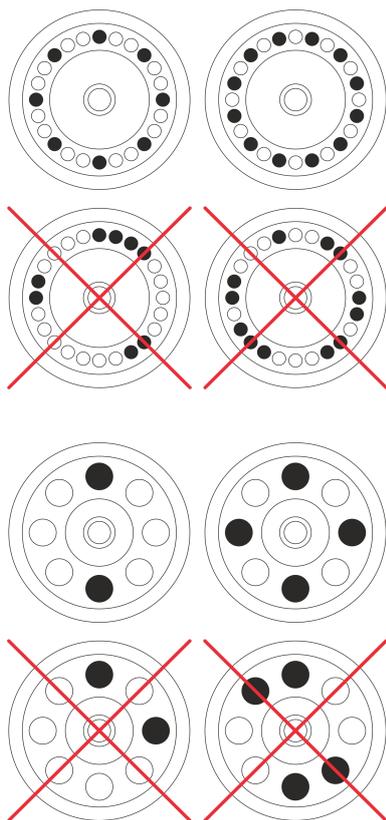
Всички места на ротора трябва да бъдат оборудвани с еднакви носачи. Определени носачи са обозначени с номер на мястото на ротора. Носачите трябва да се поставят само на съответните места на ротора.

Носачи, които са обозначени с комплект номера (например S001/4), трябва да бъдат използвани само в комплект.

1. ► Ако носачите не са пълни с еднакво тегло, разликите могат да се компенсират с балансиращи тежести.
2. ► В случай, че няма достатъчно налични системи за торбички с кръв за пълно натоварване на ротора, празните носачи могат да бъдат снабдени с компенсиращи вложки.
3. ► При необходимост фината настройка се извършва с доставените тариращи тежести.

Персонал:

- Обучен потребител



1. ▶ Проверете ротора за добро затягане.
2. ▶ Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени равномерно на всички места на ротора.

При зареждане на ротора не трябва да попада течност в ротора и в камерата на центрофугата.

При роторите центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

6.6 Отваряне и затваряне на система за биобезопасност

6.6.1 Пояснение

При центрофугиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.

По принцип трябва да се използват центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.

В случай на материали от рискови групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на Световната здравна организация).

При система за биобезопасност чрез биологично уплътнение (уплътнителен пръстен) се възпрепятства възникването на капчици и аерозоли.

Ако носачът на система за биобезопасност се използва без капак, уплътнителният пръстен трябва да се отстрани от носача, за да се избегне повреда на уплътнителния пръстен по време на центрофугирането.

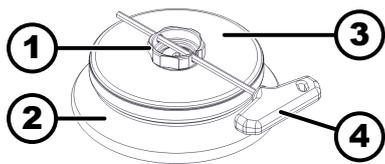
Повредените системи за биобезопасност повече не са микробиологично херметични.

Без използване на система за биобезопасност една центрофуга не е микробиологично херметична по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.

Съхранение на системи за биобезопасност

За да се предотврати повреда на уплътнителните пръстени по време на съхранение, системите за биобезопасност трябва да се съхраняват само с отворен капак.

6.6.2 Капак с винтово затваряне и отвор



Фиг. 29: Система за биобезопасност

- 1 Въртяща се ръкохватка
- 2 Ротор
- 3 Капак
- 4 Ключ

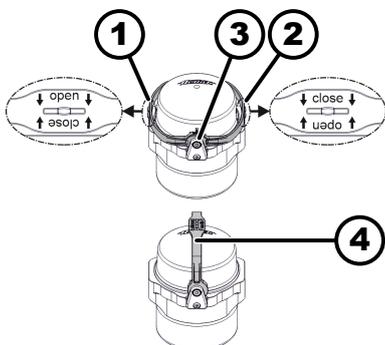
Затваряне

1. ➤ Поставете капака (3) в средата на ротора (2).
2. ➤ Вкарайте предоставения ключ (4) в отвора на въртящата се ръкохватка (1).
3. ➤ Завъртете капака (3) с ключа (4) по посока на часовниковата стрелка, докато го затворите плътно.

Отваряне

1. ➤ Вкарайте предоставения ключ (4) в отвора на въртящата се ръкохватка (1).
2. ➤ Завъртете капака (3) с ключа (4) по посока обратна на часовниковата стрелка, за да го отворите.
3. ➤ Свалете капака (3) от ротора (2).

6.6.3 Капак със скоба и затваряне с обтегач



Фиг. 30: Система за биобезопасност

- 1 Позиция на скобата "open"
- 2 Отваряне на скобата
- 3 Позиция на скобата "close"
- 4 Позиция за пренасяне на скобата

Затваряне

1. ➤ Завъртете скобата в позиция "open" (1).
Стрелките на надписа трябва да сочат надолу, за да се чете текстът "open".
2. ➤ Поставете капака в средата на носача.
Двете шийки на капака трябва да се намират в двата отвора на скобата (2).

3. Завъртете скобата в позиция "close" (3).

Стрелките на надписа трябва да сочат надолу, за да се чете текстът "close".

Скобата трябва да лежи върху носачите, така че носачите да могат да се завъртат навън по време на центрофугирането.

4. За транспортиране или когато поставяте и изваждате носачите, завъртете скобата в позиция за носене (4) и фиксирайте носачите към скобата.

► Херметичността на системата за биобезопасност е гарантирана и в транспортната позиция.

По време на транспортиране на системата за биобезопасност не я разтърсвайте напред и назад, тъй като в противен случай херметичността повече не е гарантирана.


Отваряне

1. Завъртете скобата в позиция "open" (1).

Стрелките на надписа трябва да сочат надолу, за да се чете текстът "open".

2. Свалете капака от носача.

6.6.4 Капак с винтово затваряне



Фиг. 31: Система за биобезопасност

- 1 Капак
- 2 Носач

Затваряне

1. Поставете капака (1) в средата на носача (2).

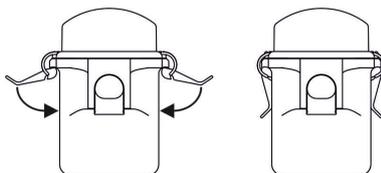
2. Завъртете капака (1) по посока на часовниковата стрелка, докато го затворите плътно.

Отваряне

1. Завъртете капака (1) обратно на часовниковата стрелка, докато го отворите.

2. Свалете капака (1) от носача (2).

6.6.5 Капак със затваряне с обтегач



Фиг. 32: Система за биобезопасност

Затваряне

1. Поставете капака.

2. Завъртете двете обтягащи скоби надолу дотолкова, че да се намират под резетата на носачите.

Отваряне

1. ➤ Завъртете двете обтягащи скоби нагоре дотолкова, че да се намират над резетата на носачите.
2. ➤ Свалете капака от ротора.

6.7 Инструкция за опаковане HettLiner

Опаковане преди центрофугиране



Уверете се, че пластмасовата вложка не може да се преобърне, когато зареждате и изваждате вложките (ако е необходимо, използвайте помощно средство за зареждане 4509).



1. ➤ Поставете торбичката с кръв (1) във вложката (2).



2. ➤ Хванете торбичката с кръв за връзките (1) и плъзнете опорната плоча (2) от външната страна на торбичката с кръв във вложката от горе надолу.

Уверете се, че долният ръб на опорната плоча стъпва на пода възможно най-цялостно.



- 3.** ► Завъртете опорната плоча навън и натиснете надолу, докато притиснатият ръб на опорната плоча се изравни с нивото на течността в торбичката с кръв.

Горният ръб на опорната плоча не трябва да се издава твърде далеч от вложката, за да се избегне рискът рамената на ротора да бъдат захванати по време на центрофугиране.

Обърнете внимание на позицията на примката (1), така че да може да бъде достигната и след центрофугиране.

- 4.** ► Ако е възможно, сгънете празната/ите сателитна/и торбичка/и и уплътнете по различен начин в зависимост от съответните принадлежности и обема на пълнене на торбичката с кръв. Уместно е да сгънете сателитните торбички и да ги опаковате отвън между сгънатата опорна плоча и външната стена на вложката.

Уверете се, че силиконовата плоча не се плъзга.

Ако е необходимо, при опаковане на сателитната торбичка, силиконовата плоча може да се задържи на примката и така да се задържи нагоре.

Мястото на примката трябва след това да бъде проверено.

- 5.** ► Поставете връзките върху опорната плоча по такъв начин, че вентилите да не могат да се счупят.

Внимавайте за това маркучите да не се издават от вложката.

Приберете частите от маркучи, стърчащи над ръба на вложката, между сгънатата опорна плоча и стената на вложката.

- 6.** ► Ако е необходимо, между сгънатата опорна плоча и стената на чашата трябва да се поставят противотежести.

Разопаковане след центрофугиране

- 1.** ► Издърпайте сателитната торбичка от вложката и задръжте силиконовата плоча на място с една ръка.

- 2.** ► Бавно издърпайте сгънатата част на опорната плоча, като използвате предоставената примка.

Проверете опорната плоча и възстановете нейната първоначална форма. Сгънатата част на опорната плоча може да отскочи назад и да смеси кръвните съставки.

- 3.** ► Отстранете останалата кръвна торбичка от вложката или заедно с опорната плоча, или след отстраняване на опорната плоча.

6.8 Центрофугиране

6.8.1 Центрофугиране с продължителна работа

Персонал:

- Обучен потребител

1. ➤ Настройте минутите, секундите и часовете на „0“ или извикайте програма за продължителна работа.
2. ➤ Натиснете бутона *[START]*.

- Центрофугирането стартира.

Бутонът *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.

Бутонът *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.

Отброяването на времето започва от „00:00“.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и изминалото време.

3. ➤ Натиснете бутона *[STOP/OPEN]*, за да прекратите цикъла на центрофугиране.

- Спирането се извършва с избраните параметри на спиране.

Параметрите на спиране се показват.

Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.

Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.

Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

6.8.2 Центрофугиране с предварителен избор на време

Персонал:

- Обучен потребител

1. ➤ Настройте параметъра на центрофугиране или програма, или извикайте програмна връзка.
2. ➤ Натиснете бутона *[START]*.

- Центрофугирането стартира.

Бутонът *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.

Бутонът *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и оставащото време.

3. ➤ След изтичане на времето или при прекъсване на цикъла на центрофугиране се извършва спиране с избраните параметри на спиране.

- Параметрите на спиране се показват.

Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.

Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.

Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

6.8.3 Краткотрайно центрофугиране

Персонал:

- Обучен потребител

1. ► Натиснете и задръжте натиснат бутона *[START]*.

- Бутонът *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.

Бутонът *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.

Отброяването на времето започва от 00:00.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и изминалото време.

2. ► Отпуснете бутона *[START]*, за да прекратите цикъла на центрофугиране.

- Параметрите на спиране се показват.

Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.

Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.

Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

6.8.4 Промяна на настройки по време на центрофугиране

Не е възможно настройките да бъдат променени по време на центрофугиране, когато се работи с програмни връзки или е настроено заключване на програма.

Времето на работа, скоростта, относителното ускорение на центрофугата (RCF), параметрите за стартиране и спиране и температурата (само за устройства с охлаждане) могат да се променят по време на центрофугиране.

► Променете стойността на желанния параметър.

- Стойностите на текущата програма се копират в програмно място „0“ и се обновяват с променената стойност.

Оригиналната програма не се презаписва.

Номерът на програмното място се показва в скоби „()“. Данните на центрофугирането в индикацията не съответстват на запазените данни на центрофугирането на програмното място.

6.9 Функция бързо спиране

Персонал:

- Обучен потребител

► Натиснете двукратно бутона *[STOP/OPEN]*.

- Показва се и се изпълнява спиране със степен са спиране "9" (най-кратко време на спиране).

Когато е предварително избрана степен на спиране "0", спирането се извършва със степен на спиране "9d". Със степен на спиране "9d" времето на спиране е по-продължително отколкото със степен на спиране "9".

7 Обслужване на софтуера

7.1 Параметър на центрофугиране

7.1.1 Параметри на пускане и спиране



Степен на пускане и време на пускане

Показват се настроените параметри на пускане и спиране.

x: 1-9 = степен на пускане, t = време на пускане

y: 1-9, 1b-9b = степен на спиране, 0 = спиране без спирачка, t = време на спиране

Функция „Време на пускане“ е активирана.

1. ➤ Натиснете бутона [Параметри на пускане и спиране].
 - Показва се параметърът степен на пускане или параметърът време на пускане.
2. ➤ Натиснете бутона [TIME], за да превключите между степента на пускане и времето на пускане.
3. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен или време.
4. ➤ При необходимост: Натиснете бутона [Параметри на пускане и спиране], за да настроите следващия параметър.
5. ➤ Натиснете бутона [START].

или

Натискайте бутона [Параметри на пускане и спиране] многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.

Степен на спиране и време на спиране



Степените на спиране В могат да бъдат настроени само при ротори, които са подходящи за употребата на торбички с кръв.

- Настройката на степени на спиране В е възможна само когато тя е активирана.
- Настройката на времената на спиране е възможна само когато тя е активирана.

Функция „Време на спиране“ е активирана.

1. ➤ Натискайте бутона [Параметри на пускане и спиране] многократно, докато се покаже параметърът „Степен на спиране“, „Степен на спиране В“ или параметърът „Време на спиране“.
2. ➤ Натиснете бутона [TIME], за да превключите между степента на спиране и времето на спиране.
3. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте желаната степен или време.
4. ➤ При необходимост: Натиснете бутона [Параметри на пускане и спиране], за да настроите следващия параметър.
5. ➤ Натиснете бутона [START].

или

Натискайте бутона [Параметри на пускане и спиране] многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.

Обороти на изключване на спирачката

1. ➤ Натискайте бутона [Параметри на пускане и спиране] многократно, докато се покаже параметърът „Спирачка N“.
2. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.

3. ▶ Бутон [Параметри на пускане и спиране]

или

Натиснете бутона [START].

▶ Настройките се показват в индикацията.

7.1.2 Време на работа TIME

Промяна на времето на работа



За продължителна работа минутите, секундите и часовете трябва да бъдат настроени на нула.

Продължителната работа се показва в индикацията чрез символа „∞“.

1. ▶ Натиснете бутона [TIME].

▶ Показва се „t/hms“.

Минутите се показват в скоби ().

2. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.

3. ▶ Натиснете бутона [TIME].

▶ Секундите се показват в скоби ().

4. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.

5. ▶ Натиснете бутона [TIME].

▶ Часовете се показват в скоби ().

6. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.

7. ▶ Натиснете бутона [START].

или

Натискайте бутона [TIME] многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.

▶ Настройките се показват в индикацията.

Начало на отброяването на времето на работа:

■ Функция „Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)“ е активирана. Функцията е активирана фабрично.

1. ▶ Натискайте бутона [TIME] многократно, докато се покаже „Timing begins at Start (Отчитането на времето започва при старт)“ или „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“.

2. ▶ С [Въртящ се бутон] изберете желаната настройка.

■ „Timing begins at Start (Отчитането на времето започва при старт)“ = Времето на работа започва да се отброява след стартиране на цикъла на центрофугиране.

■ „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“ = Времето на работа започва да се отброява след достигане на настроените обороти.

Това се показва в индикацията отляво до времето чрез символа „√“.

3. ▶ Натиснете бутона [TIME].

или

Натиснете бутона [START].

▶ Настройките се показват в индикацията.

7.1.3 Обороты RPM

1. ➤ Натиснете бутона [RPM].
 - Параметърът „RPM“ се показва.
2. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.
3. ➤ Натиснете [RPM] или бутона [START].
 - Настройката се приема в индикацията.

7.1.4 Интегрално RCF

Интегралното RCF е величина за ефекта на утаяването ($\int n^2 dt$). Стойността служи за сравняване на циклите на центрофугата.

Запитване за интегралното RCF



Интегралното RCF не се запамятава. След стартиране на следващия цикъл на центрофугиране или след изключване на устройството интегралното RCF се изтрива.

Ако е избрана функцията „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“, изчисляването на интегралното RCF започва едва след достигане на настроените обороти.

- Интегралното RCF е активирано.
1. ➤ Натискайте бутона [RCF] многократно, докато се покаже интегралното RCF.
 2. ➤ Натиснете бутона [RCF].
 - Показват се данните за центрофугирането.
 3. ➤ При необходимост натиснете бутона [RPM].
 - Показва се индикацията на оборотите.

Активиране или деактивиране на интегралното RCF

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
 2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
 3. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
 4. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „RCF Integral = on“ или „RCF Integral = off“.
 5. ➤ Настройте с [Въртящ се бутон] „off“ или „on“.
 - off = деактивирано интегрално RCF
 - on = активирано интегрално RCF
 6. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Настройката се запамятава.
 - „Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко
 - След това се показва „-> Настройки“.
 7. ➤ Натиснете бутона [OPEN/STOP] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
- или
- Натиснете бутона [OPEN/STOP] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.1.5 Температура (при центрофуги с охлаждане)

1.  Натиснете бутона $[T/^{\circ}C]$.
 - ➔ Показва се параметърът $T/^{\circ}C$ респ. $T/^{\circ}F$.
2.  С въртящото се копче настройте желаната стойност.
3.  Натиснете $[T/^{\circ}C]$ или бутона $[START]$.
 - ➔ Настройката се приема в индикацията.

7.1.6 Относително ускорение на центрофугата RCF

Относителното ускорение на центрофугата RCF зависи от оборотите и радиуса на центрофугиране.

Относителното ускорение на центрофугата RCF се определя като кратно на ускорението, дължащо се на гравитацията (g).

Относителното ускорение на центрофугата RCF е безразмерна числена стойност и служи за сравняване на производителността на разделяне и на утаяване.

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000}\right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Относително ускорение на центрофугата

RPM = Обороти

r = радиус на центрофугиране в mm = разстояние от средата на оста на въртене до дъното на центрофужните епруветки.

7.1.7 Относително ускорение на центрофугата RCF и радиус на центрофугиране RAD

Относителното ускорение на центрофугата RCF зависи от радиуса на центрофугиране RAD. Преди настройване на ускорението на центрофугата трябва да се настрои радиусът на центрофугиране.

1.  Натискайте бутона $[RCF]$ многократно, докато се покажат параметрите „RAD“, „RCF“ и стойността на параметъра „RAD“ се покаже в скоби $\langle \rangle$.
 - ➔ Бутонът $[RCF]$ свети.
2.  С $[Въртящ се бутон]$ настройте желания радиус на центрофугиране. При промяна на радиуса на центрофугиране автоматично се адаптира стойността на RCF.
3.  Натиснете бутона $[RCF]$.
 - ➔ Стойността на параметъра „RCF“ се показва в скоби $\langle \rangle$
4.  С $[Въртящ се бутон]$ настройте желания „RCF“.
5.  Натиснете бутона $[PROG]$.
 - ➔ Настроената стойност на RCF се запазва.

7.1.8 Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm³

При центрофугиране на максимална скорост относителното тегло на веществата или смесите от вещества не трябва да надвишава 1,2 kg/dm³. При вещества или смеси от вещества с по-високо относително тегло оборотите трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1.2}{\text{по-висока плътност [kg/dm}^3\text{]}}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., относително тегло 1,6 kg/dm³

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако в изключителни случаи максималното натоварване, указано на носача, бъде превишено, оборотите също трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{максимално натоварване [g]}}{\text{действително натоварване [g]}}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., максимално натоварване 300 g, действително натоварване 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако има нещо неясно, трябва да се получи информация от производителя.

7.2 Програмиране

7.2.1 Защита срещу запис за програмите

Защитата срещу запис може да бъде активирана или деактивирана при спрян ротор.

1.  Извикайте желаната програма.
2.  Натиснете бутона [PROG].
 - ➔ Параметърът RCL се показва.
3.  Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - ➔ Параметърът STO се показва.
 - След 8 секунди в индикацията се появява „Зададена защита = 1-“.
4.  Настройте с [Въртящ се бутон] „+“ или „-“.
 - + = Програмата е защитена срещу запис
 - = Програмата не е защитена срещу запис
5.  Натиснете бутона [START].
 - ➔ Настройката се запаметява.

7.2.2 Изберете или заредете програма

1.  Натиснете бутона [PROG].
 - ➔ Параметърът RCL се показва.
2.  С [Въртящ се бутон] настройте желаното програмно място.

3. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ „Program recall... (Извикване на програмата...)“ се показва за кратко.
Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място

7.2.3 Въвеждане или промяна на програма



Предходните данни на програмното място се презаписват при запаметяването.

Ако е показано „Protected !!“, данните на програмното място са защитени срещу запис и не се извършва запаметяване.

1. ▶ Настройте желания параметър.
2. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже параметърът „STO“.
3. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте желаното програмно място.



Ако зад програмното място е показан „+“, данните са защитени срещу запис.

Защитата за запис трябва да бъде вдигната, преди да може да се извърши запаметяване.

4. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Настройките са запаметени в желаното програмно място.
„Program store... (Запаметяване на програмата...)“ се показва за кратко.

7.2.4 Автоматична междинна памет

След всяко стартиране на цикъл на центрофугиране данните на центрофугата се съхраняват междинно в програмно място „O“ и могат да бъдат извикани.

В програмното място „O“ не могат да бъдат запаметявани програми.

7.3 Разпознаване на ротора

- След стартиране на цикъл на центрофугиране се извършва разпознаване на ротора.
- Ако роторът е бил сменен, цикълът на центрофугиране се прекъсва след разпознаването на ротора. Показват се кодът на ротора (Rotor), максималните обороти на ротора (Nmax) и радиусът на центрофугиране (R) на новия разпознат ротор.
- Когато максималните обороти на използвания ротор са по-ниски от настроените обороти, оборотите се ограничават до максималните обороти на ротора.
Тогава номерът на програмното място се показва в скоби „()“.
- Когато броячът на цикли е активиран, след отваряне на капака за кратко се показва броят на изпълнените цикли (цикли на центрофугата) за използвания код на ротора.

7.4 Охлаждане (при центрофуги с охлаждане)

7.4.1 Указания за охлаждане



За да се достигне точна температура, преди всяко центрофугиране трябва да се извърши пускане за предварително темперирание от до 60 минути.

Зададената стойност на температурата може да бъде настроена от -20 °C до +40 °C или от -4 °F до +104 °F.

При центрофуги с опция Отопление/охлаждане зададената стойност на температурата може да се настрои от -20 °C до +90 °C или от -4 °F до +194 °F.

Най-ниската достижима температура зависи от ротора.

7.4.2 Охлаждане в режим на готовност

При спиране на ротора и затворен капак камерата на центрофугата се охлажда до предварително избраната температура, когато тя е по-ниска от 20 °C или 68 °F.

По време на охлаждане в режим на готовност се показва предварително избраната температура.

7.4.3 Предварително охлаждане на ротора

За бързо предварително охлаждане на незаредения ротор и на принадлежностите се препоръчва центрофугиране с настройки за продължителен режим и честота на въртене от

- Ротор с променлив ъгъл: ок. 20 % от максималната честота на въртене на използвания ротор.
- Ъглов ротор: ок. 40 % от максималната честота на въртене на използвания ротор.

Цикъл на центрофугиране за предварително охлаждане на ротора, извършвана автоматично с програмата PPEC (ПРЕДВАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ).

Цикъл на центрофугиране за предварително охлаждане на ротора не може да бъде изпълнен, когато се работи с променени програмни връзки.

Роторът е спрял.

1. ➤ Натиснете бутона [Охлаждане].

- Бутонът мига, докато роторът бъде прочетен за предварителното охлаждане.

Когато роторът е прочетен, бутонът свети.

По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и оставащото или изминалото време.

2. ➤ Натиснете бутона [STOP/OPEN].

- Предварителното охлаждане на ротора е завършено.

Спирането се извършва с избраната степен на спиране.

Степента на спиране се показва.

7.4.4 Забавено охлаждане

При необходимост може да се настрои след стартът на цикъла на центрофугиране охлаждането да бъде забавено. Времето на забавяне може да се настройва от 15 до 900 секунди на стъпки от 1 секунда. Фабрично не е настроено време на забавяне.

1.  Натиснете и задръжте натиснат бутон *[PROG]*.
 - След 8 секунди се показва „****Машинно меню****“.
2.  Натискайте бутон *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> *Настройки*“.
3.  Натиснете бутон *[START]*.
 - Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.
4.  Натискайте бутон *[PROG]* многократно, докато се покаже „*Cool acc time = 0*“.
5.  С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
0 = няма време на забавяне
6.  Натиснете бутон *[START]*.
 - Настройката се запаметява.
„*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.
След това се показва „-> *Настройки*“.
7.  Натиснете бутон *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.
или
Натиснете бутон *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

7.4.5 Предотвратяване на включване на охлаждането по време на спиране

Може да се настрои така, че в края на цикъла на центрофугиране, след достигане на зададена скорост, охлаждането повече да не се включва по време на спиране.

С това се предотвратява евентуално завихряне на утайката в пробата.

Оборотите могат да се настройват от 0 об./мин. до максималните обороти на ротора (N_{max}) на стъпки от 10.

1.  Натиснете и задръжте натиснат бутон *[PROG]*.
 - След 8 секунди се показва „****Машинно меню****“.
2.  Натискайте бутон *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> *Настройки*“.
3.  Натиснете бутон *[START]*.
 - Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.
4.  Натискайте бутон *[PROG]* многократно, докато се покаже „*Cool dec speed = ... rpm*“.
5.  С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
6.  Натиснете бутон *[START]*.
 - Настройката се запаметява.
„*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.
След това се показва „-> *Настройки*“.

7.  Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „****Машинно меню****“.

7.4.6 Мониторинг на температурата

Мониторингът на температурата служи за защита на чувствителни към температурата проби.

След достигане на зададения температурен диапазон температурата се проследява. Зададеният температурен диапазон се определя като зададената температура $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Ако температурата в камерата на центрофугата превиши зададената температура със стойността „*Error 58 Temp*“ за повече от 2 минути, центрофугирането се прекъсва и се показва съобщение за грешка „*°C/ * -ERROR 58.6*“.

Ако температурата в камерата на центрофугата не достигне зададената температура със стойността „*Error 58 Temp*“ за повече от 2 минути, центрофугирането се прекъсва и се показва съобщение за грешка „*°C/ * -ERROR 58.7*“.

1.  Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „****Машинно меню****“.
2.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> *Настройки*“.
3.  Натиснете бутона [START].
 - Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.
4.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „*Error 58 Temp 15 °C*“.
5.  С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.
Може да се настройва от 4°C до 25°C на стъпки от 1°C , както и настройката "disabled". С настройката "disabled" мониторингът на температурата се деактивира.
6.  Натиснете бутона [START].
 - Настройката се запамятава.
„*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.
След това се показва „-> *Настройки*“.
7.  Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „****Машинно меню****“.

7.5 Отопление (при центрофуги с отопление)

По време на цикъл на центрофугиране при необходимост камерата на центрофугата се загрява до предварително избраната температура. При спиране на ротора отоплението се изключва.

Роторите с променлив ъгъл и ъгловите ротори трябва да работят с максималната честота на въртене.

**ВНИМАНИЕ****Опасност от изгаряне поради горещи повърхности.**

Температурата на повърхността на нагревателния елемент в камерата на центрофугата може да достига до 500 °C или 932 °F.

- Не докосвайте нагревателния елемент.

**УКАЗАНИЕ****Повреди на пластмасовите носачи поради твърде висока температура**

- Пластмасовите носачи могат да се използват само при температури до максимум 40 °C или 104 °F.



За да се достигне точна температура, преди всяко центрофугиране трябва да се извърши пускане за предварително темпериране от до 60 минути.

активирани / деактивирани

Роторът е спрял.

1. Натискайте бутона [T/°C] многократно, докато се покаже „Heater = off“ или „Heater = on“.
2. Настройте с [Въртящ се бутон] „off“ или „on“.
off = отоплението е деактивирано
on = отоплението е активирано
3. Натиснете [T/°C] или бутона [START].
 Настройките се запаметяват.
Показват се данните за центрофугирането.

7.6 Машинно меню

7.6.1 Запитване за системна информация

Може да се извърши запитване за следната системна информация.

- Модел на центрофугата
- Мрежово напрежение
- Информация за ротора
- Програмна версия на центрофугата
- Програмна версия на честотния преобразувател

Роторът е спрял.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Info“.
3. Натиснете бутона [START].
 Показва се моделът на центрофугата.
4. Натиснете бутона [PROG].
 Показва се захранващото напрежение.

5.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показват се кодът на ротора (Rotor), максималните обороти на ротора (Nmax) и радиусът на центрофугиране (R) на последния разпознат ротор чрез разпознаването на ротора.
Последният разпознат ротор е обозначен със звездичка (*).
С [Въртящ се бутон] може да бъде показана информация за роторите, разрешени за центрофугата.
6.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се програмната версия на центрофугата.
7.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се програмната версия на честотния преобразувател.
8.  Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете менюто „-> Info“
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] три пъти, за да напуснете „***Машинно меню***“.

7.6.1.1 Адрес на центрофугата

Адресът на центрофугата е фабрично настроен на]=29.

7.6.2 Брояч на циклите

Центрофугата е оборудвана с брояч на цикли. Броячът на циклите отброява работните цикли (циклите на центрофугиране) на различни кодове на ротора.

При ротори с променлив ъгъл броячът на циклите използва за определяне на работните цикли (циклите на центрофугиране) носачите.

Когато роторът бъде разпознат от разпознаването на ротора за първи път, центрофугирането се прекъсва. „Enter max cycles = {30000}“ се показва след натискане на произволен бутон. Максималният брой цикли на работа, посочени върху носача, трябва да бъде въведен, преди центрофугирането да може да бъде рестартирано.

Броячът на цикли може да бъде деактивиран за ротори и носачи, които не са маркирани с максимално допустимия брой работни цикли. При всяко отваряне на капака за кратко се показва броят на работните цикли (циклите на центрофугиране) на използвания код на ротора.

Ако максималния брой въведени работни цикли на носача е превишен, след всеки старт на цикъл на центрофугиране се показва „*MAX CYCLES PASSED*“.

Цикълът на центрофугиране трябва да бъде стартиран отново. Носачите трябва да бъдат заменени с нови.

Ако носачите са били заменени, броячът на цикли на „0“ трябва да бъде нулиран.

Въвеждане на максималния допустим брой работни цикли

След стартиране на първия цикъл на центрофугиране трябва да бъде въведен максималният допустим брой работни цикли.

Показва се „Enter max cycles = {30000}“.

1.  С [Въртящ се бутон] настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.

Нулиране на брояча на цикли и въвеждане на максималния допустим брой работни цикли

2. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Настройката се запаметява.
 - „Store max cycles ...“ се показва за кратко.

След поставяне на нови носачи броячът на цикли на „0“ трябва да бъде нулиран. Трябва да се въведе максимално допустимият брой работни цикли.

1. ▶ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - ▶ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.
3. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Показват се външните работни часове.
4. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покажат работните цикли.
5. ▶ Натиснете бутона [RCF].
 - ▶ Броят на работните цикли се показва в скоби ().
6. ▶ Завъртете [Въртящ се бутон] наляво, за да нулирате броя на работните цикли на „0“.
7. ▶ Натиснете бутона [RCF].
 - ▶ Максимално допустимият брой на работните цикли се показва в скоби ().
8. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.
9. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Настройките се запаметяват.
 - „Store cycles ...“ се показва за кратко.
 - Показват се работните цикли.
10. ▶ Натиснете бутона [OPEN/STOP] два пъти, за да напуснете менюто „Operating Time“
или
Натиснете бутона [OPEN/STOP] три пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

Активиране на брояча на цикли

Роторът е спрял.

1. ▶ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - ▶ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.
3. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Показват се външните работни часове.
4. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже деактивираният брояч на цикли „Cycles = disabled“.
Ако работните цикли се показват, броячът на цикли вече е активиран.
5. ▶ Натискайте бутона [RCF] многократно, докато максимално допустимият брой работни цикли се покаже в скоби ().
6. ▶ С [Въртящ се бутон] настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.

7. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Настройките се запамятват.
 - „Store cycles ...“ се показва за кратко.
 - Показват се работните цикли.
8. ➤ Натиснете бутона [OPEN/STOP] два пъти, за да напуснете менюто „Operating Time“
или
Натиснете бутона [OPEN/STOP] три пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

Деактивиране на брояча на цикли

Роторът е спрян.

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.
3. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показват се външните работни часове.
4. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже деактивираният брояч на работните цикли.
Ако се показва „Cycles = disabled“, броячът на цикли вече е деактивиран.
5. ➤ Натискайте бутона [RCF] многократно, докато максимално допустимият брой работни цикли се покаже в скоби ().
6. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте максимално допустимия брой работни цикли на „0“.
7. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Настройките се запамятват.
 - „Store cycles ...“ се показва за кратко.
 - Показва се „Cycles = disabled“.
8. ➤ Натиснете бутона [OPEN/STOP] два пъти, за да напуснете менюто „Operating Time“
или
Натиснете бутона [OPEN/STOP] три пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.3 Запитване на работните часове, циклите на центрофугиране и брояча на цикли

Работните часове се разделят на вътрешни и външни работни часове.

- Вътрешни работни часове („OP Time int =“): Общото време, в което е било включено устройството.
- Външни работни часове („OP Time ext =“): Общото време на досегашните цикли на центрофугиране.

Роторът е спрян.

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.

3.  Натиснете бутона [START].
 - Показва се „OP Time ext =“.
4.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се „OP Time int =“.
5.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се „Number of Starts =“.
Това е броят на всички цикли на центрофугиране.
6.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се „Cycles =“.
Това е броят на работните цикли (цикли на центрофугиране) на кода на ротора, който се използва от последното нулиране на брояча на цикли на „0“ и максимално допустимият брой работни цикли.
7.  Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се „Rotor cycles total =“.
Това е броят на всички работни цикли (цикли на центрофугиране) на използвания код на ротора.
8.  Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете менюто „> Operating Time“
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] три пъти, за да напуснете „***Машинно меню***“.

7.6.4 Активиране или деактивиране на Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)

Ако функцията „Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)“ е активирана, може да се настрои кога да започне отброяването на времето на работа при даден цикъл на центрофугиране. Функцията е активирана фабрично.

Роторът е спрял.

1.  Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3.  Натиснете бутона [START].
 - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „Активиран Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)“ или „Деактивиран Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)“.
5.  Настройте с [Въртящ се бутон] „enabled“ или „disabled“.
disabled = Функцията е деактивирана
enabled = Функцията е активирана
6.  Натиснете бутона [START].
 - Настройките се запаметяват.
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.
След това се показва „-> Настройки“.

7. ➤ Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
- или
- Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.5 Активиране или деактивиране на степени на спиране В



Степените на спиране В могат да бъдат настроени само при ротори, които са подходящи за употребата на торбички с кръв.

- Настройката на степени на спиране В е възможна само когато тя е активирана.
- Настройката на времената на спиране е възможна само когато тя е активирана.

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
 2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
 3. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
 4. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
 5. ➤ Настройте с [Въртящ се бутон] „Off“ или „on“.

off = деактивирани степени на спиране В,
on = активирани степени на спиране В
 6. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Настройките се запамятват.
 - „Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.
 - След това се показва „-> Настройки“.
 7. ➤ Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
- или
- Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.6 Активиране или деактивиране на времената на пускане и времената на спиране

Роторът е спрял.

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „Ramp Unit = Steps“ или „Ramp Unit = Steps / Time“.

5. ► Настройте с [Въртящ се бутон] „Steps“ или „Steps / Time“.
Steps = Деактивирани времена на пускане и спиране,
Steps / Time = Активирани времена на пускане и спиране.
6. ► Натиснете бутона [START].
 - Настройката се запамятава.
 - „Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко.
 - След това се показва „-> Настройки“.
7. ► Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.7 Заклучване на програма

При спрян ротор могат да бъдат настроени следните заключвания на програми:

LOCK 1	Показва се LOCK 1. Програмите могат само да бъдат извиквани, но не и променени.
LOCK 2	Показва се LOCK 2. Не могат да бъдат извиквани и променени никакви програми. Центрофугата може да бъде управлявана чрез интерфейса (само при центрофуга с интерфейс).
LOCK 3	няма индикация за статуса Няма заключване на програми. Програмите могат да бъдат извиквани и променени.

1. ► Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ► Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Change Lock“.
3. ► Натиснете бутона [START].
 - Показва се статусът на заключване.
 - Ако не е въведен PIN, показва се например „LOCK = (3) confirm by START“.
 - Ако е въведен PIN, показва се например „LOCK = 3“.
4. ► С [Въртящ се бутон] настройте желаните статус.
Ако е въведен PIN, показва се „PIN = ---- confirm by START“. В този случай валидният PIN трябва първо да бъде зададен с [Въртящ се бутон] и след това трябва да бъде натиснат бутонът [START], преди да може да се зададе статус на заключване.
5. ► Натиснете бутона [START].
 - Настройката се запамятава.
 - напр. „Store LOCK 2“ се показва за кратко.
 - След това се показва „-> Change Lock“.

6. ➤ Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.
- или
- Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

7.6.8 PIN (персонален идентификационен номер)

Може да се зададе PIN, за да се предотврати промяна на заключването на програмата от неоторизирани лица. Фабрично не е настроен PIN.

Настройка или промяна на PIN

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
 - След 8 секунди се показва „****Машинно меню ****“.
2. ➤ Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*-> Change PIN*“.
3. ➤ Натиснете бутона *[START]*.
 - Показва се „*old PIN = ---- <START>*“.
4. ➤ С *[Въртящ се бутон]* настройте валидния PIN.

Ако PIN се настройва за първи път, тогава прескочете тази стъпка или настройте „*0000*“.

Помощ за въвеждане: Задръжте съответния бутон натиснат.

Бутон <i>[Параметри на пускане и спиране]</i>	само знакът за хилядите на PIN се променя.
Бутон <i>[RCF]</i>	само знакът за стотиците на PIN се променя.
Бутон <i>[RPM]</i>	само знакът за десетиците на PIN се променя.

5. ➤ Натиснете бутона *[START]*.
 - Показва се „*new PIN = ---- <START>*“.
 - Ако е настроен неверен PIN, отново се показва „*old PIN = ---- <START>*“. В този случай настройте с *[Въртящ се бутон]* валидния PIN и натиснете бутона *[START]*.
 6. ➤ С *[Въртящ се бутон]* настройте новия PIN.
За деактивиране на PIN трябва да настроите „*0000*“.
 7. ➤ Натиснете бутона *[START]*.
 - Настройката се запамятава.
 - „*Store PIN ...*“ се показва за кратко.
 - След това се показва „*-> Change PIN*“.
 8. ➤ Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.
- или
- Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

Процедура при изгубен PIN

Ако PIN кодът бъде изгубен, може да се извлече така нареченият номер за помощ. С помощта на този номер производителят може да изчисли PIN, който замества предишния валиден PIN.

1.  Задръжете натиснат бутона [PROG] за 8 секунди.
След 8 секунди в индикацията се появява „***Машинно меню***“.
2.  Натиснете бутона [PROG], докато се покаже „-> Change PIN“.
3.  Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „old PIN = ---- <START>“.
4.  Натиснете бутона [PROG].
➔ Показва се „Get HELP # no“.
След извличане на номера за помощ предишният PIN става невалиден.
5.  Настройте с [Въртящ се бутон] „yes“.
6.  Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „Are you sure ? no“.
7.  Настройте с [Въртящ се бутон] „yes“.
8.  Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „HELP # = 5487“.
Запишете си този помощен номер и го използвайте, за да поискате необходимия PIN код. Задайте нов PIN, като използвате получения PIN

7.6.9 Звуков сигнал

7.6.9.1 Обща информация

Звуковият сигнал прозвучава:

- след възникване на неизправност на интервал от 2 сек.
- след завършване на цикъла на центрофугиране и спиране на ротора на интервал от 30 сек.

При отваряне на капака или натискане на произволен бутон звуковият сигнал спира.

7.6.9.2 Активиране или деактивиране на звуковия сигнал

Роторът е спрял.

1.  Натиснете и задръжете натиснат бутона [PROG].
➔ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3.  Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
„SOUND / BELL“: сигнал след завършване на цикъл на центрофугиране
4.  Настройте с [Въртящ се бутон] „off“ или „on“.
off = деактивиран звуков сигнал
on = активиран звуков сигнал
5.  Натиснете бутона [PROG].
➔ Показва се „SOUND / BELL error = on“ или „SOUND / BELL error = off“.
„SOUND / BELL error“: сигнал след възникване на неизправност

6. ➤ Настройте с [Въртящ се бутон] „Off“ или „on“.
off = деактивиран звуков сигнал
on = активиран звуков сигнал
7. ➤ Натиснете бутона [START].
➔ Настройката се запамятава.
„Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко.
След това се показва „-> Настройки“.
8. ➤ Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „***Машинно меню***“.

7.6.10 Показани данни за центрофугиране след включване

След включване се показват данните за центрофугиране на програма 1 или на последната използвана програма.

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
➔ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. ➤ Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „Start program = Last“ или „Start program = First“.
5. ➤ Настройте с [Въртящ се бутон] „Last“ или „First“.
Last = последна използвана програма
First = програма 1
6. ➤ Натиснете бутона [START].
➔ Настройките се запамятават.
„Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко.
След това се показва „-> Настройки“.
7. ➤ Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.11 Настройка на температурата (при центрофуги с охлаждане)

Температурата може да се въведе в градуси по Целзий (°C) или в градуси по Фаренхайт (°F).

1. ➤ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
➔ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. ➤ Натиснете бутона [START].
➔ Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.

4. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „Temp Unit = Фаренхайт“ или „Temp Unit = Целзий“.
5. ▶ Настройте с [Въртящ се бутон] „Целзий (°C)“ или „Фаренхайт (°F)“.
Celsius = стойности по Целзий (°C)
Fahrenheit = стойности по Фаренхайт (°F)
6. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Настройката се запамятава.
„Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко.
След това се показва „-> Настройки“.
7. ▶ Натиснете бутона [OPEN/STOP] веднъж, за да напуснете менюто „Настройки“
или
Натиснете бутона [OPEN/STOP] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.6.12 Фоново осветление на индикацията

При центрофуги с програмна версия от V01.18:

За пестене на енергия фоновото осветление на дисплея може да се изключи след 2 минути.

1. ▶ Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - ▶ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. ▶ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „ Power save = on“ или „ Power save = off“..
Power save : Автоматично изключване на фоновото осветление
5. ▶ Настройте с [Въртящ се бутон] „off“ или „on“.
off = деактивиране на автоматичното изключване
on = активирано автоматично изключване
6. ▶ Натиснете бутона [START].
 - ▶ Настройката се запамятава.
„Запамятаване на настройките...“ се показва за кратко.
След това се показва „-> Настройки“.
7. ▶ Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“
или
Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

7.7 Програмни връзки

7.7.1 Свързване на програми или промяна на програмна връзка



Могат да бъдат запаметени 25 програмни връзки (програмни места от A до Z, програмно място J липсва).

Една програмна връзка може да се състои максимум от 20 програми.

В една програмна връзка оборотите винаги се адаптират от една програма към друга с пусковия параметър на следващата програма.

В една програмна връзка не могат да се променят параметри на центрофугиране. Промяна на параметър е възможна само в отделните програми.

Не могат да се свързват програми за продължителна работа или програми с времена на пускане и спиране.

С бутона [TIME] общото време на изпълнение на програмната връзка и времето на изпълнение на текущо изпълняваната програма могат да бъдат извикани по време на центрофугирането.

Програмните връзки са активирани.

1. ➤ Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „EDIT A... Z“.
2. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте желаното програмно място, в което трябва да бъде запаметена програмната връзка.
3. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показват се програмното място на програмната връзка и първата програма на програмната връзка.
4. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте първата програма на програмната връзка.
5. ➤ Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се следващата програма на програмната връзка.
6. ➤ С [Въртящ се бутон] настройте следващата програма на програмната връзка.
7. ➤ Натиснете бутона [PROG].
 - Показва се следващата програма на програмната връзка.
8. ➤ Повтаряйте стъпки 6 и 7 дотогава, докато бъдат настроени всички програми.
9. ➤ Настройте с [Въртящ се бутон] „END“. За целта завъртете въртящия се бутон обратно на часовниковата стрелка.

При програмни връзки, които се състоят от 20 програми, след 20-ата програма не може да се настрои „END“.
10. ➤ Натиснете бутона [START].
 - Показва се „STO B“.
11. ➤ Натиснете бутона [START], за да запаметите програмната връзка.
 - „Multi program store...“ се показва за кратко.

7.7.2 Извикване на програмна връзка

1.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „RCL A... Z“.
2.  С [Въртящ се бутон] настройте желаното програмно място.
3.  Натиснете бутона [START].

➔ „Multi program recall...“ се показва за кратко.

Показват се данните на центрофугирането на първата програма на програмната връзка, както и общото време на работа на програмната връзка.

7.7.3 Активиране или деактивиране на програмни връзки

1.  Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
 - ➔ След 8 секунди се показва „***Машинно меню***“.
2.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3.  Натиснете бутона [START].
 - ➔ Показва се „SOUND / BELL = off“ или „SOUND / BELL = on“.
4.  Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „ Multi programs = off“ или „ Multi programs = on“..
5.  Настройте с [Въртящ се бутон] „off“ или „on“.

off = деактивирана програмна връзка

on = активирана програмна връзка

6.  Натиснете бутона [START].
 - ➔ Настройката се запаметява.
 - „Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.
 - След това се показва „-> Настройки“.
7.  Натиснете бутона [STOP/OPEN] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.

или

Натиснете бутона [STOP/OPEN] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

8 Почистване и полагане на грижи

8.1 Таблица за преглед

Глава	Задача за изпълнение	при необходимост	ежедневно	ежеседмично	Ежегодно	Страница
8	Почистване и полагане на грижи					67
8.3	Почистване					69
8.3	Почистване на устройството		X			69

Глава	Задача за изпълнение	при необходимост	ежедневно	ежеседмично	Ежегодно	Страница
8.3	Почистване на системата за биобезопасност			X		69
8.3	Почистване на принадлежностите			X		69
8.4	Дезинфекция					70
8.4	Дезинфекциране на устройството	X				70
8.4	Дезинфекциране на принадлежностите	X				70
8.5	Поддръжка					71
8.5	Смазване на гуменото уплътнение на камерата на центрофугата			X		71
8.5	Смазване на гуменото уплътнение на системата за биобезопасност			X		71
8.5	Смазване на носещата шийка			X		71
8.5	Проверка на принадлежностите			X		71
8.5	Проверка на системата за биобезопасност			X		71
8.5	Проверка на камерата на центрофугата за повреди				X	71
8.5	Гресиране на вала на двигателя				X	71
8.5	Принадлежности с ограничен срок на употреба	X				72
8.5	Смяна на центрофужните епруветки	X				72

8.2 Указания за почистване и дезинфекция



ОПАСНОСТ

Риск от замърсяване за потребителя поради недостатъчно почистване или неспазване на указанията за почистване.

- Спазвайте указанията за почистване.
- При почистване на устройството носете лична предпазна екипировка.
- Спазвайте лабораторните разпоредби (напр. TRBA, IfSG, хигиенен план) за работа с биологични агенти.

- Устройството и принадлежностите не трябва да се почистват в съдомиялни машини.
- Извършвайте само ръчно почистване и дезинфекция с течност.

- Температурата на водата трябва да бъде максимум 25 °C.
- За да се избегнат признаци на корозия, причинени от почистващи препарати или дезинфектанти, трябва да се спазват специалните инструкции за приложение от производителя на почистващия препарат или дезинфектанта.

Дезинфектант:

- Дезинфектант за повърхности (да не се използват дезинфектанти за ръце или инструменти)
- Етанол като единствено активно вещество.
Не дезинфекцирайте прозореца за наблюдение в капака на устройството със смес от етанол и пропанол.
- Концентрацията не трябва да е под 30 %
- рН стойност: 6 - 8
- Да не причинява корозия

8.3 Почистване

Почистване на устройството

1. ► Отворете капака.
2. ► Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. ► Извадете принадлежностите.
4. ► Почистете корпуса на центрофугата и камерата на центрофугата със сапун или мек почистващ препарат и влажна кърпа.
5. ► След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
6. ► Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.
7. ► При образуване на воден конденз подсушавайте камерата на центрофугата с кърпа поемаща влагата.

Почистване на системата за биобезопасност

1. ► Почиствайте системата за биобезопасност с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. ► След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. ► Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и сгъстен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със сгъстен въздух без съдържание на масло.

Почистване на принадлежностите

1. ► Почиствайте принадлежностите с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. ► След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. ► Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и сгъстен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със сгъстен въздух без съдържание на масло.

8.4 Дезинфекция



Дезинфекцията винаги трябва да се предхожда от почистване на съответните компоненти.

Вижте → Глава 8.3 „Почистване“ на страница 69



Концентрация и време на въздействие на дезинфектанта съгласно данните на производителя.

Дезинфекциране на устройството



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради проникване на вода или други течности.

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не извършвайте дезинфекция със спрей на устройството.

1. ▶ Отворете капака.
2. ▶ Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. ▶ Извадете принадлежностите.
4. ▶ Почистете корпуса и камерата на центрофугата с дезинфектант.
5. ▶ След използване на дезинфектанти отстранете остатъците от дезинфектанти с влажна кърпа.
6. ▶ Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.

Дезинфекциране на принадлежностите

1. ▶ Дезинфекцирайте принадлежностите с дезинфектант.
2. ▶ Нанесете във всички кухини без образуване на мехурчета въздух дезинфектант.
3. ▶ След употребата на дезинфектант отстранете или оставете да изсъхнат остатъците от дезинфектанта.

Автоклавиране

Следните принадлежности могат да се автоклавира при 121 °C / 250 °F (20 мин.):

- Ротори с променлив ъгъл
- Ъглови ротори от алуминий
- Носачи от метал
- Капак с биологично уплътнение
- Адаптер

Не може да се декларира степента на стерилност.

Капаците на роторите и носачите трябва да бъдат свалени преди автоклавиране.

Автоклавирането ускорява процеса на стареене на материалите. То може да причини промяна на цвета. След автоклавирането роторите и принадлежностите трябва да бъдат визуално проверени за повреда и евентуално повредените части веднага трябва да бъдат заменени.

При признаци на образуване на пукнатини, порьозност и износване засегнатият уплътнителен пръстен трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

За да се гарантира уплътняването на системите за биобезопасност, уплътнителните пръстени трябва да се сменят след автоклавиране.

8.5 Поддръжка

Смазване на гуменото уплътнение на камерата на центрофугата

—> Лекото нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддръжане на гума.

Смазване на гуменото уплътнение на системата за биобезопасност

—> Лекото нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддръжане на гума.

Смазване на носещата шийка

1. > Отстранете принадлежностите.
2. > Почистете носещата шийка.
3. > След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
4. > Смажете носещата шийка и носачите с канал с Hettich Tubenfett 4051.
5. > Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Проверка на принадлежностите

1. > Принадлежностите трябва да се проверят за износване и повреди от корозия.
2. > Проверете ротора за добро затягане.

Проверка на системата за биобезопасност

1. > Проверете всички части на системата за биобезопасност визуално за повреди.
2. > Проверете правилното място на монтаж на уплътнителния пръстен респ. уплътнителните пръстени на системата за биобезопасност.
3. > Заменете повредените части на системата за биобезопасност.
4. > При признаци на образуване на пукнатини, порьозност и износване засегнатият уплътнителен пръстен веднага трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

Проверка на камерата на центрофугата за повреди

—> Проверете камерата на центрофугата за повреди.

Гресиране на вала на двигателя

1. > Отстранете принадлежностите.
2. > Почистете вала на двигателя.
3. > След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
4. > Смажете вала на двигателя с Hettich Tubenfett 4051.
5. > Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Принадлежности с ограничен срок на употреба

Употребата на определени принадлежности е ограничена във времето. От съображения за безопасност принадлежностите не могат да бъдат използвани повече или когато достигнат обозначения върху тях максимално допустим брой работни цикли, или е достигнат обозначения върху тях срок на годност.

- Максимално допустимият брой работни цикли или датата на срока на годност са видими върху принадлежностите.
- Центрофугата е оборудвана с брояч на цикли.

Смяна на центрофужните епруветки



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради счупване на стъкло.

Стъклени парчета и замърсени течности могат да бъдат открити вътре в центрофугата поради счупване на стъкло.

- Носете устойчиви на срязване ръкавици.
- Носете предпазни очила и защита за устата.

В случай на течове или след счупване на центрофужните епруветки, счупените части на епруветките, стъклени парчета и разлят материал от центрофугата трябва да бъдат напълно отстранени. Оставащите стъклени парчета причиняват по-нататъшно счупване на стъкла.

Гумените подложки и пластмасовите втулки на роторите трябва да се заменят след счупване на стъкло.

Ако става дума за инфекциозен материал, трябва да се извърши дезинфекция.

9 Отстраняване на неизправности

9.1 Описание на грешката

Ако грешката не може да бъде отстранена според таблицата на неизправностите, трябва да се информира сервизът за клиенти. Посочете типа на центрофугата и серийния номер. И двата номера могат да се прочетат от фирмената табелка на центрофугата.

* Номерът на грешката не се появява в индикацията.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
Няма индикация	Няма напрежение. Сработване на защитата срещу свръхток.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете захранващото напрежение. ■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [//].
TASCH - ERROR 1, 2, 96	Дефектен скоростомер. Дефектни двигател, електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отворете капака. ■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [0]. ■ Изчакайте най-малко 10 секунди. ■ Завъртете силно ротора на ръка. ■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [//]. По време на включването роторът трябва да се върти.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
IMBALANCE 3*	Роторът е зареден неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отворете капака. ■ Проверете зареждането на ротора. ■ Повторете цикъла на центрофугиране.
CONTRO-ERROR 4.1-4.5, 6	Грешка на блокировката на капака.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
N > MAX 5.0, 5.1	Грешка превишени обороти.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
N < MIN 13	Грешка твърде ниски обороти	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
ROTORCODE 10.1-10.3	Грешка на кодирането на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
MAINS INTERRUPT 11*	Прекъсване на електрозахранването по време на цикъл на центрофугиране. Цикълът на центрофугиране не е завършен.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отворете капака. ■ Натиснете бутона [START]. ■ При необходимост: Повторете цикъла на центрофугиране.
VERSION-ERROR 12	Няма съответствие на електронните компоненти, грешка/дефект на електрониката.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
CONTROL-ERROR 25.1-25.4	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
CRC ERROR 27, 27.1	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
SER I/O - ERROR 31, 34, 36	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
° C * -ERROR 51, 53-55	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
° C * - ERROR 52.0, 52.1	Превишена температура в камерата на центрофугата. Грешка/дефектна електроника	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
° C * - ERROR 58.0, 58.1	Отклонението на температурата е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
° C * - ERROR 58.6, 58.7	Отклонението на температурата е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ. ■ Повишена стойност "Error 58 Temp".
FU/CCI-ERROR 60, 61.2-61.20, 61.128-61.132, 62	Грешка/дефектна електроника/двигател.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
FU/CCI-ERROR 61.1	Захранващото напрежение е твърде ниско. Грешка/дефектна електроника/двигател.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете захранващото напрежение. ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
SENSOR-ERROR 90	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
SENSOR-ERROR 91-93	Грешка/дефект на сензора за дебаланс.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
° C * -ERROR 97, 98	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
NO ROTOR OR ROTORCODE ERROR	Няма монтиран ротор. Дефектен скоростомер.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете капака. Монтирайте ротор.
N > ROTOR MAX	Оборотите на избраната програма са по-високи от максималните обороти на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете и коригирайте оборотите.
	Роторът е бил сменен. Монтираният ротор има по-високи максимални обороти от използвания преди това ротор. Роторът не е бил разпознат от разпознаването на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте обороти до максималните обороти на ротора, използван преди това. Натиснете бутона [START], за да извършите разпознаване на ротора.
N > ROTOR MAX в прогр: напр. 3	На показаното програмно място се намира програма, чиито обороти са по-високи от максималните обороти на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете и коригирайте оборотите.
	Роторът е бил сменен. Монтираният ротор има по-високи максимални обороти от използвания преди това ротор. Роторът не е бил разпознат от разпознаването на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте обороти до максималните обороти на ротора, използван преди това. Натиснете бутона [START], за да извършите разпознаване на ротора.
Runtime 00:00 в прогр: напр. 3	На показаното програмно място се намира програма за продължителна работа.	<ul style="list-style-type: none"> Заменете в програмната връзка програмата за продължителна работа с програма с предварителен избор на време.
Empty Program	На показаното програмно място няма запаметена програмна връзка.	<ul style="list-style-type: none"> Извикайте една програмна връзка.
Ramp Unit Time в прогр.: напр. 3	На показаното програмно място има програма с време на пускане и/или време на спиране.	<ul style="list-style-type: none"> Заменете в програмната връзка програмата с програма със степен на пускане и степен на спиране.
Acc time > Run time	Настроеното време на пускане е по-продължително от времето на работа.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте време на пускане, което е по-кратко от времето на работа.
Protected !!	Програмата е защитена срещу запис.	<ul style="list-style-type: none"> Деактивирайте защитата срещу запис на програмата.
FC INIT ERROR	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
FC VERSION ERROR	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
FATAL EEPROM ERROR 1-5	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.
WATCHDOG RESET	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
MAX CYCLES PASSED	Максималният допустим брой работни цикли е превишен.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменете носачите от съображения за безопасност с нови носачи. ■ След замяна на носачите върнете брояча на циклите на "0".
Enter max cycles = <30000>	Подкана за въвеждане на максимално допустимия брой работни цикли, посочени на носачите.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Въведете максималния допустим брой работни цикли.
 Лявата половина на индикацията свети.	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Известете клиентския сервиз.

9.2 Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ

1. ➤ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [0].
2. ➤ Изчакайте 10 секунди.
3. ➤ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя [I].

9.3 Аварийно деблокиране

При спиране на тока капакът не може да се деблокира с двигател. Трябва да се извърши аварийно деблокиране с ръка.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар при дейности по привеждането в изправност и поддръжката при устройство под напрежение.

- Разкачете от мрежата устройството преди дейности по привеждането в изправност и поддръжката.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

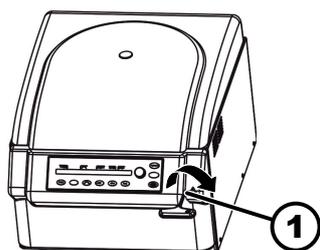
Опасност от порязване и премазване от движещия се ротор.

- Отваряйте капака едва тогава, когато роторът е спрял.

Персонал:

- Обучен потребител

1. ➤ Погледнете през прозореца на капака, за да се уверите, че роторът е спрял.
2. ➤ Вкарайте шестостенния ключ хоризонтално в отвора (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, докато капакът се отвори.
3. ➤ Извадете шестостенния щифтов ключ от отвора (1).



Фиг. 33: Аварийно деблокиране

1 Отвор

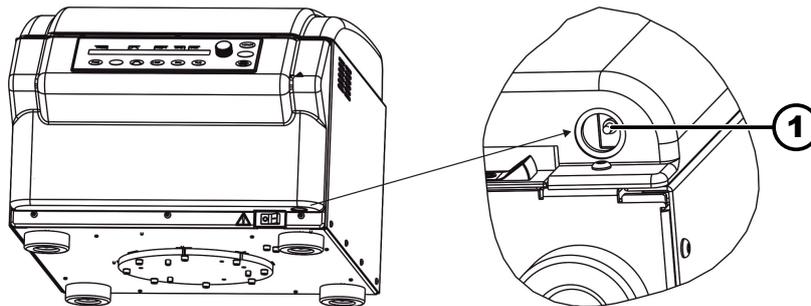
4. ➤ Когато токът отново е налице, проверете дали лявата страна на бутона [STOP/OPEN] мига.

Когато лявата страна на бутона [STOP/OPEN] мига, натиснете бутона [STOP/OPEN], който привежда моторната блокировка на капака отново в основно положение (отворен).

9.4 Включване на предпазния автомат

Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 34: Предпазен автомат

- 1 Пластмасов щифт

Превключвателят на захранването се намира в положение на прекъсвача [O]

Центрофугата е разкачена от електрическата мрежа.

1. ➤ Натиснете пластмасовия щифт (1) на предпазния автомат.
2. ➤ Свържете отново устройството към мрежата.

10 Изхвърляне

10.1 Общи указания



Устройството може да бъде изхвърлено от производителя.

За връщане трябва винаги да се изисква формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA).

При необходимост се свържете с отдела за техническо обслужване на производителя.

- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- Föhrenstrasse 12
- 78532 Tuttlingen, Германия
- Телефон: +49 7461 705 1400
- Имейл адрес: service@hettichlab.com



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от замърсяване за хората и околната среда.

Когато изхвърляте центрофугата, може да възникне замърсяване за хората и околната среда поради неправилно изхвърляне.

- Отстраняването и изхвърлянето могат да се извършват само от обучен и упълномощен сервизен персонал.

Устройството е предназначено за търговския сектор ("Business to Business" - B2B).

Уредите вече не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци съгласно Регламент 2012/19/ЕС.

Уредите са разпределени в следните групи според Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (Германска фондация по гражданско право)):

- Група 1 (топлообменници)
- Група 4 (големи уреди)

Символът със зачеркнат контейнер показва, че устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Нормативната уредба относно изхвърлянето на такива устройства може да се различава в отделните страни. Ако е необходимо, свържете се с доставчика.



Фиг. 35: Забрана за изхвърляне с битовите отпадъци

11 Индекс

А		Л	
Автоклавиране.	70	Лична предпазна скипировка.	7
Адрес на центрофугата.	56	М	
Б		Междинна памет	
Брояч на циклите.	56	автоматична.	51
активиране.	57	МРЕЖОВ РЕСЕТ.	75
Въвеждане на максимална стойност.	56, 57	Н	
деактивиране.	58	Настройка по време на цикъл на центрофугиране.	45
запитване.	58	Носеща шийка	
нулиране.	57	смазване.	71
В		О	
Вал на двигателя		Обороти на изключване на спирачката.	46
смазване.	71	Обороти RPM.	48
Включване.	33	Обхват на доставката.	22
Време на пускане.	46	Общи указания за безопасност.	8
активиране/деактивиране.	60	Оригинални резервни части.	22
Време на работа		Отговорност на оператора.	8
Начало на отброяването.	47	Относително ускорение на центрофугата	
промяна.	47	RCF.	49
Време на спиране.	46	Отстраняване на неизправности.	72
активиране/деактивиране.	60	П	
Връщане.	23	Параметри на пускане и спиране.	46
Г		Поддръжка.	71
Грижа		интервал.	67
интервал.	67	Почистване.	69
Гумено уплътнение		Почистване и дезинфекция	
смазване.	71	Указания.	68
Д		Предвидима погрешна употреба.	7
Данни за центрофугиране след включване.	64	Предназначение.	6
Дезинфекция.	70	Предпазна скипировка.	7
З		Принадлежности.	22
Зареждане.	37	дезинфекциране.	70
Звуков сигнал		почистване.	69
активиране/деактивиране.	63	проверка.	71
И		с ограничен срок на употреба.	72
Изключване.	34	Програма	
Изхвърляне.	76	въвеждане.	51
Инструктаж на персонала.	8	зареждане.	50
Интегрално ускорение на центрофугата		Защита срещу запис.	50
активиране/деактивиране.	48	извикване.	50
запитване.	48	промяна.	51
Интегрално RCF.	48	Програмна връзка	
К		активиране.	67
Камера на центрофугата		деактивиране.	67
проверка.	71	извикване.	67
Капак		промяна.	66
затваряне.	34	създаване.	66
отваряне.	34	Продължителна работа.	44
Квалификации на персонала.	7	Пълнене.	37
Квалификация на персонала.	7	Р	
Краткотрайно центрофугиране.	45	Работни часове	
		запитване.	58
		Радиус на центрофугиране	
		RAD.	49
		Разопаковане.	27

Разпознаване на ротора.	51
Разполагане на центрофугата.	31
Резервни части.	22
Ротор	
демонтаж.	35
зареждане.	37, 38
монтаж.	35
С	
Свързване на центрофугата.	31
Захранване с азот.	32
Символи.	6
Система за биобезопасност	
почистване.	69
проверка.	71
Системна информация	
запитване.	55
Степен на пускане.	46
Степен на спиране.	46
Степени на спиране В	
активиране/деактивиране.	60
Съобщения за грешка.	72
Т	
Табелки	
на опаковката.	17
на устройството.	18
Транспортна осигуровка	
закрепване.	24
отстраняване.	29
У	
Указания за безопасност.	8
Употреба не по предназначение.	7
Условие за транспорт.	23
Условия на съхранение.	24
Устройство	
дезинфекциране.	70
почистване.	69
Ф	
Фирмена табелка.	16
Ц	
Центрофугиране	
с вещества с по-високо относително тегло.	50
с предварителен избор на време.	44
с продължителна работа.	44
Центрофужни спруветки	
смяна.	72
Цикли на центрофугиране	
запитване.	58
Д	
Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)	
активиране/деактивиране.	59

Instrucțiuni de folosire

ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF



Traducerea instrucțiunilor de folosire originale

©2023 - Toate drepturile rezervate

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Germania

Telefon: +49 (0)7461/705-0

Fax: +49 (0)7461/705-1125

E-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Internet: www.hettichlab.com

Cuprins

1	Referitor la acest document.	6
1.1	Utilizarea acestui document.	6
1.2	Indicație referitoare la gen.	6
1.3	Simbolurile și marcajele din acest document.	6
2	Siguranță.	6
2.1	Utilizarea prevăzută.	6
2.2	Cerințe impuse personalului.	7
2.3	Responsabilitatea utilizatorului.	8
2.4	Instrucțiuni de securitate.	8
3	Prezentare generală a aparatului.	10
3.1	Date tehnice.	10
3.2	Înregistrare europeană.	16
3.3	Semne importante pe ambalaj.	17
3.4	Semne importante la aparat.	18
3.5	Elemente de operare și afișare.	19
3.5.1	Unitatea de comandă.	19
3.5.2	Elemente de afișare.	19
3.5.3	Elemente de operare.	19
3.6	Piese de schimb originale.	21
3.7	Pachetul de livrare.	21
3.8	Returnare.	22
4	Transport și depozitare.	22
4.1	Condiții de transport și depozitare.	22
4.2	Fixarea siguranței de transport.	23
5	Punerea în funcțiune.	25
5.1	Despachetarea centrifugei.	25
5.2	Scoaterea siguranței de transport.	27
5.3	Amplasarea și racordarea centrifugei.	30
5.4	Conectarea și deconectarea centrifugei.	32
6	Operare	33
6.1	Deschiderea și închiderea capacului.	33
6.2	Demontarea și montarea rotorului.	33
6.3	Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete.	34
6.4	Introducerea și scoaterea adaptorului.	35
6.5	Încărcarea.	35
6.6	Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică.	37
6.6.1	Explicație.	37
6.6.2	Capac cu închidere filetată și gaură	38
6.6.3	Capac cu etrier și închidere prin strângere.	38
6.6.4	Capac cu închidere filetată.	39
6.6.5	Capac cu închidere prin strângere	39
6.7	Instrucțiune de împachetare HettLiner.	40

6.8	Centrifugare.	42
6.8.1	Centrifugare în rulare de durată.	42
6.8.2	Centrifugare cu preselectare timp.	42
6.8.3	Centrifugare pe timp scurt.	43
6.8.4	Modificarea setărilor în timpul centrifugării.	43
6.9	Funcția de oprire rapidă.	43
7	Operare software.	44
7.1	Parametrii de centrifugare.	44
7.1.1	Parametrii de demarare și oprire inerțială.	44
7.1.2	Timpul de rulare TIME.	45
7.1.3	Turația RPM.	46
7.1.4	Integrala RCF.	46
7.1.5	Temperatura (la centrifuge cu răcire).	47
7.1.6	Accelerația centrifugală relativă, RCF.	47
7.1.7	Accelerația centrifugală relativă RCF și Raza de centrifugare RAD.	47
7.1.8	Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm ³	48
7.2	Programare.	48
7.2.1	Protecție la scriere pentru programe.	48
7.2.2	Accesarea sau încărcarea programului.	48
7.2.3	Introducerea sau modificarea programului.	49
7.2.4	Memorie intermediară automată.	49
7.3	Identificare rotor.	49
7.4	Răcire (la centrifuge cu răcire).	50
7.4.1	Indicații privitoare la răcire.	50
7.4.2	Răcire în standby.	50
7.4.3	Răcirea preliminară a rotorului.	50
7.4.4	Răcire temporizată.	51
7.4.5	Împiedicarea pornirii răcirii în timpul evacuării.	51
7.4.6	Monitorizarea temperaturii.	52
7.5	Încălzire (la centrifuge cu încălzire).	52
7.6	Machine Menu.	53
7.6.1	Interogarea informațiilor de sistem.	53
7.6.1.1	Adresa centrifugei.	54
7.6.2	Contor de cicluri.	54
7.6.3	Interogarea orelor de funcționare, rulărilor de centrifugare și contorului de cicluri.	56
7.6.4	Activarea sau dezactivarea Dual time mode.	57
7.6.5	Activarea sau dezactivarea treptelor de frânare B.	58
7.6.6	Activarea și dezactivarea timpilor de demarare și oprire inerțială.	58
7.6.7	Blocare program.	59
7.6.8	PIN (Număr de identificare personal).	59

7.6.9	Semnal acustic.	61
7.6.9.1	Generalități.	61
7.6.9.2	Activarea sau dezactivarea semnalului acustic.	61
7.6.10	Datele de centrifugare afișate după conectarea	61
7.6.11	Setarea unității de măsură a temperaturii (la centrifuge cu răcire).	62
7.6.12	Iluminarea de fundal a afișajului.	62
7.7	Înlănțuiri de programe.	63
7.7.1	Înlănțuirea programelor sau modificarea unei înlănțuiri de programe.	63
7.7.2	Accesarea înlănțuirii de programe.	64
7.7.3	Activarea sau dezactivarea înlănțuirilor de programe.	64
8	Curățarea și îngrijirea.	65
8.1	Tabel de prezentare generală.	65
8.2	Indicații privind curățarea și dezinfectarea.	66
8.3	Curățare.	66
8.4	Dezinfectare.	67
8.5	Întreținere.	68
9	Remedierea defecțiunilor.	69
9.1	Descrierea erorii.	69
9.2	Executare RESETARE REȚEA.	72
9.3	Deblocare de urgență.	72
9.4	Conectarea disjuncteurului de circuit	73
10	Eliminare.	73
10.1	Indicații generale.	73
11	Index.	75

1 Referitor la acest document

1.1 Utilizarea acestui document

- Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, citiți cu atenție și complet acest document, Dacă este cazul, respectați celelalte file de indicații atașate.
- Acest document este componentă a aparatului și trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil.
- Transmiteți și acest document la predarea aparatului către un terț.
- Versiunea actuală a documentului în limbile disponibile poate fi găsită pe pagina Internet a producătorului: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

1.2 Indicație referitoare la gen

Utilizarea formei de exprimare masculine sau feminine ajută la lizibilitatea mai ușoară. În sensul tratării egale, noțiunile corespunzătoare sunt valabile în principiu pentru toate genurile și nu conțin nicio evaluare.

1.3 Simbolurile și marcajele din acest document

Simboluri generale

Pentru evidențierea instrucțiunilor de acțiune, a rezultatelor, a listelor, trimerilor de referință și a altor elemente, în prezentul document se folosesc următoarele marcaje:

Marcaj	Explicație
1.  2.  3.  ... 	Instrucțiuni de acțiune pas cu pas
	Rezultatele pașilor de acțiune
	Trimeri la secțiunile documentului și la documentele însoțitoare aplicabile
■ ... ■ ...	Enumerări fără ordine stabilită
[Buton]	Elemente de operare (de exemplu: buton, comutatoare)
„Afișaje”	Elemente de afișare (de exemplu: lumini de semnalizare, elemente de pe ecran)

2 Siguranță

2.1 Utilizarea prevăzută

Utilizarea prevăzută

Aparatul prezentat este o centrifugă de laborator, adecvată pentru aplicații medicale.

Scopul ei terapeutic exclusiv este centrifugarea sângelui în sistemele de punji de sânge. Componentele sângelui separate sunt transferate de alt aparat (separator) în punji satelit corespunzătoare. Componentele individuale obținute astfel sunt apoi utilizate la transfuzie sau autotransfuzie.

Utilizarea centrifugei este permisă numai personalului calificat, în centre de donare a sângelui sau în spitale.

Centrifuga este destinată numai pentru scopurile de utilizare specificate mai sus.

O altă utilizare sau o utilizare care depășește specificațiile este considerată necorespunzătoare. Pentru daunele care rezultă din aceasta, firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nu își asumă nicio responsabilitate.

Utilizarea corespunzătoare include și respectarea tuturor indicațiilor din manualul de utilizare și respectarea intervalelor de inspecție și întreținere.

Utilizarea neprevăzută

- Centrifuga nu este prevăzută pentru utilizare în atmosfere explozive, radioactive, contaminate biologic sau chimic.
- La centrifugarea substanțelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate. Producătorul recomandă din principiu ca pentru substanțele periculoase să fie utilizate numai recipiente de centrifugare cu capace filetate speciale. La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale inflamabile sau explozive.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale care reacționează între ele chimic cu energie ridicată.

Utilizare greșită previzibilă

În cadrul utilizării corespunzătoare, producătorul recomandă utilizarea numai a accesoriilor autorizate de el.

Exploatați centrifuga numai sub supraveghere.

2.2 Cerințe impuse personalului

Calificări necesare

Utilizatorul a citit complet instrucțiunile de utilizare și s-a familiarizat cu aparatul.



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparate de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.

Utilizator instruit

Utilizatorul este pregătit sau instruit în domeniul lucrărilor de laborator și este capabil să execute lucrările care îi sunt atribuite precum și să identifice și să evite în mod independent pericolele potențiale.

Echipament individual de protecție

Echipamentul individual de protecție lipsă sau neadecvat mărește riscul de afectare a sănătății și de accidentare.

- Folosiți numai echipament individual de protecție care este în stare corespunzătoare.
- Folosiți numai echipament individual de protecție care este potrivit pentru persoană (de ex. ca mărime).
- Respectați indicațiile cu privire la alte echipamente de protecție la activități specifice.

2.3 Responsabilitatea utilizatorului



Pentru o utilizare regulamentară și sigură a aparatului, respectați instrucțiunile din prezentul document.

Păstrați manualul de utilizare pentru consultarea ulterioară.

Punerea la dispoziție a informațiilor

- Respectarea instrucțiunilor din prezentul document servește la:
 - Evitarea situațiilor periculoase.
 - Minimizarea costurilor cu reparațiile și a timpilor de indisponibilitate.
 - Îmbunătățirea fiabilității și duratei de viață funcțională a aparatului.
- Pentru respectarea prescripțiilor operaționale, a standardelor și legislației naționale este responsabil utilizatorul.
- Notarea și păstrarea separată a ediției documentului. În caz de pierdere, documentul poate fi înlocuit cu ediția corectă.
- Punerea la dispoziție a manualului de utilizare la locul de utilizare al aparatului.
- În caz de vânzare a aparatului, predarea manualului de utilizare cumpărătorului.

Instruirea personalului

Datorită lipsei cunoștințelor privind lucrul cu aparatul, persoanele pot fi accidentate grav sau mortal.

- Instruirea personalului în privința sarcinilor atribuite și a riscurilor asociate acestora.

2.4 Instrucțiuni de securitate



Mesaje privind evenimente grave și incidente cu obligativitate de raportare

În cazul evenimentelor grave și a situațiilor cu obligativitate de raportare privind aparatul sau accesoriile acestuia, acestea trebuie raportate producătorului și, dacă este cazul, autorității competente la care este înregistrat utilizatorul și/sau pacientul.



PERICOL

Pericol de contaminare pentru utilizator datorită curățării insuficiente sau a nerespectării prescripțiilor de curățare.

- Respectați prescripțiile de curățare.
- La curățarea aparatului, purtați echipament individual de protecție.
- Respectați regulile de laborator (de exemplu TRBA-uri, IfSG, Planul de igienă) pentru manipularea agenților biologici.

**PERICOL**

Pericol de incendiu și explozie datorită materialelor periculoase din probe.

- Respectați prescripțiile și directivele în vigoare pentru manipularea substanțelor chimice și a substanțelor periculoase.
- Nu utilizați substanțe chimice periculoase (de ex.: agenți de extracție periculoși sau corozivi cum sunt clorofomul, acizi puternici).

**AVERTIZARE**

Pericole datorită întreținerii insuficiente sau nerealizate la timp.

- Respectați intervalele de întreținere.
- Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări sau deficiențe vizibile.

În cazul deteriorărilor sau deficiențelor vizibile, scoateți din funcțiune aparatul și informați tehnicianul de service.

**AVERTIZARE**

Pericol de electrocutare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu vărsați lichide în interiorul aparatului.
- Executați transportul în ambalajul original de transport.

**AVERTIZARE**

Contaminarea cu substanțe și amestecuri de substanțe periculoase!

La substanțele și amestecurile de substanțe care sunt toxice, radioactive și/sau contaminate cu microorganisme patogene, respectați următoarele măsuri:

- Folosiți întotdeauna numai recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, aparatul nu este etanș microbiologic în sensul standardului EN / IEC 61010-2-020.
- Dacă este necesar, luați legătura cu producătorul.

**AVERTIZARE**

Pericol de vătămare și deteriorare a aparatului datorită rotorului slăbit.

- La montarea rotorului, elementul de antrenare a arborelui rotorului trebuie să se așeze corect în canelura rotorului.
- Strângeți manual piulița pentru fixarea rotorului.
- Verificați fixarea rotorului.
- Respectați intervalele de întreținere.

**ATENȚIE**

Pericol de vătămare datorită rotorului în rotație

Dacă rotorul este mișcat manual, se pot prinde de rotor părul lung sau părți ale îmbrăcămînții.

- Legați părul lung.
- Nu lăsați părți ale îmbrăcămînții să atârne în camera de centrifugare.

**INDICAȚIE**

Defecțiunea sistemului electronic al aparatului datorită tensiunii sau frecvenței greșite la comutatorul de protecție al aparatului.

- Operați aparatul cu tensiunea de rețea și frecvența de rețea corecte.
Valoarea poate fi găsită în datele tehnice și pe plăcuța tip.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului și a probelor din cauza întreruperii premature a programului.

O întrerupere prematură a programului se produce la o cădere a curentului de alimentare, deconectarea în timpul executării programului sau la scoaterea ștecherului din priză.

- Nu deconectați aparatul în timpul executării programului.
- Nu deblocați de urgență aparatul în timpul executării programului.
- În timpul executării programului, nu scoateți ștecherul din priză.

3 Prezentare generală a aparatului

3.1 Date tehnice

Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Model	ROTANTA 460	
Tip	5650	5650-01
Tensiune de rețea ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~	100-127 V 1~

Frecvența rețelei	50-60 Hz	50-60 Hz
Sarcina racordată	1000 VA	1100 VA
Consum de curent	5,0 A	11,0 A
Capacitate max.	4 x 1000 ml	
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm ³	
Turația max. (RPM)	15000	
Accelerația max. (RCF)	24400	
Energia cinetică max.	41000 Nm	
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da	
Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):		
Loc de amplasare	numai în spațiul interior	
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării	
Temperatura ambiantă	2 °C până la 35 °C	
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.	
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II	
Gradul de murdărire	2	
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adecvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.	
CEM:		
Emisii perturbatoare, Rezistența la perturbații	EN / IEC 61326-1 Clasa B	Clasa FCC B
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤68 dB(A)	
Dimensiuni:		
Lățime	554 mm	
Adâncime	706 mm	715 mm
Altitudine	456 mm	
Greutate	cca. 101 kg	cca. 111 kg

Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen			
Model	ROTANTA 460 R			
Tip	5660 5660-50	5660-20 5660-70	5660-07	5660-77
Tensiune de rețea ($\pm 10\%$)	200-240 V 1~		200-240 V 1~	
Frecvența rețelei	50 Hz		60 Hz	
Sarcina racordată	1800 VA		1900 VA	
Consum de curent	8,5 A		9,2 A	
Agent frigorific	R452A			
Capacitate max.	4 x 1000 ml			
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm ³			
Turația max. (RPM)	15000			
Accelerația max. (RCF)	24400			
Energia cinetică max.	51000 Nm			
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Ger- mania)	da			
Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):				
Loc de amplasare	numai în spațiul interior			
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării			
Temperatura ambiantă	5 °C până la 35 °C			
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.			
Categoria de supraten- siune (IEC 60364-4-443)	II			
Gradul de murdărire	2			
Clasa de protecție a apa- ratului	I nu este adecvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.			
CEM:				
Emisii perturbatoare, Rezistența la perturbații	EN / IEC 61326-1 Clasa B			

Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤66 dB(A)			
Dimensiuni:				
Lățime	770 mm			
Adâncime	706 mm	723 mm	706 mm	723 mm
Altitudine	456 mm	481 mm	456 mm	481 mm
Greutate	cca. 141 kg			
Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen			
Model	ROTANTA 460 R		ROTANTA 460 RC	
Tip	5660-01 5660-51		5670 5670-50	
Tensiune de rețea (±10%)	100-127 V 1~	100 V 1~	200-240 V 1~	
Frecvența rețelei	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Sarcina racordată	max. 2000 VA		1800 VA	
Consum de curent	-		8,5 A	
Agent frigorific	R452A			
Capacitate max.	4 x 1000 ml			
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm ³			
Turația max. (RPM)	15000			
Accelerația max. (RCF)	24400			
Energia cinetică max.	51000 Nm			
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Ger- mania)	da			
Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):				
Loc de amplasare	numai în spațiul interior			
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării			
Temperatura ambiantă	5 °C până la 35 °C			
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.			

Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II		
Gradul de murdărire	2		
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adecvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.		
CEM:			
Emisii perturbatoare, Rezistența la perturbații	Clasa FCC B	EN / IEC 61326-1 Clasa B	
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤66 dB(A)	≤68 dB(A)	
Dimensiuni:			
Lățime	7700 mm	554 mm	
Adâncime	715 mm	697 mm	
Altitudine	456 mm	683 mm	
Greutate	cca. 151 kg	cca. 140 kg	
Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		
Model	ROTANTA 460 RF		
Tip	5675 5675-50	5675-01 5675-51	
Tensiune de rețea (±10%)	200-240 V 1~	100-127 V 1~	100 V 1~
Frecvența rețelei	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Sarcina racordată	1800 VA	max. 2000 VA	
Consum de curent	8,5 A		
Agent frigorific	R452A		
Capacitate max.	4 x 1000 ml		
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm ³		
Turația max. (RPM)	15000		
Accelerația max. (RCF)	24400		
Energia cinetică max.	51000 Nm		

Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da	
Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):		
Loc de amplasare	numai în spațiul interior	
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării	
Temperatura ambiantă	5 °C până la 35 °C	
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.	
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II	
Gradul de murdărire	2	
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adecvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.	
CEM:		
Emisii perturbatoare, Rezistența la perturbații	EN / IEC 61326-1 Clasa B	Clasa FCC B
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤68 dB(A)	
Dimensiuni:		
Lățime	554 mm	
Adâncime	697 mm	
Altitudine	961 mm	
Greutate	cca. 164 kg	cca. 174 kg

Plăcuța tip

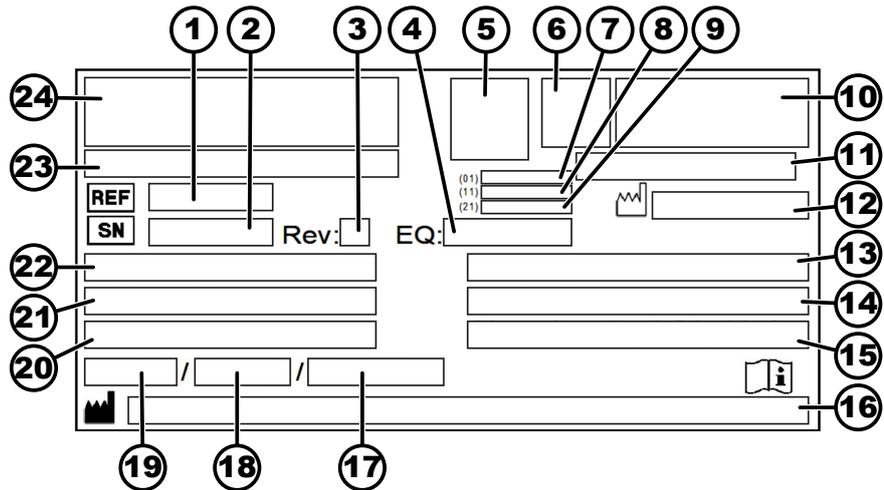


Fig. 1: Plăcuța tip

- 1 Număr articol
- 2 Numărul de serie
- 3 Ediție
- 4 Numărul echipamentului
- 5 Datamatrix Code
- 6 Eventual marcajul dacă este dispozitiv medical sau un dispozitiv de diagnosticare in vitro
- 7 Global Trade Item Number (Număr de înregistrare comerț internațional / GTIN)
- 8 Data fabricației
- 9 Numărul de serie
- 10 eventual marcajul EAC, marcajul CE
- 11 Țara de fabricație
- 12 Data fabricației
- 13 Frecvența rețelei
- 14 Energia cinetică maximă
- 15 Densitatea maximă admisă
- 16 Adresa producătorului
- 17 Eventual Presiunea circuitului de agent de răcire
- 18 Eventual Volumul de umplere cu agent de răcire
- 19 Eventual Tip de agent de răcire
- 20 rotații pe minut
- 21 Valorile puterii
- 22 Tensiunea de rețea
- 23 Eventual Denumirea aparatului
- 24 Logo-ul producătorului

3.2 Înregistrare europeană

Conformitatea aparatului



Conformitatea aparatului conform directivelor UE.

Organismul notificat:

mdc medical device certification GmbH – Notified Body CE 0483

Tel: +49 (0)711 253597 0

Fax: +49 (0)711 258597 10

E-mail: mdc@mdc-ce.de

Site web: www.mdc-ce.de

Adresa: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Germania


Single Registration Number
(Număr unic de înregistrare)

SRN: DE-MF-000010680

Basic-UDI-DI


Basic-UDI-DI	Clasificarea aparatului
040506740100039N	ROTANTA 460 / 460R / 460RC / 460RF (Dispozitiv medical)

3.3 Semne importante pe ambalaj



SUS

Aceasta este poziția verticală corectă a pachetului ambalat pentru expediție și/sau pentru depozitare.




CONȚINUT FRAGIL

Conținutul pachetului ambalat pentru expediție este casabil, de aceea trebuie manipulat cu grijă.



A SE PROTEJA DE UMIDITATE

Pachetul ambalat pentru expediție trebuie protejat de intemperii și păstrat într-un mediu uscat.



LIMITA TEMPERATURII

Pachetul ambalat pentru transport trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de temperatură indicat (-20 °C până la +60 °C).



LIMITA UMIDITĂȚII AERULUI

Pachetul ambalat pentru expediție trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de umiditate a aerului indicat (10 % până la 80 %).



LIMITA NUMĂRULUI DE COLETE STIVUITE

Cel mai mare număr de pachete identice care pot fi așezate stivuite peste pachetul de bază, unde „n” indică numărul admis de pachete. Pachetul de bază nu este inclus în „n”.

3.4 Semne importante la aparat



Nu este permisă îndepărtarea, lipirea peste sau acoperirea semnelor de pe aparat.



Atenție, loc de pericol general.

Înainte de utilizarea aparatului, citiți neapărat indicațiile privind punerea în funcțiune și respectați indicațiile relevante pentru siguranță!



Avertizare contra pericolului biologic.



Avertizare privind suprafață fierbinte.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza pagube materiale și vătămarea persoanelor.



Sensul de rotație a rotorului.

Orientarea săgeții indică sensul de rotație al rotorului.



Simbol pentru colectarea separată a deșeurilor de aparate electrice și electronice, conform Directivei 2012/19/EU (WEEE).

Se aplică în țările Uniunii Europene, în Norvegia și Elveția.



Centrifuga este echipată cu o interfață RS232.

Interfața RS232 este marcată cu un simbol.

Prin interfață, centrifuga poate fi comandată și pot fi interogate date. Tasta *[PROG]* se aprinde în timpul comunicării datelor.



Echipotential: Conector cu fișă (fișă PA) pentru egalizarea potențialului (numai la centrifuga cu fișă PA).



Disjunctor de circuit



3.5 Elemente de operare și afișare

3.5.1 Unitatea de comandă

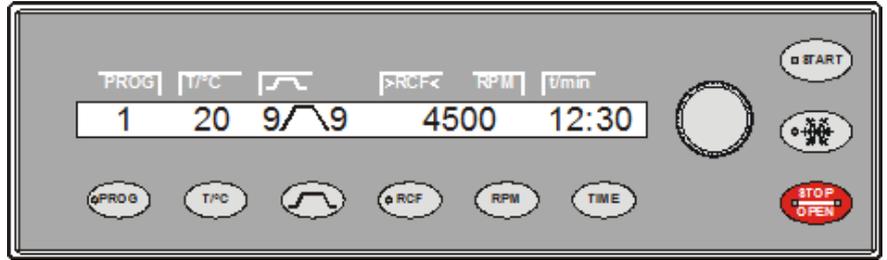


Fig. 2: Unitate de comandă (aparat cu răcire)

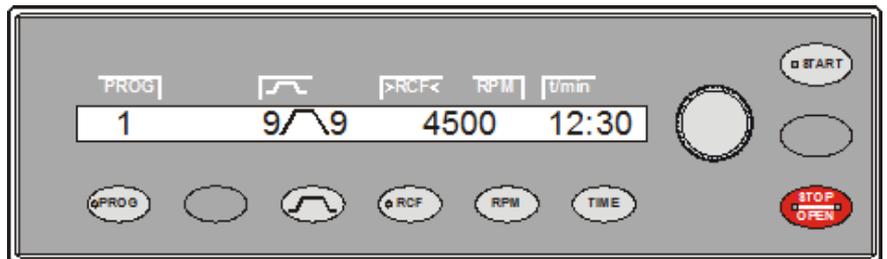


Fig. 3: Unitate de comandă (aparat fără răcire)

3.5.2 Elemente de afișare



Fig. 4: Tasta [Răcire]

- Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.
- Tasta este aprinsă în timpul rulării centrifugării în vederea răcirii preliminare a rotorului, cât timp rotorul nu este încă în repaus.



Fig. 5: Tasta [PROG]

- Tasta este aprinsă când are loc o comunicare a datelor.



Fig. 6: Tasta [RCF]

- Tasta este aprinsă când este afișat RCF.



Fig. 7: Tasta [START]

- Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.
- Tasta este aprinsă în timpul rulării centrifugării, cât timp rotorul nu este încă în repaus.



Fig. 8: Tasta [STOP/OPEN]

- Partea dreaptă a tastei este aprinsă când centrifuga este în oprire inerțială. Rotorul încă nu este încă oprit.
- Partea stângă a tastei este aprinsă când rotorul este în repaus.
- Partea stângă a tastei se stinge când capacul este deblocat.

3.5.3 Elemente de operare



Fig. 9: [Buton rotativ]

- Setarea parametrilor individuali.
Rotirea în sens antiorar micșorează valoarea.
Rotirea în sens orar mărește valoarea.



Fig. 10: [Înterupător de rețea]



Fig. 11: Tasta [Parametrul de demarare și de oprire inerțială]



Fig. 12: Tasta [Răcire]



Fig. 13: Tasta [PROG]



Fig. 14: Tasta [RCF]

- Conectarea și deconectarea aparatului.
- Parametrul trepte de demarare
Treapta 9 = timpul de demarare cel mai scurt, Treapta 1 = timpul de demarare cel mai lung.
- Timp de demarare, parametru
Setabil în pași de 1 secundă.
- Trepte de frânare, parametru
1-9 = Curbă de frânare liniară
1b-9b = asemănătoare unei curbe de frânare exponențiale
Treapta 9, 9b = cel mai scurt timp de oprire inerțială, ...Treapta 1, 1b = timp lung de oprire inerțială, Treapta 0 = oprire inerțială nefrânată.
- Timp de oprire inerțială, parametru
Setabil în pași de 1 secundă.
- Turație deconectare frână, parametru N Brake
Setabil de la 50 RPM până la turația maximă a rotorului (N_{max}), în pași de 10. După atingerea acestei turații, urmează oprirea inerțială nefrânată.
- Rulare centrifugare, pentru răcirea preliminară a rotorului, pornire (numai la aparatele cu răcire).
- Rulare centrifugare, pentru răcirea preliminară a rotorului, se realizează automat cu programul PREC (PRECOOLING).
- Accesarea de programe și înlănțuiri de programe, parametru RCL (Recall).
Programe: Locuri de program 1 până la 99. Înlănțuiri de programe: Locuri de program A până la Z.
- Memorare programe și înlănțuiri de programe, parametru STO (Store).
Pot fi memorate 99 de programe (locurile de program 1 până la 99).
Locul de program 0 servește ca memorie intermediară pentru datele de centrifugare ale ultimei rulări de centrifugare. În acest loc de program nu pot fi memorate programe.
Pot fi memorate 25 de înlănțuiri de programe (locuri de program A până la Z, locul de program J nu există). O înlănțuire de programe poate fi constituită din 20 de programe.
- Înlănțuire programe, parametru EDIT.
- Accesați „Machine Menu”.
- Răsfoiți înainte în meniuri.
- Accelație centrifugală relativă, parametru RCF.
RCF este afișat în paranteze > <.
Se poate seta o valoare numerică din care să rezulte o turație între 50 RPM și turația maximă a rotorului (N_{max}).
Setabil în pași de 1.
- Raza de centrifugare, parametru RAD.
Setabil de la 10 mm până la 330 mm, în pași de 1 milimetru.
- Interogarea integralei RCF.



Fig. 15: Tasta [RPM]



Fig. 16: Tasta [START]



Fig. 17: Tasta [T/°C]



Fig. 18: Tasta [TIME]



Fig. 19: Tasta [STOP/OPEN]

- Interogarea integralei RCF este posibilă numai când este activată afișarea integralei RCF.
- Comutare la valoarea RCF.
 - Turație, parametrul RPM.
Setabil de la 50 RPM până la turația maximă a rotorului (N_{max}), în pași de 10.
 - Comutare la valoarea RPM.
 - Pornirea rulărilor de centrifugare.
 - Memorarea introducerilor și modificărilor.
 - În „Machine Menu” accesați submeniurile.
 - Temperatura (la centrifuge cu răcire)
Setabilă în grade Celsius (°C) sau în grade Fahrenheit (°F).
Parametrul T/°C=Grade Celsius (°C). Setabil de la -20°C până la +40°C, în pași de 1°C.
Parametrul T/°F=Grade Fahrenheit (°F). Setabil de la -4°F până la +104°F, în pași de 1°F.
Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.
 - Temperatura (la centrifuge cu încălzire)
Activarea sau dezactivarea încălzirii, parametrul Heater.
 - Răsfoiți înapoi în meniuri (la centrifuge fără răcire tasta este goală).
 - Timpul de rulare, parametrul t/hms.
h: Ore. de la 1 h până la 99 h, în pași de 1 oră.
m: Minute. de la 1 min până la 59 min, în pași de 1 minut.
s: Secunde. de la 1 s până la 59 s, în pași de 1 secundă.
 - Rulare de durată „∞”
 - Setarea începutului contorizării timpului de rulare.
 - Încheierea rulării centrifugării.
Rotorul rulează cu parametrii de oprire inerțială preselecțai.
 - Prin apăsarea de două ori a tastei, se declanșează funcția de oprire rapidă.
 - Deblocare capac.
 - Ieșirea din introducerea parametrilor și din meniuri.

3.6 Piese de schimb originale

Folosiți numai piese de schimb originale de la producător și accesorii omologate.

3.7 Pachetul de livrare

Cu centrifuga sunt livrate următoarele accesorii:

- 1 Vaseline pentru urechile de susținere
- 1 Cheie inbus (SW5 x 170)
- 1 Șurubelniță inbus în L (SW2,5)
- 1 Cheie Torx în L scurtă (T20 SG)

- 1 Cablu de rețea
- 1 Manual de utilizare
- 1 Foaie cu instrucțiuni pentru siguranța de transport

Suplimentar la aparatul cu azot:

- 1 Foaie cu instrucțiuni pentru racordul de azot
- 1 Presă de cartușe
- 1 Silicon

Suplimentar la tipul 5675:

- 1 Cheie fixă simplă SW 10
- 1 Cheie fixă dublă SW 17/19

Suplimentar pentru livrarea în Germania:

- 1 Caiet de verificări

Rotoarele și accesoriile corespunzătoare sunt livrate conform comenzii.

3.8 Returnare

Pentru returnare, trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare original (RMA) de la producător. Fără formularul de returnare original al producătorului nu este posibilă o recepție sigură a mărfii și înregistrarea contabilă a mărfii la producător. Formularul de returnare (RMA) conține o Declarație de confirmare a absenței riscurilor (UBE), completată integral, care trebuie anexată la expediția de retur.

Dacă aparatul și/sau accesoriile sunt returnate la producător, expediția de retur completă trebuie să fie curățată și decontaminată de către expeditorul returului. Pentru expedițiile retur care nu sunt curățate sau sunt curățate insuficient și/sau sunt decontaminate insuficient, aceasta va fi executată de către producător și va fi facturată expeditorului.

Pentru expedierea retur trebuie fixate siguranțele de transport originale, a se vedea ➔ *Capitolul 4 „Transport și depozitare” de la pagina 22*. Aparatul trebuie expedit în ambalajul original.

4 Transport și depozitare

4.1 Condiții de transport și depozitare

Condiții de transport



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza neutilizării siguranțelor de transport.

- Fixați siguranțele de transport înaintea transportării aparatului.

**INDICAȚIE****Deteriorarea aparatului din cauza condensului.**

La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componentele electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distruge sistemul electronic.

- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.
sau
- într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.

- Înainte de transport, fixați siguranța de transport și scoateți aparatul din priză.
- Temperatura de transport trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.
- Țineți cont de greutatea aparatului.
- La transportarea cu ajutorul unui dispozitiv de transport (de ex. un cărucior de transport), dispozitivul de transport trebuie să aibă o capacitate portantă minimă de 1,6 ori greutatea de transport a aparatului.
- Asigurați aparatul în timpul transportului contra răsturnării și căderii.
- Nu transportați niciodată aparatul pe lateral sau pe cap.

Condiții de depozitare

- Aparatul trebuie depozitat în ambalajul original.
- Depozitați aparatul numai într-un spațiu uscat.
- Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.

4.2 Fixarea siguranței de transport**Personal:**

- Utilizator instruit

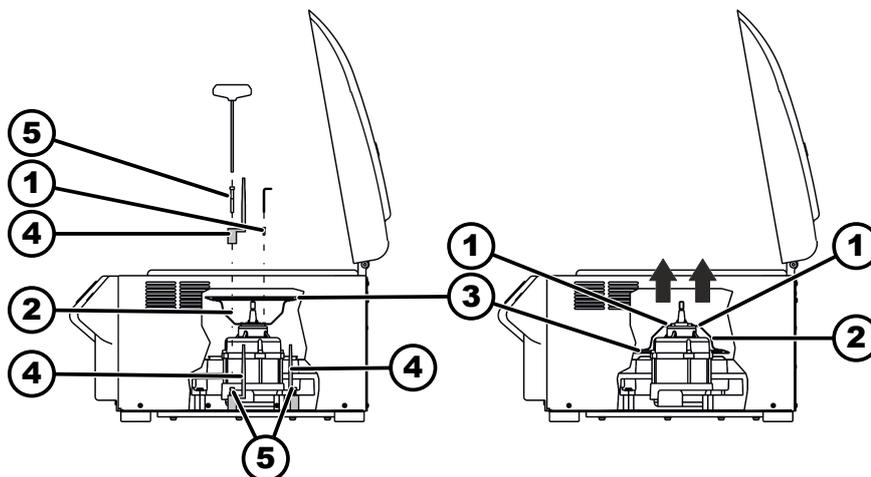


Fig. 20: Siguranță de transport ROTANTA 460

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf (numai la centrifuga cu răcire)
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburile siguranței de transport

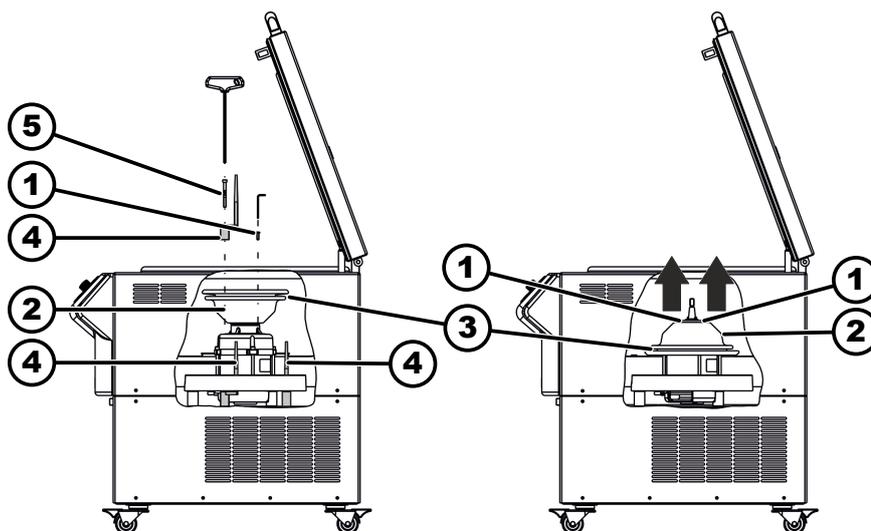


Fig. 21: Siguranță de transport ROTANTA 460 RC

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburi pentru siguranța de transport

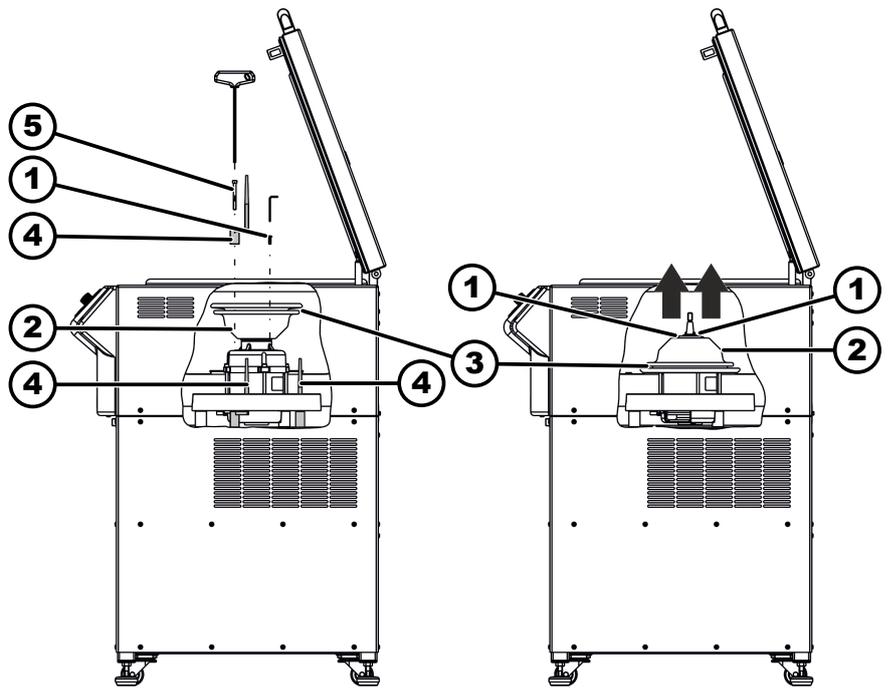


Fig. 22: Siguranță de transport ROTANTA 460 RF

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburi pentru siguranța de transport

1. ▶ Deschideți capacul.
2. ▶ Deșurubați capacul motorului (2).
3. ▶ La ROTANTA 460 R / RC / RF:
Scoateți burduful (3).
4. ▶ Înșurubați 3 siguranțe de transport (4) cu cele 3 șuruburi ale siguranței de transport (5).
5. ▶ Întoarceți capacul motorului (2) și montați-l.
6. ▶ Înșurubați 4 șuruburi (1).
7. ▶ La ROTANTA 460 R / RC / RF:
Trageți burduful (3) peste marginea capacului motorului (2).

5 Punerea în funcțiune

5.1 Despachetarea centrifugei



ATENȚIE

Pericol de strivire prin piesele care cad din ambalajul de transport.

- Mențineți aparatul în echilibru în timpul despachetării.
- Deschideți ambalajul numai în locurile prevăzute în acest scop.



ATENȚIE

Pericol de vătămare prin ridicarea sarcinilor grele.

- Puneți la dispoziție un număr adecvat de persoane care să ajute.
- Țineți cont de greutate. A se vedea ➔ *Capitolul 3.1 „Date tehnice” de la pagina 10.*



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza ridicării necorespunzătoare.

- Nu ridicați centrifuga de unitatea de operare sau suportul unității de operare.

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➔ Dacă există: Scoateți benzile de ambalare.
2. ➔ Ridicați în sus cutia de carton și scoateți capitonarea.
3. ➔ Scoateți accesoriile și păstrați-le în siguranță.
4. ➔ Așezați aparatul pe o bază stabilă și orizontală.

Despachetarea 5670

Personal:

- Utilizator instruit

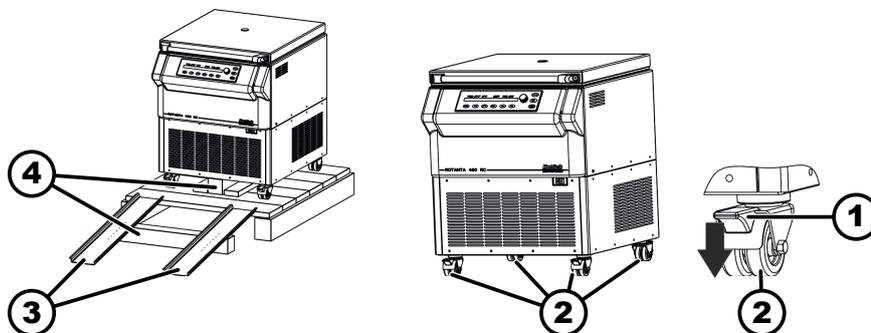


Fig. 23: Despachetarea 5670

- 1 Frână
- 2 Role de ghidare
- 3 Șină metalică
- 4 Grindă de lemn

1. ➔ Scoateți ambalajul.
2. ➔ Scoateți grinda de lemn (4).
3. ➔ Fixați șinele metalice (3) cu câte două cuie la paletul de lemn.
4. ➔ Împingeți grinda de lemn (4) sub șinele metalice (3) pentru a le sprijini.
5. ➔ Împingeți în sus frâna (1) la rolele de ghidare (2) și desprindeți-o în acest fel.
6. ➔ Coborâți cu atenție centrifuga de pe paletul de lemn pe șinele metalice (3).
7. ➔ Împingeți centrifuga în locul de amplasare.
8. ➔ Împingeți în jos frâna (1) la rolele de ghidare (2) și fixați-o în acest fel.

Despachetarea 5675

Personal:

- Utilizator instruit

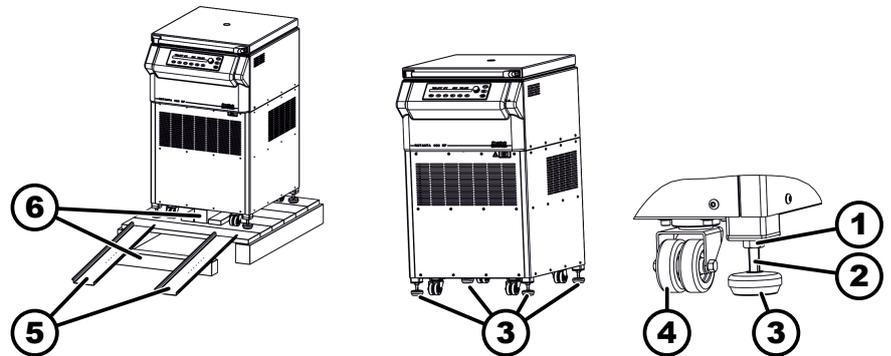


Fig. 24: Despachetarea 5675

- 1 Piuliță hexagonală
- 2 Suprafață
- 3 Picioarele aparatului
- 4 Rolă de ghidare
- 5 Șină metalică
- 6 Grindă de lemn

1. Scoateți ambalajul.
2. Scoateți grinda de lemn (6).
3. Fixați șinele metalice (5) cu câte două cuie la paletul de lemn.
4. Împingeți grinda de lemn (6) sub șinele metalice (5) pentru a le sprijini.
5. Puneți o cheie fixă (mărime 10 mm) la suprafețele (2) și rotiți picioarele aparatului (3) în sus cât de mult posibil.
6. Coborâți cu atenție centrifuga de pe paletul de lemn pe șinele metalice (5).
7. Împingeți centrifuga în locul de amplasare.
8. Puneți cheia fixă (mărime 10 mm) la suprafețele (2) și rotiți picioarele aparatului (3) în jos, până când rolele de ghidare (4) nu mai au contact cu podeaua.
9. Poziționați centrifuga la orizontală prin rotirea picioarelor aparatului (3).
10. Rotiți piulițele hexagonale (1) cu cheia fixă inclusă (mărime 19 mm) în sus și înșurubați-le, pentru a asigura poziția picioarelor aparatului (3).

5.2 Scoaterea siguranței de transport

Personal:

- Utilizator instruit

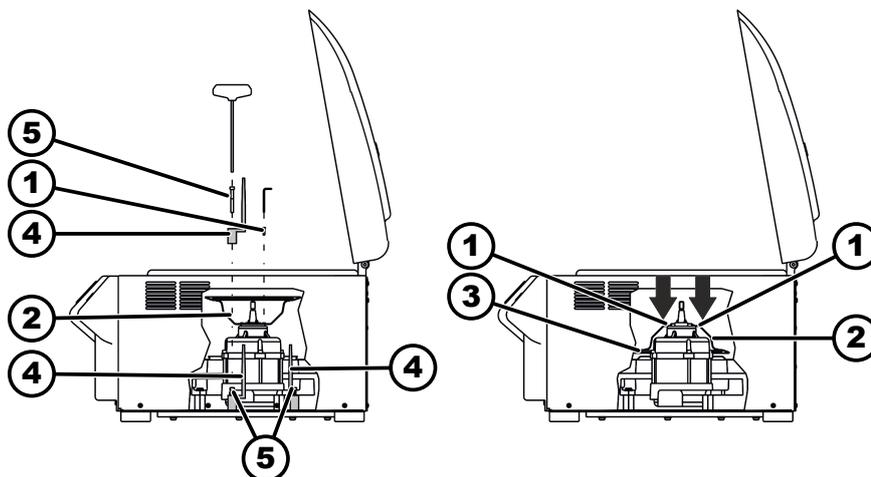


Fig. 25: Siguranță de transport ROTANTA 460

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf (numai la centrifuga cu răcire)
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburile siguranței de transport

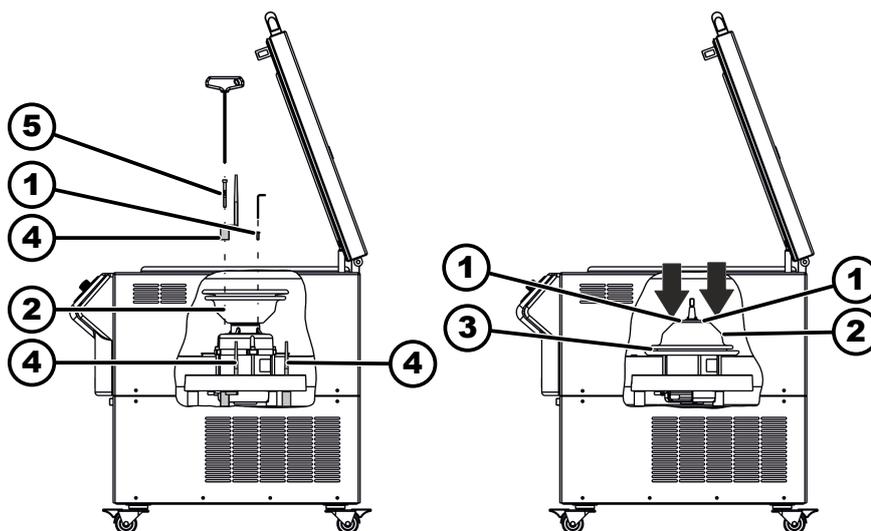


Fig. 26: Transportul ROTANTA 460 RC

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburi pentru siguranța de transport

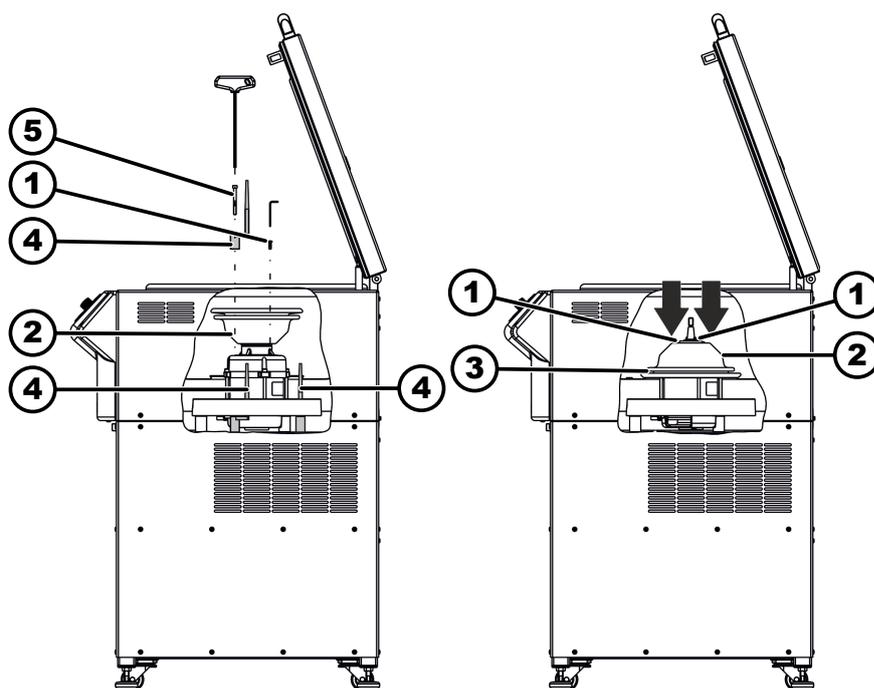


Fig. 27: Transportul ROTANTA 460 RF

- 1 Șuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf
- 4 Siguranță de transport
- 5 Șuruburi pentru siguranța de transport

1. ▶ Deschideți capacul.
2. ▶ Deșurubați 4 șuruburi (1).
3. ▶ Scoateți capacul motorului (2).
4. ▶ Deșurubați 3 siguranțe de transport (4) cu cele 3 șuruburi ale siguranței de transport (5).
5. ▶ Păstrați într-un loc sigur șuruburile și siguranțele de transport.
6. ▶ Întoarceți capacul motorului (2) și montați-l. Aveți grijă la decupajul pentru cablu.
7. ▶ La ROTANTA 460 R / RC / RF:
Trageți burduful (3) peste marginea camerei de centrifugare.
8. ▶ Înșurubați 4 șuruburi (1).

5.3 Amplasarea și racordarea centrifugei

Amplasarea centrifugei



AVERTIZARE

Pericol de vătămare datorită distanței prea mici față de centrifugă.

- În timpul rulării unei centrifuge, conform EN / IEC 61010-2-020, într-o **zonă de siguranță de 300 mm** în jurul centrifugei nu este permis să existe persoane, materiale periculoase și obiecte.
- Trebuie menținută o distanță de **300 mm** față de fantele de aerisire și deschiderile de aerisire ale centrifugei.



ATENȚIE

Pericol de strivire și deteriorare a aparatului prin cădere din cauza modificării poziției datorită oscilațiilor.

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
- Alegeți suprafața de amplasare în funcție de greutatea aparatului.



INDICAȚIE

Deteriorarea probelor și a aparatului prin depășirea sau scăderea sub nivelurile maxim/minim admise ale temperaturii ambiante.

- Respectați temperatura minimă admisă și temperatura maximă admisă ale mediului ambiant pentru amplasarea aparatului.
- Nu amplasați aparatul lângă o sursă de căldură.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui.
- Nu expuneți aparatul la îngheț.

Personal:

■ Utilizator instruit

1. ➤ Așezați aparatul pe o bază stabilă și orizontală.
2. ➤ Țineți un spațiu liber în jurul aparatului o distanță de 300 mm.
3. ➤ Respectați condițiile de mediu din datele tehnice (↔ *Capitolul 3.1 „Date tehnice” de la pagina 10*).

Racordarea centrifugei



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparate de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza condensului.

La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componentele electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distruge sistemul electronic.

- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.
sau
- într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Dacă aparatul este asigurat suplimentar în instalația clădirii cu un întrerupător de protecție la curenți reziduali FI/RCD, trebuie utilizat un FI/RCD de tipul B.

Prin utilizarea altui tip se poate întâmpla ca întrerupătorul de protecție la curenți reziduali ori să nu deconecteze aparatul atunci când apare o defecțiune la aparat, ori să deconecteze aparatul chiar dacă nu există o defecțiune la aparat.

2. ➤ Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța tip.
3. ➤ Racordați aparatul cu cablul de rețea la o priză standardizată.

Racordarea centrifugei la o sursă de alimentare cu azot

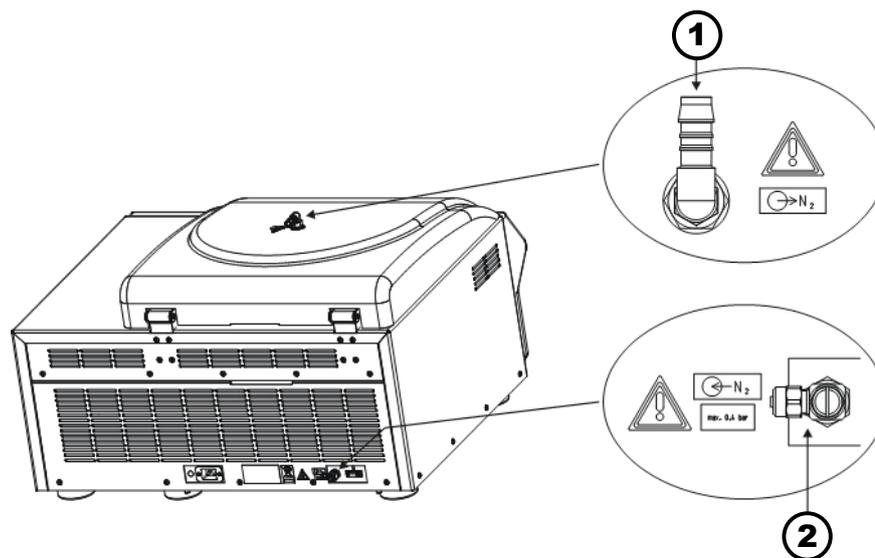
Valabil numai pentru modelele cu alimentare cu azot.

- Pentru a vă asigura că în centrifugă nu se formează niciun amestec inflamabil, trebuie utilizat un aparat de monitorizare a concentrației de oxigen cu limitator cu deconectare suplimentar.
- Utilizatorul trebuie să dispună autorizarea aplicației „Centrifugă și aparat de monitorizare”, conform Anexei II a Directivei 94/9/CE (ATEX-95), de către un institut acreditat (în Europa de ex. TÜV). Aceasta cuprinde și stabilirea substanțelor utilizate, a tipului de protecție la aprindere și întocmirea unei evaluări a riscurilor.
- Exploatarea instalației se face pe riscul utilizatorului.
- Indicații speciale privind etanșeitatea pieselor centrifugei la clătirea cu azot. Utilizatorul trebuie să asigure etanșeitatea și funcționalitatea următoarelor treceri:
 - Etanșarea dintre capac și camera de centrifugare a centrifugei.
 - Etanșarea dintre camera de centrifugare a centrifugei și capacul motorului.
 - Etanșeitatea racordurilor de alimentare și evacuare pentru inertizarea cu azot.

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Centrifuga este pregătită pentru racordarea la o sursă de alimentare cu azot.



- 1 Evacuare azot
- 2 Admisie azot, supapă de restricționare
2. ➤ Admisia de azot (2) se află în partea posterioară a mașinii și se realizează printr-o conexiune rapidă cu șuruburi pneumatică cu furtun pneumatic de 6 mm.
3. ➤ Evacuarea azotului (1) se află la capac și se realizează printr-un racord de furtun de 12 mm. Introduceți furtunul pe ștuțul filetat unghiular.
4. ➤ Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța tip.
5. ➤ Racordați aparatul cu cablul de rețea la o priză standardizată.

Monitorizarea debitului de azot

Utilizatorul este răspunzător cu monitorizarea debitului de azot.

Condiții tehnice

Admisie azot: presiunea înaintea supapei de restricționare 0,4 bar.

5.4 Conectarea și deconectarea centrifugei

Conectarea centrifugei

Personal:

- Utilizator instruit
- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția *///*.
 - ➔ În funcție de tipul centrifugei, tastele luminează intermitent.
 - În funcție de tipul centrifugei, apar succesiv următoarele afișaje:
 - modelul centrifugei
 - versiunea de program și tensiunea de rețea
 - codul rotorului (Rotor), turația maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) ale ultimului rotor recunoscut de identificarea rotorului.
 Raza de centrifugare afișată este o valoare standard, care trebuie adaptată în funcție de accesoriile utilizate.
 - Când capacul este închis: Afișaj „*OPEN DESCHIDEȚI!*”
 - Când capacul este deschis: Datele de centrifugare ale ultimului program utilizat sau ale programului 1.

Afișarea imediată a datelor de centrifugare după conectare

1. ➤ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția *///*.
2. ➤ La prima modificare optică a afișajului (afișare inversă), apăsați o tastă arbitrară și țineți-o apăsată.
 - Sunt afișate datele de centrifugare.

Deconectarea centrifugei

- Rotorul în repaus.
- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția */0/*.

6 Operare

6.1 Deschiderea și închiderea capacului

Deschiderea capacului

Personal:

- Utilizator instruit

Centrifuga este conectată

Rotorul în repaus.

- Apăsați tasta *[STOP/OPEN]*.

- Capacul se deblochează motorizat.
Partea stânga a tastei *[STOP/OPEN]* se stinge.

Închidere capac



⚠ ATENȚIE

Pericol de strivire la închiderea capacului.

Pericol de strivire a degetelor când motorul de închidere strânge capacul pe garnitură.

- La închiderea capacului nu este permis să se afle părți ale corpului în zona de pericol a capacului.
- Pentru închiderea capacului, apăsați capacul de sus.



INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului datorită căderii capacului.

- Închideți capacul lent.
- Nu trântiți capacul.



Dacă partea stânga a tastei [STOP/OPEN] luminează intermitent, apăsați tasta [STOP/OPEN] pentru ca blocarea motorizată a capacului să-l aducă în poziția de bază (deschis).

Personal:

- Utilizator instruit

- Închideți capacul și apăsați ușor în jos marginea din față a capacului.

- Capacul se blochează motorizat.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă.

6.2 Demontarea și montarea rotorului

Demontarea rotorului cu piulița de fixare

Personal:

- Utilizator instruit

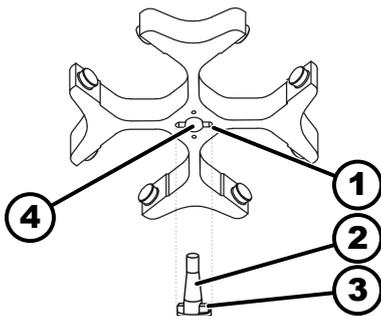


Fig. 28: Montarea și demontarea rotorului

- 1 Canelură
- 2 Arborele motorului
- 3 Element de antrenare
- 4 Alezaj

Montarea rotorului cu piulița de fixare

1. ➤ Deschideți capacul.
2. ➤ Slăbiți piulița de fixare a rotorului cu cheia inclusă.
 - După depășirea punctului de presiune la ridicare, rotorul se desprinde de pe conul arborelui motorului (2).
3. ➤ Rotiți piulița de fixare până când rotorul poate fi ridicat de pe arborele motorului.
4. ➤ Scoateți rotorul.

Personal:

- Utilizator instruit

Capacul este deschis.

1. ➤ Curățați arborele motorului (2) și alezajul rotorului (4).
2. ➤ Ungeți ușor arborele motorului (2), a se vedea ➔ Capitolul 8.2 „Indicații privind curățarea și dezinfectarea” de la pagina 66.
3. ➤ Așezați rotorul vertical pe arborele motorului (2).
Elementul de antrenare (3) al arborelui motorului trebuie să se afle în canelura (1) rotorului. Pe rotor este marcată orientarea canelurii.
4. ➤ Strângeți manual piulița de fixare a rotorului cu cheia inclusă.
5. ➤ Verificați fixarea rotorului.

6.3 Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete

Introducerea recipientelor pentru eprubete



INDICAȚIE

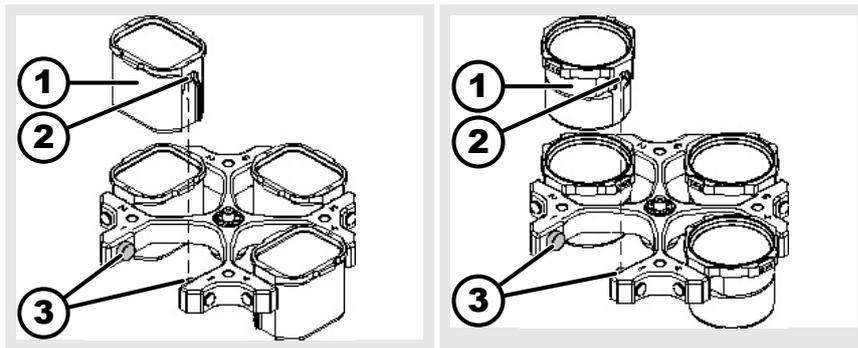
Deteriorarea aparatului din cauza dezechilibrului cauzat de încărcarea greșită a rotorului.

- Încărcați toate locurile rotoarelor de oprire lentă a centrifugării cu recipiente pentru eprubete identice.



Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu numărul locului rotorului pot fi introduse numai acolo.

Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set, pot fi utilizate numai împreună.



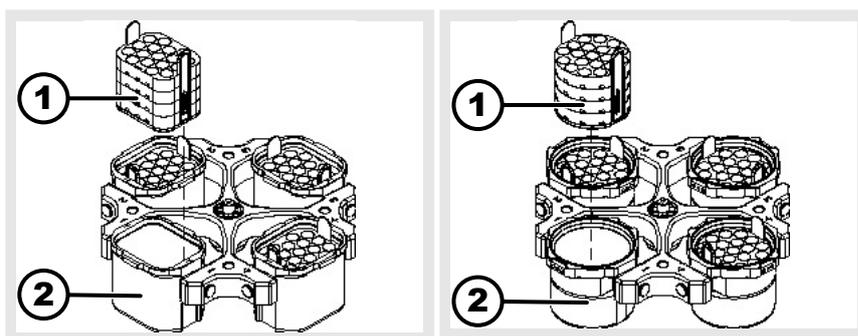
1. ➤ Verificați fixarea rotorului.
2. ➤ Ungeți urechile de susținere (3).
3. ➤ Introduceți recipientele pentru eprubete (1) de sus în rotor. Urechile de susținere (3) trebuie să se găsească în caneluri (2).
4. ➤ Împingeți recipientele pentru eprubete (1) în jos până la opritor.

Scoaterea recipientelor pentru eprubete

- Scoateți recipientele pentru eprubete (1) vertical în sus din rotor.

6.4 Introducerea și scoaterea adaptorului

Adaptor



introducere

- Introduceți adaptorul (1) vertical de sus în recipientele pentru eprubete (2).

scoatere

- Scoateți adaptorul (1) vertical în sus din recipientul pentru eprubete (2).

6.5 Încărcarea

Umplerea recipientelor de centrifugare



AVERTIZARE

Pericol de vătămare prin materialul de probă contaminat.

Din recipientul de probe iese în timpul centrifugării material contaminat.

- Folosiți recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, suplimentar la recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Biosafety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al OMS).

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului datorită substanțelor puternic corozive.

Substanțele puternic corozive pot afecta rezistența mecanică a rotoarelor, recipientelor pentru eprubete și accesoriilor.

- Nu centrifugați substanțe puternic corozive.



Recipientele de centrifugare standard din sticlă suportă până la RZB 4000 (DIN 58970 Partea 2).

Personal:

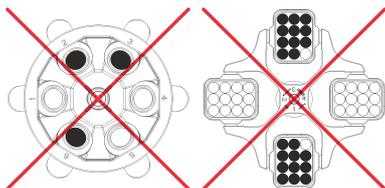
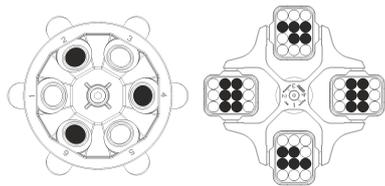
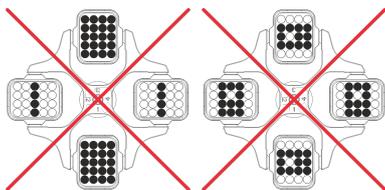
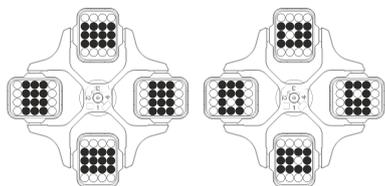
- Utilizator instruit

→ Umpleți recipientele de centrifugare în afara centrifugei.

Nu este permisă depășirea volumului de umplere maxim al recipientelor de centrifugare specificat de producător.

La rotoarele unghiulare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.

Pentru ca diferențele de greutate între recipientele de centrifugare să fie cât mai mici posibil, trebuie avut grijă ca recipientele să fie umplute la același nivel.

Încărcarea rotoarelor de oprire lentă a centrifugării**Personal:**

- Utilizator instruit

1. → Verificați fixarea rotorului.

2. → Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate simetric și uniform în toate locurile rotorului.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

La încărcarea recipientelor pentru eprubete și la oprirea lentă a centrifugării recipientelor pentru eprubete în timpul rulării centrifugării, nu este permis să ajungă lichid în recipientele pentru eprubete și în camera de centrifugare.

La recipientele pentru eprubete cu inserții de cauciuc, sub recipientele de centrifugare trebuie să se afle întotdeauna același număr de inserții de cauciuc.

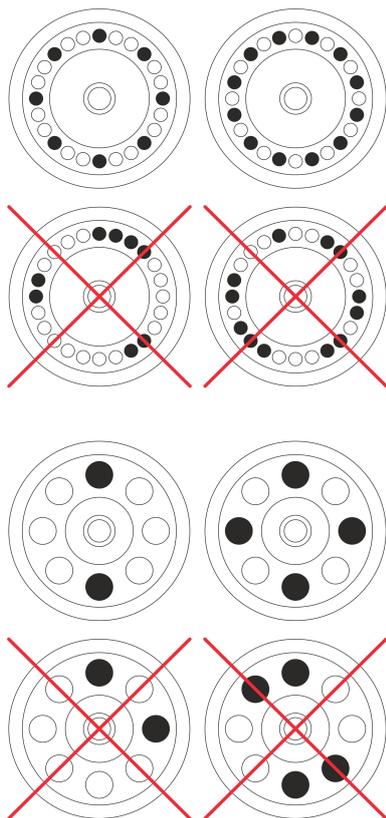
Toate locurile rotorului trebuie să fie ocupate cu recipiente pentru eprubete identice. Anumite recipiente pentru eprubete sunt marcate cu numărul locului la rotor. Recipientele pentru eprubete pot fi introduse numai în locurile corespunzătoare ale rotorului.

Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set (de exemplu S001/4), pot fi utilizate numai în set.

La utilizarea pungilor de sânge trebuie respectate următoarele:

1. ➤ Dacă recipientele pentru eprubete nu sunt umplute cu greutatea repartizată uniform, compensați diferențele cu greutatea de echilibrare.
2. ➤ Dacă nu sunt disponibile suficiente sisteme de pungi de sânge pentru încărcarea completă a rotorului, recipientele pentru eprubete goale pot fi echipate cu inserții de compensare.
3. ➤ Dacă este necesar, se realizează echilibrarea fină cu greutatea de tarare incluse.

Încărcarea rotoarelor unghiulare



Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Verificați fixarea rotorului.
2. ➤ Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate uniform în toate locurile rotorului.

La încărcarea rotorului nu este permis să ajungă lichid în rotor și în camera de centrifugare.

La rotoare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

6.6 Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică

6.6.1 Explicație

La centrifugarea substanțelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate.

Trebuie utilizate întotdeauna recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.

La materialele din grupele de risc 3 și 4, în plus față de recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Bio-safety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al Organizației Mondiale a Sănătății).

La un sistem de securitate biologică, o etanșare bio (inel de etanșare) împiedică ieșirea picăturilor și aerosolilor.

Dacă recipientul pentru eprubete al unui sistem de securitate biologică este utilizat fără capac, inelul de etanșare trebuie scos de la recipientul pentru eprubete, pentru a evita deteriorarea inelului de etanșare în timpul rulării centrifugării.

Sistemele de securitate biologică deteriorate nu mai sunt etanșe microbiologic.

Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, o centrifugă nu este etanșă microbiologic în sensul standardului EN / IEC 61010-2-020.

Depozitarea sistemelor de securitate biologică

Pentru a evita deteriorarea inelelor de etanșare în timpul depozitării, este permisă depozitarea sistemelor de securitate biologică numai cu capacul deschis.

6.6.2 Capac cu închidere filetată și gaură

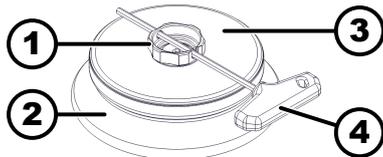


Fig. 29: Sistem de securitate biologică

- 1 Mâner rotativ
- 2 Rotorul
- 3 Capac
- 4 Cheie

Închidere

1. ➤ Așezați capacul (3) central pe rotor (2).
2. ➤ Introduceți cheia inclusă (4) în gaura mânerului rotativ (1).
3. ➤ Rotiți capacul (3) cu cheia (4) în sens orar, până când acesta este închis bine.

Deschidere

1. ➤ Introduceți cheia inclusă (4) în gaura mânerului rotativ (1).
2. ➤ Rotiți capacul (3) cu cheia (4) în sens antiorar, până când acesta este deschis.
3. ➤ Scoateți capacul (3) de pe rotor (2).

6.6.3 Capac cu etrier și închidere prin strângere

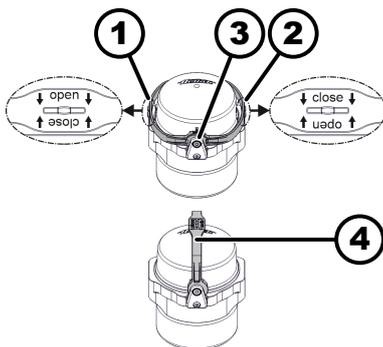


Fig. 30: Sistem de securitate biologică

- 1 Poziția etrierului „open” (deschis)
- 2 Deschiderile etrierului
- 3 Poziția etrierului „close” (închis)
- 4 Poziția de transport a etrierului

Închidere

1. ➤ Rabatați etrierul în poziția „open” (1) (deschis).
Săgețile inscripției trebuie să fie orientate în jos, astfel încât să poată fi citit textul „open” (deschis).
2. ➤ Așezați capacul central pe recipientul pentru eprubete.
Cele două urechi ale capacului trebuie să se afle în cele două deschideri ale etrierului (2).
3. ➤ Rabatați etrierul în poziția „close” (3) (închis).
Săgețile inscripției trebuie să fie orientate în jos, astfel încât să poată fi citit textul „close” (închis).
Etrierul trebuie să stea pe recipientul pentru eprubete, pentru ca recipientele pentru eprubete să se poată opri lent în timpul rulării centrifugării.
4. ➤ Pentru transport sau la introducerea și la scoaterea recipientului pentru eprubete, rabatați etrierul în poziția de transport (4) și țineți recipientul pentru eprubete de etrier.
 - Etanșeitatea sistemului de securitate biologică este garantată și în poziția de transport.
 În timpul transportării sistemului de securitate biologică nu îl balansați, deoarece în caz contrar nu mai este garantată etanșeitatea.

Deschidere

1. ➤ Rabatați etrierul în poziția „open” (1) (deschis).
Săgețile inscripției trebuie să fie orientate în jos, astfel încât să poată fi citit textul „open” (deschis).
2. ➤ Scoateți capacul de pe recipientul pentru eprubete.

6.6.4 Capac cu închidere filetată




Fig. 31: Sistem de securitate biologică

- 1 Capac
- 2 Recipient pentru eprubete

Închidere

1. ➤ Așezați capacul (1) central pe recipientul pentru eprubete (2).
2. ➤ Rotiți capacul (1) în sens orar, până când acesta este închis bine.

Deschidere

1. ➤ Rotiți capacul (1) în sens antiorar, până când acesta este deschis.
2. ➤ Scoateți capacul (1) de pe recipientul pentru eprubete (2).

6.6.5 Capac cu închidere prin strângere

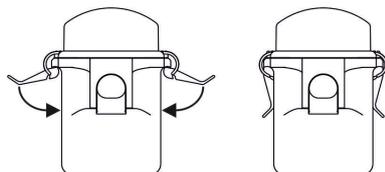


Fig. 32: Sistem de securitate biologică

Închidere

1. ➤ Așezați capacul.
2. ➤ Rabatați în jos cele două etriere de strângere, până ajung sub eclisele recipientului pentru eprubete.

Deschidere

1. ➤ Rabatați în sus cele două etriere de strângere, până ajung deasupra ecliselor recipientului pentru eprubete.
2. ➤ Scoateți capacul de pe rotor.

6.7 Instrucțiuni de împachetare HettLiner

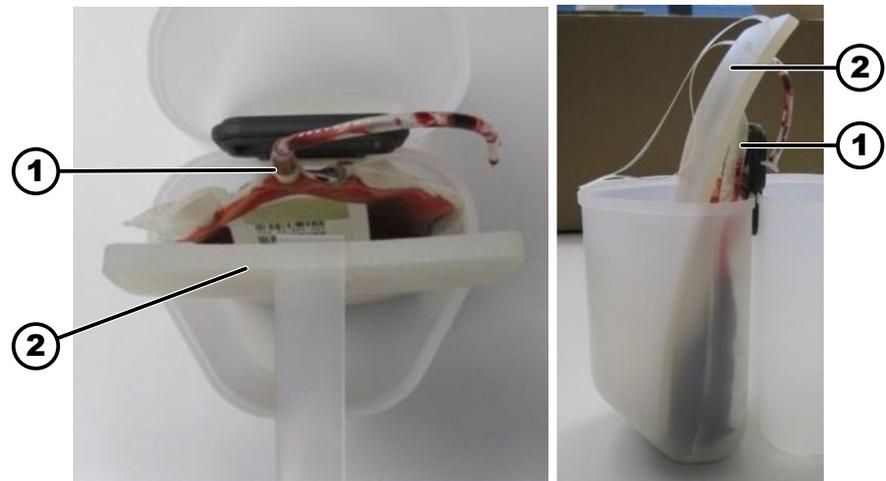
Împachetare înainte de centri-fugare



Aveți grijă ca paharul de plastic să nu se poată bascula la încărcarea și descărcarea paharelor (eventual folosiți scula ajutătoare de încărcare 4509).



1. ➤ Introduceți punga de sânge (1) în pahar (2).



2. ➤ Țineți punga cu sânge de racorduri (1) și împingeți placa de sprijin (2) în pahar, la partea exterioră a pungii cu sânge, de sus în jos.

Aveți grijă ca marginea inferioară a plăcii de sprijin să fie așezată pe cât posibil complet pe bază.



- 3.** ▶ Rabatați placa de sprijin spre exterior și apăsați-o în jos până când marginea răsfrântă a plăcii de sprijin se află la înălțimea nivelului de lichid al pungii cu sânge.

Marginea superioară a plăcii de sprijin nu are voie să iasă prea mult din pahar datorită pericolului de prindere cu brațele rotorului la centrifugare.

Țineți cont de poziția buclei (1) pentru ca aceasta să poată fi accesibilă după centrifugare.

- 4.** ▶ Dacă există, pliați pungă(-ile) satelit goală(-e) și împachetați-o(-le) diferit, în funcție de accesoriile corespunzătoare și volumul de umplere al pungii de sânge. Este avantajos ca pungile satelit să fie pliate și să fie împachetate la exterior între placa de sprijin rabatată și peretele exterior.

În acest timp, aveți grijă ca placa de silicon să nu alunece.

Dacă este cazul, la împachetarea pungii satelit, țineți placa de silicon de buclă și în felul acesta țineți contra.

După aceea trebuie verificată poziția buclei.

- 5.** ▶ Așezați racordurile deasupra plăcii de sprijin astfel încât supapele să nu se poată rupe.

Aveți grijă ca furtunurile să nu iasă din pahar.

Puneți segmentele de furtun care depășesc marginea paharului, între placa de sprijin rabatată și peretele paharului.

- 6.** ▶ Dacă este necesar, trebuie amplasate greutatea de echilibrare între placa de sprijin rabatată și peretele paharului.

Despachetare după centrifugare

- 1.** ▶ Scoateți punga satelit din pahar și în același timp fixați placa de silicon cu o mână.

- 2.** ▶ Scoateți lent piesa rabatată a plăcii de sprijin de bucla prevăzută pentru aceasta.

Readuceți placa de sprijin în mod controlat la forma ei inițială. Piesa rabatată a plăcii de sprijin poate sări înapoi și poate amesteca componentele sângelui.

- 3.** ▶ Scoateți din pahar punga cu sânge rămasă, la alegere împreună cu placa de sprijin sau după scoaterea plăcii de sprijin.

6.8 Centrifugare

6.8.1 Centrifugare în rulare de durată

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Setați minutele, secunde și orele pe „0” sau accesați un program cu rulare de durată.

2. ➤ Apăsăți tasta *[START]*.

- Rularea de centrifugare pornește.

Tasta *[START]* luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta *[START]* este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

Contorizarea timpului începe de la „00:00”.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul consumat.

3. ➤ Apăsăți tasta *[STOP/OPEN]* pentru a încheia rularea centrifugării.

- Se realizează oprirea inerțială cu parametrul de oprire inerțială selectat.

Este afișat parametrul de oprire inerțială

Partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când centrifuga este în oprire inerțială.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei *[START]* și din partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* se sting.

6.8.2 Centrifugare cu preselectare timp

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Setați parametrii de centrifugare sau accesați un program sau o înlanțuire de programe.

2. ➤ Apăsăți tasta *[START]*.

- Rularea de centrifugare pornește.

Tasta *[START]* luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta *[START]* este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul rămas.

3. ➤ După expirarea timpului sau la întreruperea rulării centrifugării se realizează oprirea inerțială cu parametrul de oprire inerțială selectat.

➤ Este afișat parametrul de oprire inerțială.

Partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când centrifuga este în oprire inerțială.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei *[START]* și din partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* se sting.

6.8.3 Centrifugare pe timp scurt

Personal:

■ Utilizator instruit

1. ➤ Apăsați tasta *[START]* și țineți-o apăsată.

➤ Tasta *[START]* luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta *[START]* este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

Contorizarea timpului începe de la 00:00.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul consumat.

2. ➤ Eliberați tasta *[START]* pentru a încheia rularea centrifugării.

➤ Este afișat parametrul de oprire inerțială.

Partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când centrifuga este în oprire inerțială.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei *[START]* și din partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* se sting.

6.8.4 Modificarea setărilor în timpul centrifugării

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul centrifugării când se lucrează cu înlănțuiri de programe sau dacă a fost setată o blocare de program.

Timpul de rulare, turația, accelerația centrifugală relativă (RCF), parametrii de demarare și oprire inerțială precum și temperatura (numai la aparatul cu răcire) pot fi modificate în timpul centrifugării.

➤ Modificați valoarea parametrului dorit.

➤ Valorile programului actual sunt copiate în locul de program „0” și sunt actualizate cu valoarea modificată.

Programul original nu este suprascris.

Numărul locului programului este afișat în paranteze „()”. Datele de centrifugare de pe afișaj nu corespund cu datele de centrifugare ale locului programului memorate.

6.9 Funcția de oprire rapidă

Personal:

■ Utilizator instruit

- Apăsați tasta *[STOP/OPEN]* de două ori.
 - Este afișată și realizată oprirea inerțială cu treapta de frânare „9” (cel mai scurt timp de oprire inerțială).
- Dacă este preselectată treapta de frânare „0”, se realizează oprirea inerțială cu treapta de frânare „9d”. Cu treapta de frânare „9d”, timpul de oprire inerțială este mai lung decât cu treapta de frânare „9”.

7 Operare software

7.1 Parametrii de centrifugare

7.1.1 Parametrii de demarare și oprire inerțială



Sunt afișați parametrii de demarare și oprire inerțială setați.

x: 1-9 = Treapta de demarare, t = Timpul de demarare

y: 1-9, 1b-9b = Treapta de frânare, 0 = Oprire inerțială nefrânată, t = Timpul de oprire inerțială

Treapta de demarare și Timpul de demarare

Funcția „*Timpul de demarare*” este activată.

1. → Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]*.
 - Sunt afișați parametrul Treapta de demarare sau parametrul Timpul de demarare.
2. → Apăsați tasta *[TIME]* pentru a comuta între treapta de demarare și timpul de demarare.
3. → Cu *[Buton rotativ]* setați treapta sau timpul dorite.
4. → Dacă este necesar: Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* pentru a seta următorul parametru.
5. → Apăsați tasta *[START]*.

sau

Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.

Treapta de frânare și timpul de oprire inerțială



Treptele de frânare B pot fi setate numai la rotoarele care sunt adecvate pentru utilizarea pungilor de sânge.

- *Setarea treptelor de frânare B este posibilă numai atunci când acestea sunt activate.*
- *Setarea timpilor de oprire inerțială este posibilă numai atunci când acestea sunt activate.*

Funcția „*Timpul de oprire inerțială*” este activată.

1. → Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișați parametrii „*Treapta de frânare*”, „*Treapta de frânare B*” sau parametrul „*Timpul de oprire inerțială*”.
2. → Apăsați tasta *[TIME]* pentru a comuta între treapta de frânare și timpul de oprire inerțială.
3. → Cu *[Buton rotativ]* setați treapta sau timpul dorite.
4. → Dacă este necesar: Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* pentru a seta parametrul următor.

Turația de deconectare a frânei

5. Apăsați tasta [START].
sau
Apăsați tasta [Parametrii de demarare și de oprire inerțială] de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.
1. Apăsați tasta [Parametrii de demarare și de oprire inerțială] de atâtea ori, până când este afișat parametrul „N Brake”.
2. Setări valoarea dorită cu [Buton rotativ].
3. Tasta [Parametrii de demarare și de oprire inerțială]
sau
Apăsați tasta [START].
► Setările sunt indicate pe afișaj.

7.1.2 Timpul de rulare TIME

Modificarea timpului de rulare



Pentru rularea de durată, minutele, secunde și orele trebuie setate la zero.

Rularea de durată este prezentată pe afișaj cu simbolul „∞”.

1. Apăsați tasta [TIME].
► Este afișat „t/hms”.
Minutele sunt afișate între paranteze ().
2. Setări valoarea dorită cu [Buton rotativ].
3. Apăsați tasta [TIME].
► Secunde sunt afișate între paranteze ().
4. Setări valoarea dorită cu [Buton rotativ].
5. Apăsați tasta [TIME].
► Orele sunt afișate între paranteze ().
6. Setări valoarea dorită cu [Buton rotativ].
7. Apăsați tasta [START].
sau
Apăsați tasta [TIME] de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.
► Setările sunt indicate pe afișaj.

Începutul contorizării timpului de rulare

- Funcția „Dual time mode” este activată. Funcția este activată din fabrică.
1. Apăsați tasta [TIME] de atâtea ori, până când este afișat „Timing begins at Start” sau „Timing begins at Speed”.
 2. Selectați cu [Buton rotativ] setarea dorită.
 - „Timing begins at Start” = Timpul de rulare începe să fie contorizat după pornirea rulării centrifugării.
 - „Timing begins at Speed” = Timpul de rulare începe să fie contorizat după atingerea turației setate.
Acesta este indicat pe afișaj la stânga lângă timp, prin simbolul „√”.

3. ➤ Apăsați tasta [TIME].
sau
Apăsați tasta [START].
➤ Setările sunt indicate pe afișaj.

7.1.3 Turația RPM

1. ➤ Apăsați tasta [RPM].
➤ Este afișat parametrul „RPM”.
2. ➤ Setati valoarea dorită cu [Buton rotativ].
3. ➤ Apăsați tasta [RPM] sau tasta [START].
➤ Setarea este preluată pe afișaj.

7.1.4 Integrala RCF

Integrala RCF este o măsură a efectului de sedimentare ($\int n^2 dt$). Valoarea servește la compararea rulărilor de centrifugare.

Interogarea integralei RCF



Integrala RCF nu este memorată. După pornirea următoarei rulări a centrifugării sau după deconectarea aparatului, integrala RCF este ștearsă.

Dacă este selectată funcția „Timing begins at Speed”, calcularea integralei RCF începe numai după atingerea turației setate.

- Integrala RCF este activată.
1. ➤ Apăsați tasta [RCF] de atâtea ori, până când este afișată integrala RCF.
 2. ➤ Apăsați tasta [RCF].
➤ Sunt afișate datele de centrifugare.
 3. ➤ Dacă este necesar, apăsați tasta [RPM].
➤ Este prezentat afișajul RPM.

Activarea sau dezactivarea integralei RCF

1. ➤ Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
➤ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. ➤ Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. ➤ Apăsați tasta [START].
➤ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. ➤ Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „Integrala RCF = on” sau „Integrala RCF = off”.
5. ➤ Cu [Buton rotativ] setati „off” sau „on”.
off = Integrala RCF dezactivată
on = Integrala RCF activată.
6. ➤ Apăsați tasta [START].
➤ Setarea este memorată.
Se afișează scurt „Store Settings ...”
Pe urmă este afișat „-> Settings”.

7.  Apăsați o dată tasta *[OPEN/STOP]* pentru a ieși din „Setări meniu” sau
Tastați de două ori tasta *[OPEN/STOP]* pentru a ieși din „Machine Menu”.

7.1.5 Temperatura (la centrifuge cu răcire)

1.  Apăsați tasta *[T/°C]*.
 - Este afișat parametrul T/°C resp. T/°F.
2.  Setări valoarea dorită cu butonul rotativ.
3.  Apăsați tasta *[T/°C]* sau tasta *[START]*.
 - Setarea este preluată pe afișaj.

7.1.6 Accelerația centrifugală relativă, RCF

Accelerația centrifugală relativă RCF depinde de turație și de raza de centrifugare.

Accelerația centrifugală relativă RCF se dă ca multiplu al accelerației gravitaționale (g).

Accelerația centrifugală relativă RCF este o valoare numerică fără unitate de măsură și servește la compararea performanțelor de separare și sedimentare.

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Accelerația centrifugală relativă

RPM = Turație

r = Raza de centrifugare în mm = Distanța de la centrul axei de rotație până la baza recipientului de centrifugare.

7.1.7 Accelerația centrifugală relativă RCF și Raza de centrifugare RAD

Accelerația centrifugală relativă RCF depinde de raza de centrifugare RAD. Înaintea setării accelerației centrifugale trebuie setată raza de centrifugare.

1.  Apăsați tasta *[RCF]* de atâtea ori, până când sunt afișate parametrii „RAD”, „RCF” și valoarea parametrului „RAD” este afișată între paranteze *< >*.
 - Tasta *[RCF]* este aprinsă.
2.  Setări raza de centrifugare dorită cu *[Buton rotativ]*.

Prin modificarea razei de centrifugare, valoarea RCF se adaptează automat.
3.  Apăsați tasta *[RCF]*.
 - Valoarea parametrului „RCF” este afișată între paranteze *< >*
4.  Cu *[Buton rotativ]* setări „RCF” dorit.
5.  Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Valoarea RCF setată este memorată.

7.1.8 Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm³

La centrifugarea cu turație maximă, nu este permis ca densitatea substanțelor sau a amestecurilor de substanțe să depășească 1,2 kg/dm³. La substanțele sau amestecurile de substanțe cu o densitate mai mare trebuie redusă turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{Turațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densitate mai mare [kg/dm}^3]}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, Densitatea 1,6 kg/dm³

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Dacă în caz excepțional este depășită încărcarea maximă indicată pe recipientul pentru eprubete, trebuie redusă și turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{turațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{încărcarea maximă [g]}}{\text{încărcarea efectivă [g]}}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, încărcarea maximă 300 g, încărcarea propriu-zisă 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

În caz de neclarități, solicitați informații de la producător.

7.2 Programare

7.2.1 Protecție la scriere pentru programe

Protecția la scriere poate fi activată sau dezactivată când rotorul este în repaus.

1. ➤ Accesați programul dorit.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat parametrul RCL.
3. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - Este afișat parametrul STO.
 - După 8 secunde pe afișaj apare „Set Protection = 1-”.
4. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „+” sau „-”.
 - + = Programul este protejat la scriere
 - = Programul nu este protejat la scriere
5. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.

7.2.2 Accesarea sau încărcarea programului

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat parametrul RCL.
2. ➤ Setati locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.

3. Apăsați tasta [START].

► Se afișează scurt „Program recall...”.

Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit

7.2.3 Introducerea sau modificarea programului



Datele anterioare ale locului programului sunt suprascrise la memorare.

Dacă este afișat „Protected !!”, datele din locul de program sunt protejate la scriere și nu se realizează memorarea.

1. Setări parametri doriti.

2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat parametrul „STO”.

3. Setări locul dorit al programului cu [Buton rotativ].



Dacă după locul programului este afișat un „+”, datele sunt protejate la scriere.

Înainte de memorare trebuie anulată protecția la scriere.

4. Apăsați tasta [START].

► Setările sunt memorate la locul de program dorit.

Se afișează scurt „Program store...”.

7.2.4 Memorie intermediară automată

După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare, datele de centrifugare sunt memorate intermediar la locul programului „0” și pot fi accesate.

În locul de program „0” nu pot fi memorate programe.

7.3 Identificare rotor

- După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare se realizează o identificare a rotorului.
- Dacă a fost schimbat rotorul, rularea centrifugării după identificarea rotorului se întrerupe. Sunt afișate codul de rotor (Rotor), turația maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) a rotorului nou identificat.
- Dacă turația maximă a rotorului utilizat este mai mică decât turația setată, turația este limitată la turația maximă a rotorului.
După care este afișat numărul locului programului în paranteze „()”.
- Dacă este activat contorul de cicluri, după deschiderea capacului este afișat pentru scurt timp numărul de cicluri de rulare executate (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.

7.4 Răcire (la centrifuge cu răcire)

7.4.1 Indicații privitoare la răcire



Pentru a obține o temperatură exactă, înainte de orice rulare a centrifugării trebuie executată o rulare de temperatură preliminară de până la 60 minute.

Valoarea nominală a temperaturii poate fi setată de la -20 °C până la +40 °C respectiv de la -4 °F până la +104 °F.

La centrifugele cu opțiunea încălzire/răcire, valoarea nominală a temperaturii poate fi setată de la -20 °C până la +90 °C respectiv de la -4 °F până la +194 °F.

Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.

7.4.2 Răcire în standby

Când rotorul este în repaus și capacul este închis, camera de centrifugare este răcită la temperatura preselectată, dacă aceasta este mai mică de 20 °C respectiv 68 °F.

În timpul răcirii în standby este afișată temperatura preselectată.

7.4.3 Răcirea preliminară a rotorului

Pentru răcirea preliminară rapidă a rotorului neîncărcat și a accesoriilor, se recomandă o rulare a centrifugării cu setările rulării de durată și la o turație a

- Rotorul de oprire lentă a centrifugării: cca. 20 % din turația maximă a rotorului utilizat.
- Rotorul unghiular: cca. 40 % din turația maximă a rotorului utilizat.

Rularea de centrifugare pentru răcirea preliminară a rotorului, se realizează automat cu programul PREC (PRECOOLING).

O rulare de centrifugare pentru răcirea preliminară a rotorului nu se poate realiza când se lucrează cu înlănțuiri de programe.

Rotorul în repaus.

1. ➤ Apăsăți tasta [Răcire].

- ➔ Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat pentru răcirea preliminară.

Dacă rotorul a fost înregistrat, tasta este aprinsă.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul rămas sau consumat.

2. ➤ Apăsăți tasta [STOP/OPEN].

- ➔ Răcirea preliminară a rotorului se încheie.

Se realizează oprirea inerțială cu treapta de frânare selectată.

Este afișată treapta de frânare.

7.4.4 Răcire temporizată

Dacă este necesar, se poate seta ca după pornirea rulării centrifugării răcirea să se realizeze temporizat. Timpul de temporizare poate fi setat de la 15 până la 900 secunde, în trepte de 1 secundă. Din fabrică nu este setat niciun timp de temporizare.

1. Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „*Cool acc time = 0*”.
5. Setări valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
 - 0 = niciun timp de temporizare
6. Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „*Store Settings...*”.
 - Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau
Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

7.4.5 Împiedicarea pornirii răcirii în timpul evacuării

Se poate seta ca la sfârșitul rulării centrifugării, în timpul opririi inerțiale, după atingerea unei turații setate, răcirea să nu se mai conecteze.

În acest fel se împiedică o eventuală turbionare a sedimentelor în probă.

Această turație poate fi setată de la 0 RPM până la turația maximă a rotorului (Nmax) în pași de 10.

1. Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „*Cool dec speed = ... rpm*”.
5. Setări valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
6. Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „*Store Settings...*”.
 - Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau
Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „****Machine Menu****”.

7.4.6 Monitorizarea temperaturii

Monitorizarea temperaturii servește la protejarea probelor sensibile la temperatură.

După atingerea domeniului de temperatură nominal, temperatura este monitorizată. Domeniul de temperatură nominal este stabilit la temperatura nominală $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Dacă temperatura în camera de centrifugare depășește temperatura nominală cu valoarea „Error 58 Temp” timp de peste 2 minute, se întrerupe rulara centrifugării și este afișat mesajul de eroare „°C/ * -ERROR 58.6”.

Dacă temperatura în camera de centrifugare scade sub temperatura nominală cu valoarea „Error 58 Temp” timp de peste 2 minute, se întrerupe rulara centrifugării și este afișat mesajul de eroare „°C/ * -ERROR 58.7”.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - ➔ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta [START].
 - ➔ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „Error 58 Temp 15 °C”.
5. Setări valoarea dorită cu [Buton rotativ].
 - Reglabilă de la 4 °C până la 25 °C, în pași de 1 °C, precum și setarea „disabled” (dezactivat). Cu setarea „disabled” monitorizarea temperaturii este dezactivată.
6. Apăsați tasta [START].
 - ➔ Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „Store Settings...”.
 - Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu” sau
 - Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „***Machine Menu***”.

7.5 Încălzire (la centrifuge cu încălzire)

În timpul rulării centrifugării, în caz de necesitate camera de centrifugare este încălzită la temperatura preselectată. Când rotorul este în repaus, încălzirea este deconectată.

Rotoarele de decantare și rotoarele în unghi trebuie să ruleze cu turația maximă.



⚠ ATENȚIE

Pericol de ardere de suprafețele fierbinți.

Temperatura suprafeței elementului de încălzire din camera de centrifugare poate ajunge până la 500 °C respectiv 932 °F.

- Nu atingeți elementul de încălzire.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea recipientelor pentru eprubete din material plastic datorită temperaturii prea ridicate.

- Recipientele pentru eprubete din material plastic pot fi utilizate numai la temperaturi de până la maxim 40 °C / respectiv 104 °F.



Pentru a obține o temperatură exactă, înainte de orice rulare a centrifugării trebuie executată o rulare de temperare preliminară de până la 60 minute.

activare / dezactivare

Rotorul în repaus.

1. Apăsați tasta [T/°C] de atâtea ori, până când este afișat „Heater = off” sau „Heater = on”.
2. Cu [Buton rotativ] setați „off” sau „on”.
off = Încălzirea dezactivată
on = Încălzirea activată
3. Apăsați tasta [T/°C] sau tasta [START].
➔ Setările sunt memorate.
Sunt afișate datele de centrifugare.

7.6 Machine Menu

7.6.1 Interogarea informațiilor de sistem

Următoarele informații de sistem pot fi interogate:

- Modelul centrifugei
- Tensiunea de rețea
- Informații rotor
- Versiunea de program a centrifugei
- Versiunea de program a convertizorului de frecvență

Rotorul este în repaus.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
➔ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Info”.
3. Apăsați tasta [START].
➔ Este afișat modelul centrifugei.
4. Apăsați tasta [PROG].
➔ Este afișată tensiunea de rețea.
5. Apăsați tasta [PROG].
➔ Sunt afișate codul rotorului (Rotor), turația maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) ale ultimului rotor recunoscut de către identificarea rotorului.
Ultimul rotor identificat este marcat cu o steluță (*).
Cu [Buton rotativ] pot fi afișate informațiile pentru rotoarele admise la centrifugă.

6. Apăsați tasta [PROG].
 - ➔ Este afișată versiunea de program a centrifugei.
7. Apăsați tasta [PROG].
 - ➔ Este afișată versiunea de program a convertizorului de frecvență.
8. Apăsați tasta [STOP/OPEN] de două ori pentru a ieși din meniul „-> Info”
sau
Tastați tasta [STOP/OPEN] de trei ori pentru a ieși din „***Machine Menu***”.

7.6.1.1 Adresa centrifugei

Adresa centrifugei este setată din fabrică la J=29. Adresa setată.

7.6.2 Contor de cicluri

Centrifuga este dotată cu un contor de cicluri. Contorul de cicluri contorizează ciclurile de rulare (rulările de centrifugare) ale diferitelor coduri de rotor.

La rotoarele de oprire lentă a centrifugării este utilizat contorul de cicluri pentru înregistrarea ciclurilor (rulări de centrifugare) ale recipientelor pentru eprubete.

Atunci când rotorul este recunoscut pentru prima dată de către identificarea rotoarelor, rularea centrifugării se întrerupe. Prin apăsarea unei taste oarecare este afișat „Enter max cycles = (30000)”. Trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare indicat pe recipientul pentru eprubete înainte de a putea fi pornită din nou rularea centrifugării.

La rotoarele și recipientele pentru eprubete care nu sunt marcate cu numărul maxim admis de cicluri de rulare, contorul de cicluri poate fi dezactivat. După fiecare deschidere a capacului este indicat pentru scurt timp numărul de cicluri (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.

Dacă s-a depășit numărul maxim admis de cicluri de rulare introdus al recipientelor pentru eprubete, după fiecare pornire a unei rulări de centrifugare este afișat „*MAX CYCLES PASSED*”.

Rularea centrifugării trebuie pornită din nou. Recipientele pentru eprubete trebuie înlocuite cu altele noi.

Dacă recipientele pentru eprubete au fost înlocuite, contorul ciclurilor trebuie resetat la „0”.

Introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare

După pornirea primei rulări de centrifugare, trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare.

Este afișat „Enter max cycles = (30000)”.

1. Cu [Buton rotativ] setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.
2. Apăsați tasta [START].
 - ➔ Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „Store max cycles ...”.

Resetarea contorului de cicluri și introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare

După introducerea noilor recipiente pentru eprubete, contorul de cicluri trebuie resetat la „0”. Trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Sunt afișate orele de funcționare externe.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când sunt afișate ciclurile de rulare.
5. Apăsați tasta [RCF].
 - Numărul de cicluri de rulare este afișat între paranteze ().
6. Rotiți [Buton rotativ] spre stânga pentru a reseta numărul de cicluri de rulare la „0”.
7. Apăsați tasta [RCF].
 - Numărul de cicluri de rulare maxim admis este afișat între paranteze ().
8. Cu [Buton rotativ] setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.
9. Apăsați tasta [START].
 - Setările sunt memorate.
Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
 - Sunt afișate ciclurile de rulare.
10. Apăsați tasta [OPEN/STOP] de două ori pentru a ieși din meniul „*Operating Time*”
sau
Tastați tasta [OPEN/STOP] de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

Activarea contorului de cicluri

Rotorul este în repaus.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Sunt afișate orele de funcționare externe.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat cu contorul de cicluri dezactivat „*Cycles = disabled*”.
- Dacă sunt afișate ciclurile de rulare, contorul de cicluri este deja activat.
5. Apăsați tasta [RCF] de atâtea ori, până când este afișat numărul maxim admis de cicluri de rulare între paranteze ().
6. Cu [Buton rotativ] setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.
7. Apăsați tasta [START].
 - Setările sunt memorate.
Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
 - Sunt afișate ciclurile de rulare.

8. ➤ Apăsați tasta *[OPEN/STOP]* de două ori pentru a ieși din meniul „*Operating Time*”
sau
Tastați tasta *[OPEN/STOP]* de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

Dezactivarea contorului de cicluri

Rotorul este în repaus.

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Sunt afișate orele de funcționare externe.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când sunt afișate ciclurile de rulare cu contorul de cicluri activat.

Dacă este afișat „*Cycles = disabled*”, contorul de cicluri este deja dezactivat.
5. ➤ Apăsați tasta *[RCF]* de atâtea ori, până când este afișat numărul maxim admis de cicluri de rulare între paranteze ().
6. ➤ Cu *[Buton rotativ]*, setați numărul maxim admis de cicluri de rulare la „0”.
7. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Setările sunt memorate.
 - Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
 - Este afișat „*Cycles = disabled*”.
8. ➤ Apăsați tasta *[OPEN/STOP]* de două ori pentru a ieși din meniul „*Operating Time*”
sau
Tastați tasta *[OPEN/STOP]* de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

7.6.3 Interogarea orelor de funcționare, rulărilor de centrifugare și contorului de cicluri

Orele de funcționare sunt împărțite în ore de funcționare interne și externe.

- Ore de funcționare interne („*OP Time int =*”): Timpul total în care a fost conectat aparatul.
- Ore de funcționare externe („*OP Time ext =*”): Timpul total al rulărilor de centrifugare de până acum.

Rotorul este în repaus.

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „*OP Time ext =*”.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat „*OP Time int =*”.

5. Apăsați tasta [PROG].
 - Este afișat „Number of Starts =”.
Acesta este numărul tuturor rulărilor de centrifugare.
6. Apăsați tasta [PROG].
 - Este afișat „Cycles =”.
Acesta este numărul ciclurilor de rulare (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat de la ultima resetare a contorului de cicluri la „0” și numărul maxim admis de cicluri de rulare.
7. Apăsați tasta [PROG].
 - Este afișat „Rotor cycles total =”.
Acesta este numărul tuturor ciclurilor de rulare (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.
8. Apăsați tasta [STOP/OPEN] de două ori pentru a ieși din meniul „-> Operating Time”
sau
Tastați tasta [STOP/OPEN] de trei ori pentru a ieși din „***Machine Menu***”.

7.6.4 Activarea sau dezactivarea Dual time mode

Dacă este activată funcția „Dual time mode”, se poate seta când începe contorizarea timpului de rulare la o rulare de centrifugare. Funcția este activată din fabrică.

Rotorul în repaus.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „Dual time mode enabled” sau „Dual time mode disabled”.
5. Cu [Buton rotativ] setați „enabled” sau „disabled”.
disabled = Funcția este dezactivată
enabled = Funcția este activată.
6. Apăsați tasta [START].
 - Setările sunt memorate.
Se afișează scurt „Store Settings...”.
Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu”
sau
Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Machine Menu”.

7.6.5 Activarea sau dezactivarea treptelor de frânare B



Treptele de frânare B pot fi setate numai la rotoarele care sunt adecvate pentru utilizarea pungilor de sânge.

- Setarea treptelor de frânare B este posibilă numai atunci când acestea sunt activate.
- Setarea timpilor de oprire inerțială este posibilă numai atunci când acestea sunt activate.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
5. Cu [Buton rotativ] setați „off” sau „on”.
 - off = Treptele de frânare B dezactivate,
 - on = Treptele de frânare B activate.
6. Apăsați tasta [START].
 - Setările sunt memorate.
 - Se afișează scurt „Store Settings...”.
 - Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu” sau
 Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Machine Menu”.

7.6.6 Activarea și dezactivarea timpilor de demarare și oprire inerțială

Rotorul este în repaus.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „Ramp Unit = Steps” sau „Ramp Unit = Steps / Time”.
5. Cu [Buton rotativ] setați „Steps” sau „Steps / Time”.
 - Steps = Timpii de demarare și oprire inerțială dezactivați,
 - Steps / Time = Timpii de demarare și oprire inerțială activați.
6. Apăsați tasta [START].
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „Store Settings...”.
 - Pe urmă este afișat „-> Settings”.

7. Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Setări meniu” sau
Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Machine Menu”.

7.6.7 Blocare program

Când rotorul este în repaus, pot fi setate următoarele blocări de program:

LOCK 1	Este afișat LOCK 1. Programele pot fi doar accesate, însă nu pot fi modificate.
LOCK 2	Este afișat LOCK 2. Programele nu pot fi nici accesate nici modificate. Centrifuga poate fi comandată prin interfață (numai la centrifuga cu interfață).
LOCK 3	nu este afișată nicio stare Nu există nicio blocare de program. Programele pot fi accesate și modificate.

- Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
➤ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
- Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Change Lock”.
- Apăsați tasta *[START]*.
➤ Este afișată starea de blocare Lock.
Dacă nu este introdus niciun PIN, este afișat de ex. „LOCK = {3} confirm by START”.
Dacă este introdus un PIN, este afișat de ex. „LOCK 3”.
- Setați starea dorită cu *[Buton rotativ]*.
Dacă este introdus un PIN, este afișat „PIN = ---- confirm by START”.
În acest caz, cu *[Buton rotativ]* trebuie setat mai întâi PIN-ul valabil și apoi să fie apăsată tasta *[START]*, înainte de a putea fi setată starea de blocare Lock.
- Apăsați tasta *[START]*.
➤ Setarea este memorată.
de ex. este afișat scurt „Store LOCK 2”.
Pe urmă este afișat „-> Change Lock”.
- Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Setări meniu” sau
Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Machine Menu”.

7.6.8 PIN (Număr de identificare personal)

Pentru a împiedica modificarea blocării programului de către persoane neautorizate, se poate seta un PIN. Din fabrică nu este setat niciun PIN.

Setarea sau modificarea PIN

- Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
➤ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.

2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Change PIN”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „old PIN = ---- <START>”.
4. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați PIN-ul valabil.

Dacă PIN-ul este setat pentru prima oară, săriți peste acest pas sau setați „0000”.

Ajutor de introducere: Mențineți apăsată tasta respectivă.

Tasta <i>[Parametrul de demarare și de oprire inerțială]</i>	numai poziția 1.000-lor a pinului de modifică.
Tasta <i>[RCF]</i>	numai poziția 100-lor a pinului de modifică.
Tasta <i>[RPM]</i>	numai poziția 10-lor a pinului de modifică.

5. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „new PIN = ---- <START>”.
 - Dacă s-a setat un PIN greșit, se afișează din nou „old PIN = ---- <START>”. În acest caz setați cu *[Buton rotativ]* PIN-ul valabil și apăsați tasta *[START]*.
6. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați noul PIN.
Pentru dezactivarea PIN-ului trebuie setat „0000”.
7. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „Store PIN ...”.
 - Pe urmă este afișat „-> Change PIN”.
8. ➤ Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Setări meniu” sau
Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Machine Menu”.

Procedura în caz de pierdere a PIN-ului

Dacă s-a pierdut PIN-ul, poate fi accesat un așa-numit număr Help. Cu ajutorul acestui număr, producătorul poate calcula un pin care să înlocuiască PIN-ul valabil până acum.

1. ➤ Țineți apăsată tasta *[PROG]* timp de 8 secunde.
După 8 secunde pe afișaj apare „***Machine Menu***”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* până când este afișat „-> Change PIN”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „old PIN = ---- <START>”.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat „Get HELP # no”.
 - După accesarea numărului Help, PIN-ul de până acum devine nevalabil.
5. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „yes”.
6. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „Are you sure ? no”.

7.  Cu [Buton rotativ] setați „yes”.

8.  Apăsați tasta [START].

➔ Este afișat „HELP # = 5487”.

Notați acest număr Help și solicitați cu el PIN-ul necesar. Cu ajutorul PIN-ului primit setați un PIN nou

7.6.9 Semnal acustic

7.6.9.1 Generalități

Semnalul acustic este emis:

- după apariția unei defecțiuni în interval de 2 s.
- după încheierea rulării centrifugării și repausul rotorului în interval de 30 s.

Prin deschiderea capacului sau apăsarea unei taste oarecare semnalul acustic se încheie.

7.6.9.2 Activarea sau dezactivarea semnalului acustic

Rotorul în repaus.

1.  Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.

➔ După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.

2.  Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.

3.  Apăsați tasta [START].

➔ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”
„SOUND / BELL”: Semnal după încheierea rulării centrifugării

4.  Cu [Buton rotativ] setați „off” sau „on”.

off = Semnal acustic dezactivat

on = Semnal acustic activat

5.  Apăsați tasta [PROG].

➔ Este afișat „SOUND / BELL error = on” sau „SOUND / BELL error = off”.

„SOUND / BELL error”: Semnal după apariția unei defecțiuni

6.  Cu [Buton rotativ] setați „off” sau „on”.

off = Semnal acustic dezactivat

on = Semnal acustic activat

7.  Apăsați tasta [START].

➔ Setarea este memorată.

Se afișează scurt „Store Settings...”.

Pe urmă este afișat „-> Settings”.

8.  Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu” sau

Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „***Machine Menu***”.

7.6.10 Datele de centrifugare afișate după conectarea

După conectare sunt afișate datele de centrifugare ale programului 1 sau ale ultimului program utilizat.

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „*Start program = Last*” sau „*Start program = First*”.
5. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „*Last*” sau „*First*”.
 - Last = ultimul program utilizat
 - First = Programul 1
6. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Setările sunt memorate.
 - Se afișează scurt „*Store Settings...*”.
 - Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. ➤ Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau
 Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

7.6.11 Setarea unității de măsură a temperaturii (la centrifuge cu răcire)

Temperatura poate fi introdusă în grade Celsius (°C) sau în grade Fahrenheit (°F).

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „*Temp Unit = Fahrenheit*” sau „*Temp Unit = Celsius*”.
5. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „*Celsius (°C)*” sau „*Fahrenheit (°F)*”.
 - Celsius = valori în Celsius (°C)
 - Fahrenheit = valori în Fahrenheit (°F)
6. ➤ Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „*Store Settings ...*”.
 - Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. ➤ Apăsați tasta *[OPEN/STOP]* o dată pentru a ieși din meniul „*Settings*” sau
 Tastați de două ori tasta *[OPEN/STOP]* pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

7.6.12 Iluminarea de fundal a afișajului

La centrifugele cu o versiune de program începând cu V01.18:

Pentru economisirea energiei, este posibil ca iluminarea de fundal a afișajului să fie stinsă după 2 minute.

1. Apăsați tasta [PROG] și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „****Machine Menu****”.
2. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. Apăsați tasta [START].
 - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „*Power save = on*” sau „*Power save = off*”.
Power save : Stingerea automată a iluminării de fundal
5. Cu [Buton rotativ] setați „*off*” sau „*on*”.
off = Dezactivarea stingerii automate
on = Stingerea automată activată
6. Apăsați tasta [START].
 - Setarea este memorată.
Se afișează scurt „*Store Settings...*”.
Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau
Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

7.7 Înlănțuiri de programe

7.7.1 Înlănțuirea programelor sau modificarea unei înlănțuiri de programe



Pot fi memorate 25 de înlănțuiri de programe (locuri de program A până la Z, locul de program J nu există).

O înlănțuire de programe poate fi constituită din maxim 20 de programe.

Într-o înlănțuire de programe se realizează adaptarea turației unui program la următorul program întotdeauna cu parametrul de demarare al următorului program.

Într-o înlănțuire de programe nu pot fi modificate parametrii de centrifugare. O modificare a parametrilor este posibilă numai în programele individuale.

Nu este permisă înlănțuirea programelor cu rulare de durată sau a programelor cu timpi de demarare și oprire inerțială.

Cu tasta [TIME], în timpul rulării centrifugării poate fi accesat timpul total de rulare al înlănțuirii de programe și timpul de rulare al programului în curs de rulare.

Înlănțuirile programelor sunt activate.

1. Apăsați tasta [PROG] de atâtea ori, până când este afișat „*EDIT A.. Z*”.
2. Cu [Buton rotativ] setați locul de program dorit în care să fie memorată înlănțuirea de programe.

3. Apăsați tasta *[START]*.
 - Sunt afișate locul de program al înlănțuirii de programe și primul program al înlănțuirii de programe.
4. Cu *[Buton rotativ]* setați primul program al înlănțuirii programelor.
5. Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat următorul program al înlănțuirii programelor.
6. Cu *[Buton rotativ]* setați următorul program al înlănțuirii programelor.
7. Apăsați tasta *[PROG]*.
 - Este afișat următorul program al înlănțuirii programelor.
8. Repetați pașii 6 și 7 de câte ori este necesar, până când sunt setate toate programele.
9. Cu *[Buton rotativ]* setați „END”. Pentru aceasta rotiți butonul rotativ în sens antiorar.

La înlănțuirile de programe alcătuite din 20 de programe, după al 20-lea program nu se mai poate seta niciun „END”.
10. Apăsați tasta *[START]*.
 - Se afișează „STO B”.
11. Apăsați tasta *[START]* pentru memorarea înlănțuirii programelor.
 - Se afișează scurt „Multi program store...”.

7.7.2 Accesarea înlănțuirii de programe

1. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „RCL A... Z”.
2. Setați locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.
3. Apăsați tasta *[START]*.
 - Se afișează scurt „Multi program recall...”.
 - Sunt afișate datele de centrifugare ale primului program din înlănțuirea de programe, precum și timpul total de rulare al înlănțuirii de programe.

7.7.3 Activarea sau dezactivarea înlănțuirilor de programe

1. Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
 - După 8 secunde se afișează „***Machine Menu***”.
2. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta *[START]*.
 - Este afișat „SOUND / BELL = off” sau „SOUND / BELL = on”.
4. Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „ Multi programs = off” sau „ Multi programs = on”.
5. Cu *[Buton rotativ]* setați „off” sau „on”.

off = Înlănțuirea programelor dezactivată
on = Înlănțuirea programelor activată
6. Apăsați tasta *[START]*.
 - Setarea este memorată.
 - Se afișează scurt „Store Settings...”.
 - Pe urmă este afișat „-> Settings”.

7. ➤ Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu” sau
 Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Machine Menu”.

8 Curățarea și îngrijirea

8.1 Tabel de prezentare generală

Cap.	Lucrări de efectuat	dacă este necesar	zilnic	săptămănal	Anual	Pagina
8	Curățarea și îngrijirea					65
8.3	Curățare					66
8.3	Curățarea aparatului		X			66
8.3	Curățarea sistemelor de securitate biologică			X		66
8.3	Curățarea accesoriilor			X		67
8.4	Dezinfectare					67
8.4	Dezinfectarea aparatului	X				67
8.4	Dezinfectarea accesoriilor	X				67
8.5	Întreținere					68
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare			X		68
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică			X		68
8.5	Ungerea urechilor de susținere			X		68
8.5	Verificarea accesoriilor			X		68
8.5	Verificarea sistemului de securitate biologică			X		68
8.5	Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări				X	68
8.5	Ungerea arborelui motorului				X	68
8.5	Accesorii cu durată de utilizare limitată	X				69
8.5	Înlocuirea recipientelor de centrifugare	X				69

8.2 Indicații privind curățarea și dezinfectarea



PERICOL

Pericol de contaminare pentru utilizator datorită curățării insuficiente sau a nerespectării prescripțiilor de curățare.

- Respectați prescripțiile de curățare.
- La curățarea aparatului, purtați echipament individual de protecție.
- Respectați regulile de laborator (de exemplu TRBA-uri, IfSG, Planul de igienă) pentru manipularea agenților biologici.

- Nu este permisă curățarea aparatului și accesoriilor în mașina de spălat vase.
- Efectuați numai o curățare cu mâna și o dezinfectare cu lichide.
- Temperatura apei poate să fie de maxim 25 °C.
- Pentru a preveni apariția coroziunii datorită agenților de curățare și de dezinfectare, trebuie respectate neapărat indicațiile speciale de utilizare ale producătorilor agenților de curățare sau de dezinfectare.

Agenți de dezinfectare:

- Agenți de dezinfectare a suprafețelor (nu agenți de dezinfectare a mâinilor sau instrumentelor)
- Etanol ca unică substanță activă.
Nu dezinfectați vizorul din capacul aparatului cu un amestec de etanol-propanol.
- Concentrația nu are voie să fie mai mică de 30 %
- Valoarea pH: 6 – 8
- Necoroziv

8.3 Curățare

Curățarea aparatului

1. ➤ Deschideți capacul.
2. ➤ Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. ➤ Scoateți accesoriile.
4. ➤ Curățați carcasa centrifugei și camera de centrifugare cu săpun sau un agent de curățare moale și o lavetă umedă.
5. ➤ După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
6. ➤ Suprafețele trebuie uscate imediat după curățare.
7. ➤ Dacă se formează apă de condens, uscați camera de centrifugare cu o lavetă absorbantă.

Curățarea sistemelor de securitate biologică

1. ➤ Curățați sistemul de securitate biologică cu agenți de curățare și o lavetă umedă.
2. ➤ După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. ➤ Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

Curățarea accesoriilor

1. Curățați accesoriile cu agentul de curățare și o lavetă umedă.
2. După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

8.4 Dezinfectare



O dezinfecție trebuie să fie precedată întotdeauna de o curățare a componentelor respective.

A se vedea → Capitolul 8.3 „Curățare” de la pagina 66



Concentrația și timpul de acțiune al agentului de dezinfectare conform datelor producătorului.

Dezinfectarea aparatului



ATENȚIE

Pericol de accidentare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu efectuați dezinfectarea aparatului prin pulverizare.

1. Deschideți capacul.
2. Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. Scoateți accesoriile.
4. Curățați carcasa și camera de centrifugare cu agent de dezinfectare.
5. După utilizarea agenților de dezinfectare, îndepărtați reziduurile de agent de dezinfectare cu o lavetă umedă.
6. Suprafețele trebuie uscate imediat după curățare.

Dezinfectarea accesoriilor

1. Dezinfectați accesoriile cu agentul de dezinfectare.
2. Ungeți toate cavitățile cu agent de dezinfectare fără să lăsați bule de aer.
3. După utilizarea agenților de dezinfectare, lăsați să se usuce reziduurile de agent de dezinfectare sau îndepărtați-le.

Autoclavizarea

Următoarele accesorii pot fi autoclavizate la 121 °C / 250 °F (20 min):

- Rotoare de oprire lentă a centrifugării
- Rotoare unghiulare din aluminiu
- Recipiente pentru eprubete din metal
- Capac cu etanșare bio
- Adaptor

Nu se poate da nicio informație privind gradul de sterilitate.

Capacele rotoarelor și recipientele pentru eprubete trebuie scoase înainte de autoclavizare.

Autoclavizarea accelerează procesul de îmbătrânire a materialelor. Ea poate cauza modificarea culorilor. După autoclavizare, trebuie verificat vizual dacă rotoarele și accesoriile prezintă deteriorări și piesele eventual deteriorate trebuie înlocuite neîntârziat.

La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbate, trebuie înlocuit capacul complet.

Pentru a garanta etanșeitatea sistemelor de securitate biologică, după autoclavizare trebuie înlocuite inelele de etanșare.

8.5 Întreținere

Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

Ungerea urechilor de susținere

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curățați urechile de susținere.
3. → După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeți urechile de susținere și recipientele pentru eprubete cu canelură cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

Verificarea accesoriilor

1. → Accesoriile trebuie verificate cu privire la uzură și deteriorări cauzate de coroziune.
2. → Verificați fixarea rotorului.

Verificarea sistemului de securitate biologică

1. → Verificați toate componentele sistemului de securitate biologică cu privire la deteriorări.
2. → Verificați poziția corectă de montaj a inelului de etanșare respectiv a inelelor de etanșare ale sistemului de securitate biologică.
3. → Înlocuiți componentele deteriorate ale sistemului de securitate biologică.
4. → La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit neîntârziat. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbate, trebuie înlocuit capacul complet.

Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări

→ Verificați dacă camera de centrifugare prezintă deteriorări.

Ungerea arborelui motorului

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curățați arborele motorului.
3. → După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeți arborele motorului cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

Accesorii cu durată de utilizare limitată

Utilizarea anumitor accesorii este limitată în timp. Din motive de siguranță, nu mai este permisă utilizarea accesoriilor care au depășit fie numărul de cicluri de rulare permis marcat pe ele, fie data de expirare marcată.

- Numărul maxim admis de cicluri de rulare sau data de expirare pot fi citite pe accesorii.
- Centrifuga este dotată cu un contor de cicluri.

Înlocuirea recipientelor de centrifugare

ATENȚIE
Pericol de vătămare prin spargerea sticlei.

Prin spargerea sticlei pot pătrunde în interiorul centrifugei cioburi de sticlă și lichide contaminate.

- Purtați mănuși rezistente la tăiere.
- Purtați ochelari de protecție și protecție pentru gură.

În caz de neetanșeități sau după spargerea recipientelor de centrifugare, trebuie îndepărtate complet părțile sparte ale recipientelor, cioburile de sticlă și materialul centrifugat împrăștiat. Cioburile rămase cauzează spargerea în continuare a sticlei.

Înșuruburile de cauciuc și manșoanele de plastic ale rotoarelor trebuie schimbate după spargerea sticlei.

Dacă este vorba de materiale infecțioase, trebuie efectuată o dezinfecție.

9 Remedierea defecțiunilor

9.1 Descrierea erorii

Dacă erorile nu pot fi remediate după tabelul de defecțiuni, trebuie informat Serviciul asistență clienți. Indicați tipul centrifugei și numărul de serie. Cele două numere sunt indicate pe plăcuța tip a centrifugei.

* Numărul de eroare nu apare pe afișaj.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
Niciun afișaj	Lipsă tensiune. Declanșarea siguranței la supracurent.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați tensiunea de alimentare. ■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>///</i>.
TACHO-ERROR 1, 2, 96	Tahometru defect. Motor, sistem electronic defect.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deschideți capacul. ■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>/0/</i>. ■ Așteptați cel puțin 10 secunde. ■ Rotiți puternic rotorul cu mâna. ■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>///</i>. În timpul conectării, rotorul trebuie să se rotească.
IMBALANCE 3*	Rotorul este încărcat neuniform.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deschideți capacul. ■ Verificați încărcarea rotorului. ■ Repetați rularea centrifugării.
CONTROL-ERROR 4.1-4.5, 6	Eroare blocare capac.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Executați RESETARE REȚEA.
N > MAX 5.0, 5.1	Eroare supra-turație.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Executați RESETARE REȚEA.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
N < MIN 13	Eroare sub-turație.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
ROTORCODE 10.1-10.3	Eroare codificare rotor.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
MAINS INTERRUPT 11*	Înteruperea rețelei de alimentare în timpul rulării centrifugării. Rularea centrifugării nu s-a încheiat.	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți capacul. Apăsăți tasta <i>[START]</i>. Dacă este necesar: Repetați rularea centrifugării.
VERSION-ERROR 12	Nepotrivire a componentelor electronice, Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
CONTROL-ERROR 25.1-25.4	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
CRC ERROR 27, 27.1	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
SER I/O-ERROR 31, 34, 36	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
° C * -ERROR 51, 53-55	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
° C * -ERROR 52.0, 52.1	Supra-temperatură în camera de centrifugare. Eroarea/defecțiunea sistemului electronic	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
° C * -ERROR 58.0, 58.1	Abaterea temperaturii este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
° C * -ERROR 58.6, 58.7	Abaterea temperaturii este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA. Creșteți valoarea „Error 58 Temp”.
FU/CCI-ERROR 60, 61.2-61.20, 61.128-61.132, 62	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic/motorului.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
FU/CCI-ERROR 61.1	Tensiunea de rețea este prea scăzută. Eroarea/defecțiunea sistemului electronic/motorului.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați tensiunea de rețea. Executați RESETARE REȚEA.
SENSOR-ERROR 90	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
SENSOR-ERROR 91-93	Eroarea/defecțiunea senzorului de dezechilibru.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
° C * -ERROR 97, 98	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
NO ROTOR OR ROTORCODE ERROR	Nu este montat niciun rotor. Tahometru defect.	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți capacul. Montați rotorul.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
N > ROTOR MAX	Turația în programul selectat este mai mare decât turația maximă a rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați și corectați turația.
	Rotorul a fost schimbat. Rotorul montat are o turație maximă mai mare decât rotorul utilizat anterior. Rotorul nu a fost recunoscut de identificarea rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> Setați o turație până la turația maximă a rotorului utilizat înainte. Apăsăți [START] pentru a executa o identificare a rotorului.
N > ROTOR MAX in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program a cărui turație este mai mare decât turația maximă a rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați și corectați turația.
	Rotorul a fost schimbat. Rotorul montat are o turație maximă mai mare decât rotorul utilizat anterior. Rotorul nu a fost recunoscut de identificarea rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> Setați o turație până la turația maximă a rotorului utilizat înainte. Apăsăți [START] pentru a executa o identificare a rotorului.
Runtime 00:00 in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program cu rulare de durată.	<ul style="list-style-type: none"> În înlănțuirea programelor, înlocuiți programul cu rulare de durată cu un program cu preselectarea timpului.
Empty Program	În locul de program indicat nu este memorată nicio înlănțuire de programe.	<ul style="list-style-type: none"> Accesați o înlănțuire de programe.
Ramp Unit Time in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program cu timp de demarare și/sau timp de oprire inerțială.	<ul style="list-style-type: none"> În înlănțuirea programelor, înlocuiți programul cu un program cu trepte de demarare și de frânare.
Acc time > Run time	Timpul de demarare setat este mai lung decât timpul de rulare.	<ul style="list-style-type: none"> Setați un timp de demarare care este mai scurt decât timpul de rulare.
Protected !!	Programul este protejat la scriere.	<ul style="list-style-type: none"> Dezactivați protecția la scriere a programului.
FC INIT ERROR	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
FC VERSION ERROR	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
FATAL EEPROM ERROR 1-5	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.
WATCHDOG RESET	Eroarea/defecțiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> Executați RESETARE REȚEA.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
MAX CYCLES PASSED	Numărul maxim admis de cicluri de rulare a fost depășit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Din motive de siguranță, recipientele pentru eprubete trebuie înlocuite cu altele noi. ■ După înlocuirea recipientelor pentru eprubete, resetați contorul de cicluri la „0”.
Enter max cycles = <30000>	Solicitare pentru introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare indicat pe recipientele pentru eprubete.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Introduceți numărul maxim admis de cicluri de rulare.
 Jumătatea stânga a afișajului este aprinsă.	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informați Serviciul asistență clienți.

9.2 Executare RESETARE REȚEA

1. ➤ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția [0].
2. ➤ Așteptați 10 secunde.
3. ➤ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția [I].

9.3 Deblocare de urgență

În cazul unei căderi a curentului, capacul nu poate fi deblocat motorizat. Trebuie realizată o deblocare manuală.



! AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin lucrări de mentenanță și întreținere la aparatul aflat sub tensiune.

- Scoateți aparatul din priză înaintea lucrărilor de mentenanță și întreținere.



AVERTIZARE

Pericol de tăiere și strivire prin rotorul în mișcare.

- Deschideți capacul numai când rotorul este în repaus.

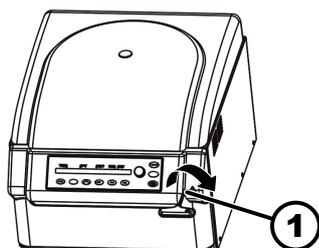


Fig. 33: Deblocare de urgență

1 Alezaj

Personal:

- Utilizator instruit

1. ➤ Priviți prin vizorul din capac și asigurați-vă că rotorul este oprit.
2. ➤ Introduceți cheia hexagonală orizontală în gaură (1) și rotiți-o în sens orar, până se deschide capacul.
3. ➤ Scoateți cheia inbus din gaura (1).
4. ➤ Când există din nou curent, verificați dacă partea stânga a tastei [STOP/OPEN] luminează intermitent.

Dacă partea stânga a tastei [STOP/OPEN] luminează intermitent, apăsați tasta [STOP/OPEN] pentru ca blocarea motorizată a capacului să-l aducă din nou în poziția de bază (deschis).

9.4 Conectarea disjuncteurului de circuit

Personal:

- Utilizator instruit

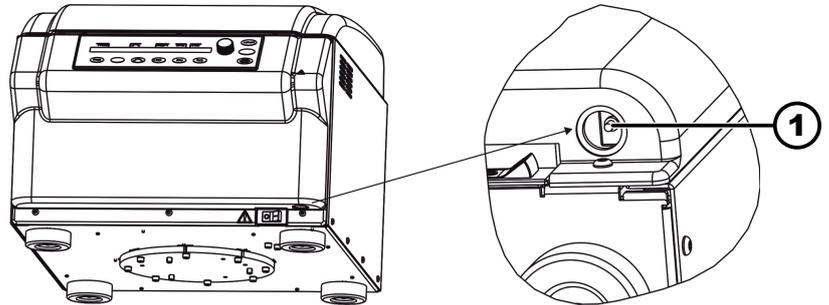


Fig. 34: Disjuncteur de circuit

1 Știft din material plastic

Întreprupătorul de rețea se află în poziția întrerupătorului [O]

Centrifuga este scoasă din priză.

1. ➤ Apăsați știftul din material plastic (1) al disjuncteurului de circuit.
2. ➤ Introduceți din nou aparatul în priză.

10 Eliminare

10.1 Indicații generale



Aparatul poate fi eliminat prin intermediul producătorului.

Pentru retur trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare (RMA).

Dacă este necesar, luați legătura cu serviciul de asistență tehnică al producătorului.

- **Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tuttlingen, Germany
- Telefon: +49 7461 705 1400
- E-Mail: service@hettichlab.com



AVERTIZARE

Pericol de impurificare și contaminare pentru om și mediul înconjurător

La eliminarea centrifugei, oamenii și mediul înconjurător pot fi impurificate și contaminate datorită eliminării greșite sau necorespunzătoare.

- Demontarea și eliminarea sunt permise să fie realizate numai de către personal de service calificat și autorizat.

Aparatul este prevăzut numai pentru utilizare profesională („Business to Business” - B2B).

Conform Directivei 2012/19/UE, nu mai este permis ca aparatele să fie eliminate la gunoierul menajer.

Conform Fundației Registrului de aparate electrice uzate (EAR), aparatele sunt încadrate în următoarele grupe:



- Grupa 1 (schimbătoare de căldură)
- Grupa 4 (aparate mari)

Cu simbolul pubelei tăiate se atenționează asupra faptului că nu este permisă eliminarea aparatului împreună cu gunoiul menajer. Prescripțiile privind eliminarea ale diferitelor țări pot să difere. Dacă este necesar, adresați-vă furnizorului.

Fig. 35: Interdicție de eliminare împreună cu gunoiul menajer

11 Index

A

Accelerația centrifugală relativă	
RCF.	47
Accesorii.	21
cu durată de utilizare limitată.	69
curățare.	67
dezinfectare.	67
verificare.	68
Adresa centrifugei.	54
Amplasarea centrifugei.	30
Aparat	
curățare.	66
dezinfectare.	67
Arborele motorului	
ungere.	68
Autoclavizarea.	67

C

Calificarea personalului.	7
Calificările personalului.	7
Cameră de centrifugare	
verificare.	68
Capac	
deschidere.	33
închidere.	33
Centrifugare	
cu densitate mai mare a substanțelor.	48
cu preselecție timp.	42
în rulare de durată.	42
Centrifugare pe timp scurt.	43
Condiție de transport.	22
Condiții de depozitare.	23
Conectare.	32
Contor de cicluri.	54
activare.	55
dezactivare.	56
interogare.	56
Introducerea valorii maxime.	54
resetare.	54
Curățare.	66
Curățarea și dezinfectarea	
Indicații.	66

D

Date de centrifugare după conectare.	61
Deconectare.	33
Despachetarea.	25
Dezinfectare.	67
Dual time mode	
activare/dezactivare.	57

E

Echipament de protecție.	7
Echipament individual de protecție.	7
Eliminare.	73

G

Garnitură din cauciuc	
ungere.	68

I

Identificare rotor.	49
Informații sistem	
interogare.	53
Instrucțiuni de securitate.	8
Instrucțiuni generale de securitate.	8
Instruirea personalului.	8
Integrala accelerației centrifugale	
activare/dezactivare.	46
Integrala RCF.	46
interogare.	46

Î

Încărcarea.	35
Îngrijire	
Intervale.	65
Înlănțuirea programelor	
accesare.	64
activare.	64
creare.	63
dezactivare.	64
modificare.	63
Întreținere.	68
Intervale.	65

M

Memorie intermediară	
automată.	49
Mesaje de eroare.	69

O

Ore de funcționare	
interogare.	56

P



Pachetul de livrare.	21
Parametrul de demarare și de oprire inerțială.	44
Piese de schimb.	21
Piese de schimb originale.	21
Plăcuța tip.	16
Program	
accesare.	48
introducere.	49
încărcare.	48
modificare.	49
Protecție la scriere.	48



R

Racordarea centrifugei.	30
Alimentare cu azot.	31
Raza de centrifugare	
RAD.	47
Recipiente de centrifugare	
înlocuire.	69
Remediarea defecțiunilor.	69
RESETARE REȚEA.	72

Responsabilitatea utilizatorului.	8
Returnare.	22
Rotor	
demonțare.	33
încărcare.	36, 37
montare.	33
Rulare de durată.	42
Rulări de centrifugare	
interogare.	56
S	
Semnal acustic	
activare/dezactivare.	61
Semne	
la aparat.	18
pe ambalaj.	17
Setare în timpul rulării centrifugării.	43
Siguranță de transport	
fixare.	23
îndepărtare.	27
Simboluri.	6
Sistem de securitate biologică	
curățare.	66
verificare.	68
T	
Timpul de demarare.	44
activare/dezactivare.	58
Timpul de oprire inerțială.	44
activare/dezactivare.	58
Timpul de rulare	
Începerea contorizării.	45
modificare.	45
Treapta de demarare.	44
Treapta de frânare.	44
Trepte de frânare B	
activare/dezactivare.	58
Trouble shooting.	69
Turația de deconectare a frânei.	45
Turația RPM.	46
U	
Umplerea.	35
Urechi de susținere	
ungere.	68
Utilizare greșită previzibilă.	7
Utilizarea neprevăzută.	7
Utilizarea prevăzută.	6



Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories


5699-R	5625-A + 5627									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000									
	max. Beladung / max. load: 750 g									
	4730				4732					
										
										
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	3	4	4	5	6	7	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	11 x 38	11 x 38	10 x 60	10 x 88	12 x 60	12 x 75	12 x 82	12 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor			224	224	120	120	80	80	80	80
Drehzahl / speed	RPM		4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾		3572/4637	3572/4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637
Radius / radius	mm		151/196	151/196	196	196	196	196	196	196
 9 (97%)	sec	79								
 9	sec	88								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16								

5699-R	5625-A + 5627									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000									
	max. Beladung / max. load: 750 g									
	4733		4734		4735		4737	4738		
										
										
Kapazität / capacity	ml	10	15	15	25	75	75	100	250	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	17 x 70	17 x 100	17 x 100	24 x 100	35 x 105	34 x 100	44 x 100	65 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor			68	68	68	24	12	12	8	4
Drehzahl / speed	RPM		4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾		4637	4637	4637	4495	4495	4637	4495	
Radius / radius	mm		196	196	196	190	190	196	190	
 9 (97%)	sec	79								
 9	sec	88								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

5699-R		5625-A + 5627											
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 750 g											
		4739		4740		4739 11)		4734		4740 11)		4736	
													
													
Kapazität / capacity	ml	15	50	12	25	30	50	85	100				
Maße / dimensions	∅ x L	mm	17 x 120	30 x 115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	30 x 115	38 x 102	40 x 115			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48	20	48	24	24	20	12	12				
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600				
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4495	4495				
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	196	190	190				
 9 (97%)	sec							79					
 9	sec							88					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾							10					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾							16					

5699-R		5625-A + 5627										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 750 g										
		4730		4732				4733				
												
												
Kapazität / capacity	ml	1,1; 1,2; 1,4	2,7 - 3	2,6; 2,9	4,5 - 5	4,9	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10			
Maße / dimensions	∅ x L	mm	8 x 66	11 x 66	13 x 65	11 x 92	13 x 90	15 x 75	15 x 92	16 x 92		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	80	80	80	80	68	68	68			
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600			
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637			
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	196	196	196			
 9 (97%)	sec							79				
 9	sec							88				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾							10				
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾							16				

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.



1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)








2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

11) Take the inserts out of the frame / adapter

12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

5699-R		5625-A + 5627				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)				
		max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000				
		max. Beladung / max. load: 750 g				
		4733	4732	4733		
						
						
Kapazität / capacity	ml	10	1,6 - 5	4 - 7	4 - 7	8,5 - 10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	13 x 75	13 x 100	16 x 75	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		68	80	80	68	68
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196
 9 (97%)	sec	79				
 9	sec	88				
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	10				
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16				

5699-R		5625-A + 5627				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)				
		max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000				
		max. Beladung / max. load: 750 g				
		4733	4734	4740 ¹¹⁾	4736	4736
						
						
Kapazität / capacity	ml	10	30	50	85	94
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 110 ²⁰⁾
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		68	24	20	12	12
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4495	4495
Radius / radius	mm	196	196	196	190	190
 9 (97%)	sec	79				
 9	sec	88				
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	10				
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16				

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

20) Maße mit Deckel

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)



2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)



3) Observe the tube manufacturer's instructions.

11) Take the inserts out of the frame / adapter

12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

20) Dimensions with lid

5699-R		5628 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 800 g						
		4626 						
		QP	DWP	MS	CP	MTP		Microtest- platten / plate Terasaki
								
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x 83	86x128x44,5	86x128x46	86x128x22	86x128x17,5	86x128x15	59x84x11
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	16	20	24	8
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4211	4211	4211	4211	4211	4211	4211
Radius / radius	mm	178	178	178	178	178	178	178
 9 (97%)	sec				79			
 9	sec				88			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾				10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾				16			

5699-R		5628 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 800 g						
		4626 + 1485 						
		96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips					
								
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	82x124x20						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	48 x 8					
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600					
RZB / RCF	³⁾	4211	4211					
Radius / radius	mm	178	178					
 9 (97%)	sec		79					
 9	sec		88					
Temperatur / temperature	°C ¹⁾		10					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾		16					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".




MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate





CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate



5699-R		5628 + 5220-A								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 4) +								
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 800 g								
		5267	5268	5264	5258	5227				
										
										
Kapazität / capacity	ml	1,1; 1,2; 1,4	2,6; 2,9	4,9	4 - 5,5	7,5-8,2	9 - 10	2,7 - 3	4,5 - 5	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	8 x 66	13 x 65	13 x 90	15 x 75	15 x 92	16 x 92	11 x 66	11 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		160	96	96	96	96	88	160	160	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	4069	4164	4164	4116	4116	4093	4116	4116	
Radius / radius	mm	172	176	176	174	174	173	174	174	
	9 (97%)	sec								79
	9	sec								88
Temperatur / temperature	°C ¹⁾									10
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾									16

5699-R		5628 + 5220-A									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 4) +									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 800 g									
		5268	5259	5266	5267	5281		5264			
											
											
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	4 - 7	50	30	3	4	1,5	2,0	4 - 7	9
Maße / dimensions	∅ x L	mm	13 x 75	13 x 100	30 x 115	25 x 110	10 x 60	10 x 88	11 x 38	16 x 75	14 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96	96	16	40	160	128	96	96		
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600		
RZB / RCF	³⁾	4164	4164	4187	4187	4069	4164	4116	4116		
Radius / radius	mm	176	176	177	177	172	176	174	174		
	9 (97%)	sec								79	
	9	sec								88	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾									10	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾									16	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5629 verschließbar



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5629



5699-R	5628 + 5220-A									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 4) +  max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 800 g									
	5242	5243	5249	5262	5263-A + 6319 11)	5263-A	5268			
										
					 15)					
Kapazität / capacity ml	25	50	100	100	250	250	7	5	6	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$ mm	24 x 100	34 x 100	40 x 115	44 x 100	62 x 122	65 x 115	12 x 100	12 x 75	12 x 82	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	40	16	8	8	4	4	96	96		
Drehzahl / speed RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600		
RZB / RCF 3)	4093	4093	4069	4069	4187	4045	4164	4164		
Radius / radius mm	173	173	172	172	177	171	176	176		
 9 (97%) sec					79					
 9 sec					88					
Temperatur / temperature $^\circ\text{C}$ 1)					10					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)					16					

5699-R	5628			5636	5630-B	
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 4)			 max. 1200		
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000			max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000		
	max. Beladung / max. load: 800 g			max. Beladung / max. load: 450 g	max. Beladung / max. load: 500 g	
	6338-B	6339-A	6337-B	5648	5671	
						
			 16)			
Kapazität / capacity ml	50	50	15	---	250 / 260	
Maße / dimensions $\varnothing \times L$ mm	29 x 115	29 x 115	17 x 120	152,5 x 85,5 x 12		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	24	24	56	12	4	
Drehzahl / speed RPM	4600	4600	4600	max. 1200		
RZB / RCF 3)	4258	4187	4258	4921	3785	
Radius / radius mm	180	177	180	208	160	
 9 (97%) sec					79	
 9 sec					88	
Temperatur / temperature $^\circ\text{C}$ 1)					10	
Probenerwärmung/Sample temp. rise K 2)					16	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5629 verschließbar
- 11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 16) maximal 1200 RPM

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5629
- 11) Take the inserts out of the frame / adapter
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 16) maximum 1200 RPM

5699-R		5630-B			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 500 g			
		5672	5673	4626 + 1485	
					
				96-PCR-Platte / plate	PCR-Strips
Kapazität / capacity	ml	40	160		
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm			82x124x20	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	48 x 8
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	3785	3785	3832	
Radius / radius	mm	180	160	162	
	9 (97%)	79			
	9	88			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16			

5699-R		5630-B						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 500 g 4626 						
		QP	DWP	MS	CP	MTP		Microtest- platten / plate Terasaki
								
		86x128x 83	86x128x44,5	86x128x46	86x128x22	86x128x17,5	86x128x15	59x84x11
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	16	20	24	8
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	3832	3832	3832	3832	3832	3832	3832
Radius / radius	mm	162	162	162	162	162	162	162
	9 (97%)	79						
	9	88						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	16						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.



MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate



CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system




QP Filterplatte /
Filter plate


5699-R	5628 + 5220-A + 5280							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 4) + +							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000							
	max. Beladung / max. load: 800 g							
	1662				1670			
 2 x in 5280				 6) 2 x in 5280				
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions \varnothing / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 x 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8	16	16
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF ³⁾	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069
Radius / radius mm	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172
 9 (97%) sec					79			
 9 sec					88			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					16			

5699-R	5628 + 5220-A + 5280							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 4) + +							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000							
	max. Beladung / max. load: 800 g							
	1670							
 6) 2 x in 5280								
1665	1666	1667	1668					
								
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1				
Maße / dimensions \varnothing / A mm ²	12,4 x 120	17,5 x 240	8,7 / 60	6,2 / 30				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	16	16	16				
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693				
Drehzahl / speed RPM	4600	4600	4600	4600				
RZB / RCF ³⁾	2744/4069	2744/4069	2744/4069	2744/4069				
Radius / radius mm	116 / 172	116 / 172	116 / 172	116 / 172				
 9 (97%) sec					79			
 9 sec					88			
Temperatur / temperature °C ¹⁾					10			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K ²⁾					16			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5629 verschließbar
- 6) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5629
- 6) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100


5699-R		4880 + 4883 / 4885							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)							
		max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000							
		max. Beladung / max. load: 1000 g							
		4830				4832			
									
									
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	3	4	4	5	6	7
Maße / dimensions	∅ x L mm	11 x 38	11 x 38	10 x 60	10 x 88	12 x 60	12 x 75	12 x 82	12 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192	192	96	96	76	76	76	76
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	3572/4637	3572/4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637
Radius / radius	mm	151/196	151/196	196	196	196	196	196	196
 9 (97%)	sec	79							
 9	sec	88							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	18							

5699-R		4880 + 4883 / 4885							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) -----							
		max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000							
		max. Beladung / max. load: 1000 g							
		4833				4834		4835	
									
		Nalgene®							
									
Kapazität / capacity	ml	10	10	15	15	25	45	50	
Maße / dimensions	∅ x L mm	17 x 70	16 x 80	17 x 100	17 x 100	24 x 100	31 x 100	34 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	76	76	28	16	16	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4495	4495	
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	190	190	
 9 (97%)	sec	79							
 9	sec	88							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	18							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


5699-R	4880 + 4883 / 4885							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000								
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) -----							
	max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000							
	max. Beladung / max. load: 1000 g							
		4835	4837	4836	4838	4839 11)		
								
								
Kapazität / capacity	ml	75	100	85	100	250	10	14
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	35 x 105	44 x 100	38 x 102	40 x 115	65 x 115	15 x 102	16,5 x 106
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	8	12	12	4	56	56
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4495	4637	4495	4495	4495	4637	4637
Radius / radius	mm	190	196	190	190	190	196	196
 9 (97%)	sec	79						
 9	sec	88						
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	7						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	18						

5699-R	4880 + 4883 / 4885							4880 / 4885	
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) ----							----	
	max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000								
	max. Beladung / max. load: 1000 g								
		4839	4840 11)	4839 11)	4834	4840	5647	5647 11)	
									
									
Kapazität / capacity	ml	15	50	12	25	30	50	50	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	17 x 120	30 x 115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	29 x 115	30 x 115	30 x 115 29 x 107
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		56	20	56	28	28	20	28	28
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4708	4708
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	196	199	199
 9 (97%)	sec	79							
 9	sec	88							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	7							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	18							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 11) Die Einlagen aus den Gestellen / Reduzierungen entfernen
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.







- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 11) Take the inserts out of the frames / adapters
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


5699-R		4880 + 4883 / 4885								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ -----								
		max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000								
		max. Beladung / max. load: 1000 g								
		4830	4832				4833			
										
										
Kapazität / capacity	ml	1,1; 1,2; 1,4	2,7 - 3	2,6; 2,9	4,5 - 5	4,9	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	8 x 66	11 x 66	13 x 65	11 x 92	13 x 90	15 x 75	15 x 92	16 x 92	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96	76	76	76	76	76	76	76	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637	
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	196	196	196	
 9 (97%)	sec								79	
 9	sec								88	
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾								7	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾								18	

5699-R		4880 + 4883 / 4885								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ -----								
		max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000								
		max. Beladung / max. load: 1000 g								
		4832	4833							
										
								Nalgene®		
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	10	4 - 7	4 - 7	8	8,5 - 10	10		
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	13 x 75	15 x 102	13 x 100	16 x 75	16 x 125	16 x 100	16 x 80		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	76	76	76	76	76		
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600		
RZB / RCF	³⁾	4637	4637	4637	4637	4637	4637	4637		
Radius / radius	mm	196	196	196	196	196	196	196		
 9 (97%)	sec								79	
 9	sec								88	
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾								7	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾								18	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



5699-R		4880 + 4883 / 4885													
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) ----- max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000 max. Beladung / max. load: 1000 g													
		4834			4840 11)		4836			4847			4848		
															
															
Kapazität / capacity	ml	30	50	85	94	2,6 – 2,9	4,9	1,6 – 5	4 - 7	10	9 - 10	4 - 7	8,5 - 10		
Maße / dimensions	Ø x L mm	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 110 20)	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	16 x 80	16 x 92	16 x 75	16 x 100		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		28	20	12	12	108		108		88		88			
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600		4600		4600		4600			
RZB / RCF	3)	4637	4637	4495	4495	4116	4684	4116	4684	4684	4684	4684	4684		
Radius / radius	mm	196	196	190	190	174	198	174	198	198	198	198	198		
	9 (97%)	sec 79													
	9	sec 88													
Temperatur / temperature	°C 1)	7													
Probenerwärmung / Sample temp. rise	K 2)	18													

5699-R		4880 + 4883 / 4885											
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) ----- max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000 max. Beladung / max. load: 1000 g											
		4845				4849				4852			
													
		4447		4234-A		Falcon / Corning	BD	Nunc	Greiner	Nunc / Sarstedt			
													
Kapazität / capacity	ml	450	750	30 / 40 / 50				160					
Maße / dimensions	Ø x L mm	97 x 110	96 x 135	---				---					
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4		8				4					
Drehzahl / speed	RPM	4600											
RZB / RCF	19)	4779				4613							
Radius / radius	mm	202				195							
	9 (97%)	sec 79											
	9	sec 88											
Temperatur / temperature	°C 1)	7											
Probenerwärmung / Sample temp. rise	K 2)	18											

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 19) Für die einsetzbaren Kulturflaschen beträgt die max. RCF 2300
- 20) Maße mit Deckel

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 11) Take the inserts out of the frame / adapter
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 19) The max. RCF for the accommodated cell culture flasks is 2300.
- 20) Dimensions with lid


5699-R	4880 + 4885					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles 400 000						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000 max. Beladung / max. load: 1000 g					
	4831			4851		
						
	BD	Falcon	Greiner	Nunc	Nunc	Sarstedt
						
Kapazität / capacity	200			40		
Maße / dimensions Ø x L	---			---		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4			8		
Drehzahl / speed	4600					
RZB / RCF ¹⁹⁾	4613					
Radius / radius	195					
9 (97%)	79					
9	88					
Temperatur / temperature °C ¹⁾	7					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	18					

5699-R	4880 + 4883 / 4885				4890 + 4883 / 4895		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles 400 000							
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾				mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾		
	max. Laufzyklen / max. cycles: 75 000				max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000		
	max. Beladung / max. load: 1000 g						
	4841	4845	4845	4449	4846	4438	
							
5127	0512 ⁴⁾	Corning		0551			
							
Kapazität / capacity	250	750	500	600	25	30	30
Maße / dimensions Ø x L	62 x 122	97 x 152	96 x 147	93 x 134	25 x 90	25 x 110	25 x 110
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	4	4	28	28	28
Drehzahl / speed	4600						
RZB / RCF ³⁾	4779						
Radius / radius	202						
9 (97%)	79						
9	88						
Temperatur / temperature °C ¹⁾	7						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	18						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 4883 verschließbar
- 11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 19) Für die einsetzbaren Kulturflaschen beträgt die max. RZB 2300

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 4883
- 11) Take the inserts out of the frame / adapter
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 19) The max. RCF for the accommodated cell culture flasks is 2300.

5699-R	4890 + 4883 / 4895										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000										
	max. Beladung / max. load: 1000 g										
	4451 4)	4430	4430	4432	4433						
											
0512	Corning	Nunc®	Nalgene®	2078	0536	0553	0578				
											
Kapazität / capacity	ml	750	250	200	175	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	97 x 152	60 x 172	60 x 130	62 x 144	11 x 38	12 x 75	12 x 100	11 x 66	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	4	168	120	120	120	120	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	4873	5063	5063	5063	3407/4542	4471	4471	4471	4471	
Radius / radius	mm	206	214	214	214	144/192	189	189	189	189	
	9 (97%)					sec					79
	9					sec					88
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					7					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					18					

5699-R	4890 + 4883 / 4895										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000	 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000										
	max. Beladung / max. load: 1000 g										
	4433	4434			4435						
											
				Nalgene®							
											
Kapazität / capacity	ml	4,5 - 5	4 - 5,5	9 - 10	10	2,6 - 2,9	4,9	1,6 - 5	4 - 7		
Maße / dimensions	Ø x L	mm	11 x 92	15 x 75	16 x 92	16 x 80	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	76	76	76	84	84	84	84	84	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	³⁾	4471	4637	4637	4637	4471	4471	4471	4471	4471	
Radius / radius	mm	189	196	196	196	189	189	189	189	189	
	9 (97%)					sec					79
	9					sec					88
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					7					
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾					18					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 4883 verschließbar
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.





- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 4883
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

5699-R	4890 + 4883 / 4895								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) -----								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000								
	max. Beladung / max. load: 1000 g								
	4434 								
									
Kapazität / capacity	ml	4 - 7	8,5 - 10	10	15		9	15	8
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	16 x 75	16 x 100	15 x 102	17 x 100		14 x 100	17 x 100	16 x 81
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	76	76		76	76	76
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600		4600	4600	4600
RZB / RCF	3)	4637	4637	4637	4637		4637	4637	4637
Radius / radius	mm	196	196	196	196		196	196	196
 9 (97%)	sec	79							
 9	sec	88							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	7							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K 2)	18							

5699-R	4890 + 4883 / 4895										
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000											
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12) -----										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000										
	max. Beladung / max. load: 1000 g										
											
				Falcon®							
Kapazität / capacity	ml	15	25	50	225	175	600	50	50	50	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	17 x 120	24 x 100	34 x 100	61 x 137	61 x 118	93 x 134	29 x 115	29 x 115	29 x 107	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48	28	16	4		4	20	28	28	
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
RZB / RCF	3)	4755	4353	4424	5063	5063	4873	4755	4613	4613	
Radius / radius	mm	201	184	187	214	214	206	201	195	195	
 9 (97%)	sec	79									
 9	sec	88									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ 1)	7									
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K 2)	18									









- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 11) Die Einlage aus den Gestellen entfernen
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 11) Take the inserts out of the frame / adapter
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

5699-R	4890 + 4883 / 4895					5691-A		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000								
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾					---		
	max. Laufzyklen / max. cycles: 38 000					max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000		
	max. Beladung / max. load: 1000 g					max. Beladung / max. load: 1000 g		
	4442	4443	4449		4469	5693 + 5692	5695 + 5692	
			---					
	5127	Corning	3- / 4- fach/ 3- / 4- times		3-fach / 3-times	4-fach / 4-times		
	 ¹⁵⁾		 ⁵⁾		 ⁵⁾	 ⁵⁾		
Kapazität / capacity	ml	100	250	500	450	15	450	450
Maße / dimensions	Ø x L	mm	44 x 100	62 x 122	96 x 147	---	17 x 120	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		8	4	4	4	56	4	4
Drehzahl / speed	RPM	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
RZB / RCF	³⁾	4400	4873	5063	5063	4755	4637	4637
Radius / radius	mm	186	206	214	214	201	196	196
 9 (97%)	sec	79					79	79
 9	sec	88					88	88
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7					10	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	18					16	16

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) nur lauffähig in Zentrifugen ab Werk-Nr. XXXXXXX-02-01
- 6) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) only executable in centrifuges from serial no. XXXXXXX-02-01
- 6) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.



5654		5651-A + 5652							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g							
		5681					5687 + 4449		5669
									
		5127	4)	Nalgene® + 5676	Falcon® + 5677		Nunc® + 5676	Corning	--- 4)
		       							
Kapazität / capacity	ml	250	290	175	175	225	200	500	1000
Maße / dimensions	∅ x L	62 x 122	62 x 137	62 x 144	61 x 118	61 x 137	60 x 130	96 x 147	99/126 x 140
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		8	8	8	8	8	8	4	4
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF	³⁾	3196	3196	3196	3196	3196	3196	3196	3196
Radius / radius	mm	198	198	198	198	198	198	198	198
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	3							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9							

5654		5651-A + 5652							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g							
		5687				5682			
									
		0551	4447	0512 4)					
		      							
Kapazität / capacity	ml	600	450	750	4- 7	8,5 - 10		15	4 – 5,5
Maße / dimensions	∅ x L	93 x 134	97 x 110	97 x 152	16 x 75	16 x 100		17 x 100	15 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	148	148		148	148
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800		3800	3800
RZB / RCF	³⁾	3196	3196	3196	2970	2970		2970	2970
Radius / radius	mm	198	198	198	184	184		184	184
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	3							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5652 verschließbar
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5652
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.


5654		5651-A + 5652							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 +  mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g							
		5682		5683		5684			
									
									
Kapazität / capacity	ml	7,5 - 8,2	9 - 10	10	10	15	4	5	6
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 80	17 x 120	12 x 60	12 x 75	12 x 82
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		148	148	148	148	96	292	292	292
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF	³⁾	2970	2970	2970	2970	3196	2874	2874	2874
Radius / radius	mm	184	184	184	184	198	178	178	178
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	3							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9							

5654		5651-A + 5652							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 +  mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g							
		5684				5685			
									
									
Kapazität / capacity	ml	7	1,1 - 1,4	3	4	4,5 - 5	2,7 - 3	4,9	2,6 - 3,4
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 100	8 x 66	10 x 60	10 x 88	11 x 92	11 x 66	13 x 90	13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		292	292	292	292	292	292	188	188
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF	³⁾	2874	2874	2874	2874	2874	2874	2906	2906
Radius / radius	mm	178	178	178	178	178	178	180	180
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	3							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitsysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".




5654		5651-A + 5652							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 +  mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g							
		5685				5674			
									
									
Kapazität / capacity	ml	4 - 7	1,6 - 5	5	10	4,9	2,6 - 3,4	4- 7	1,6 - 5
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 100	13 x 75	13 x 75	13 x 100	13 x 90	13 x 65	13 x 100	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		188	188	188	188	196	196	196	196
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF	³⁾	2906	2906	2906	2906	2906	2906	2906	2906
Radius / radius	mm	180	180	180	180	180	180	180	180
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	3							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9							

5654		5651-A + 5652									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 +  mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 60 000 max. Beladung / max. load: 1520 g									
		5674		5686							
											
			4)		4)						
Kapazität / capacity	ml	5	10	50							
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 75	13 x 100	29 x 115							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		196	196	40							
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800							
RZB / RCF		2906	2906	3196							
Radius / radius	mm	180	180	198							
 9 (97%)	sec	62									
 9	sec	58									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	3									
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	9									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5652 verschließbar
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5652
- 12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

5654		5653 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 500 g						
		4626 						
		QP	DWP	MS	CP	MTP		Microtest- platten / plate Terasaki
								
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x 83	86x128x44,5	86x128x46	86x128x22	86x128x17,5	86x128x15	59x84x11
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	16	20	24	8
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF	³⁾	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Radius / radius	mm	179	179	179	179	179	179	179
 9 (97%)	sec	62						
 9	sec	58						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 4						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	12						

5654		5653 + 5629							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 80 000 max. Beladung / max. load: 500 g							
		4626 + 1485 							
		96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips						
									
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	82x124x20							
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	48 x 8						
Drehzahl / speed	RPM	3800	3800						
RZB / RCF	³⁾	2890	2890						
Radius / radius	mm	179	179						
 9 (97%)	sec	62							
 9	sec	58							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 4							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	12							

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

12) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".



MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate









MS Micronic System /
Micronic system







QP Filterplatte /
Filter plate

4446		5051 + 5053										
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000		 max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 500 g										
		5262	5249	5243	5242	5248 5248-91 9)	5247 5247-91 9)	5227	5257			
												
Kapazität / capacity	ml	100	100	50	25	15	7	5	6	1,5	2,0	
Maße / dimensions	Ø x L	44 x 100	40 x 115	34 x 100	24 x 100	17 x 100	12 x 100	12 x 75	12 x 82	11 x 38		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	12	30	72	120	120		240		
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		4000		
RZB / RCF	³⁾	3291	3291	3291	3291	3291	3291	3309		2486/3363		
Radius / radius	mm	184	184	184	184	184	184	185		139/188		
 9 (97%)	sec	38										
 9	sec	46										
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0										
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10										

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) mit Dekantierhilfe
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) with decanting aid
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4446		5051 + 5053													
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  < 90° max. Laufzyklen / max. cycles 120 000		 													
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 500 g													
		5281	6306	6306 4)	5258 4)	5243 4)	5264	5227		5248 5248-91 9)					
															
															
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	12	15	9-10	10	50	9	2,7 - 3	4,5 - 5	15			
Maße / dimensions	∅ x L	11 x 38		17 x 100	17 x 120	16 x 92	15 x 102	29 x 115	14 x 100	11 x 66	11 x 92	17 x 100			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96		42		66		12	72	120	120	72			
Drehzahl / speed	RPM	4000		4000		4000		4000	4000	4000	4000	4000			
RZB / RCF	³⁾	3363		3434		3291		3291	3309	3309	3309	3291			
Radius / radius	mm	188		192		184		184	185	185	185	184			
 9 (97%)	sec											38			
 9	sec											46			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾											0			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾											10			

4446		5051 + 5053													
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  < 90° max. Laufzyklen / max. cycles 120 000		 													
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 500 g													
		5268	5259 4)	5264	5248	5264	5267	5268							
															
															
Kapazität / capacity	ml	2,6 ; 2,9	4,9	50		4 - 5, 5	7,5 x 8,2	8,5 - 10	4 - 7	3	1,1 - 1,4	1,6 - 5	4-7	5	
Maße / dimensions	∅ x L	13 x 65	13 x 90	30 x 115		15 x 75	15 x 92	16 x 100	16 x 75	10 x 60	8 x 66	13 x 75	13 x 100	13 x 75	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72		12		72		72	72	120	72	72			
Drehzahl / speed	RPM	4000		4000		4000		4000	4000	4000	4000	4000			
RZB / RCF	³⁾	3345		3363		3309		3291	3309	3274	3345	3345			
Radius / radius	mm	187		188		185		184	185	183	187	187			
 9 (97%)	sec											38			
 9	sec											46			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾											0			
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾											10			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5053 verschließbar
- 9) mit Dekantierhilfe




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5053
- 9) with decanting aid






4446	5051 + 5280 5053								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 500 g								
	 2 x in 5280						 6) 2 x in 5280		
	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
									
Kapazität / capacity	ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions \varnothing / A	mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	24	24
Filterkarten / filter cards		1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291
Radius / radius	mm	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184
 9 (97%)	sec							38	
 9	sec							46	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾							0	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾							10	

4446	5051 + 5280 5053				5092 + 5093				
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000				aerosoldicht / aerosol-proof 12) max. Laufzyklen / max. cycles: 30000				
	max. Beladung / max. load: 500 g				max. Beladung / max. load: 500 g				
	 6) 2 x in 5280								
1665	1666	1667	1668	Falcon®	Falcon®	----	----	----	----
					 4)				
Kapazität / capacity	ml	4	8	3 x 2	4 x 1	175	225	8	4,5 - 5
Maße / dimensions \varnothing / A	mm ²	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	61 x 118	61 x 137	16 x 125	11 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	24	24	24	6	6	42	72
Filterkarten / filter cards		1692	1691	1694	1693	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	2290/3291	2290/3291	2290/3291	2290/3291	3631	3631	3542	3542
Radius / radius	mm	128 / 184	128 / 184	128 / 184	128 / 184	203	203	198	198
 9 (97%)	sec							38	
 9	sec							46	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾							0	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾							10	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5053/5093 verschließbar
- 6) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5053/5093
- 6) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4446	5092 + 5093								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30 000								
	max. Beladung / max. load: 500 g								
		5126	5125	5123	5129	5124	5122	5120	
									
									
Kapazität / capacity	ml	100	100	50	15	50	25	4 - 7	7
Maße / dimensions	Ø x L	40 x 115	44 x 100	30 x 115	17 x 120	34 x 100	24 x 100	13 x 100	12 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	12	42	6	24	72	72
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	3488	3488	3631	3631	3631	3434	3542	3542
Radius / radius	mm	195	195	203	203	195	192	198	198
 9 (97%)	sec								
 9	sec								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10							

4446	5092 + 5093								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30 000								
	max. Beladung / max. load: 500 g								
		5128	6319 4)	1791	5121	5134	5122	5135	5136
									
		 15)							
Kapazität / capacity	ml	5	250	250	12	25	30	50	8,5 - 10
Maße / dimensions	Ø x L	13 x 75	62 x 122	65 x 115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	29 x 115	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72	6	6	42	18	24	12	48
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	3542	3631	3631	3542	3363	3327	3560	3488
Radius / radius	mm	198	203	203	198	188	192	199	195
 9 (97%)	sec								
 9	sec								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5093 verschließbar
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.





- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5093
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.



4446	5092 + 5093								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30 000								
	max. Beladung / max. load: 500 g								
			5121			6319		5136	
									
				4)		---			
							 4/15)		
Kapazität / capacity	ml	15	2,6 – 2,9	9 - 10	10	15	15	290	15
Maße / dimensions	∅ x L	17 x 100	13 x 65	16 x 92	15 x 102	17 x 120	17 x 100	62 x 137	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		42	42	42	42	42	42	6	48
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3631	3488
Radius / radius	mm	198	198	198	198	198	198	203	195
 9 (97%)	sec	38							
 9	sec	46							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10							

4446	5092 + 5093								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times   max. Laufzyklen / max. cycles 120 000									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)								
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30 000								
	max. Beladung / max. load: 500 g								
			5136						
									
									
Kapazität / capacity	ml	10	15		4 – 4,5	7,5 - 8,2	9 - 10	10	4 - 7
Maße / dimensions	∅ x L	16 x 80	17 x 100		15 x 75	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48	48		48	48	48	48	48
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000		4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	³⁾	3488	3488		3488	3488	3488	3488	3488
Radius / radius	mm	195	195		195	195	195	195	195
 9 (97%)	sec	38							
 9	sec	46							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5093 verschließbar
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5093
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4446		5092 + 5093																															
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 120 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 30 000 max. Beladung / max. load: 500 g																															
		5137						5138																									
																																	
																																	
Kapazität / capacity	ml	1,6 - 5	4 - 7	5		6		1,1 - 1,4	2,6 - 2,9	2,7 - 3	4,5 - 5	4,9		1,1 - 1,4	2,7 - 3	2,6 - 2,9	1,6 - 5																
Maße / dimensions	Ø x L	13 x 75	13 x 100	12 x 75	13 x 75	12 x 82		8 x 66	13 x 65	11 x 66	11 x 92	13 x 90		8 x 66	11 x 66	13 x 65	13 x 75																
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		48		48		48		48		48		48		72		72																	
Drehzahl / speed	RPM	4000		4000		4000		4000		4000		4000		4000		4000																	
RZB / RCF	³⁾	3488		3488		3488		3488		3488		3488		3077		3077																	
Radius / radius	mm	195		195		195		195		195		195		172		172																	
 9 (97%)	sec	38																															
 9	sec	46																															
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	0																															
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	10																															

5622		5631 + 4627											
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾ max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000 max. Beladung / max. load: 500 g											
		4626											
													
		QP	DWP	MS	CP	MTP							
													
Kapazität / capacity	ml	---		---		---		---		---			
Maße / dimensions	mm	86x128x83		86x128x44,5		86x128x46		86x128x22		86x128x17,5		86x128x15	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		2		2		2		8		10		12	
Drehzahl / speed	RPM	5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *	
RZB / RCF	³⁾	5838/ (6446) *		5838/ (6446) *		5838/ (6446) *		5838/ (6446) *		5838/ (6446) *		5838/ (6446) *	
Radius / radius	mm	max. 150		max. 150		max. 150		max. 150		max. 150		max. 150	
 9 (97%)	sec	50 / (52) *		50 / (52) *		50 / (52) *		50 / (52) *		50 / (52) *		50 / (52) *	
 9	sec	32 / (39) *		32 / (39) *		32 / (39) *		32 / (39) *		32 / (39) *		32 / (39) *	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10											
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	12											

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
* (nur bei Kühlzentrifuge)

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.
* (only with cooling centrifuges)

12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".





MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate

CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate

5622		5631 + 4627						
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles 400 000		 mit Bioabdichtung / with bio-containment 12)						
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000						
		max. Beladung / max. load: 500 g						
		4626		4626 + 1485				
								
Microtest-platten / plate Terasaki		96-PCR-Platte / plate		PCR-Strips				
								
Kapazität / capacity	ml	---	---	0,2				
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	59x84x11	82x124x20	---				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	2	24				
Drehzahl / speed	RPM	5900 / (6200) *	5900 / (6200) *	5900 / (6200) *				
RZB / RCF	³⁾	5838/ (6446) *	5838/ (6446) *	5838/ (6446) *				
Radius / radius	mm	max. 150	max. 150	max. 150				
 9 (97%)	sec	50 / (52) *	50 / (52) *	50 / (52) *				
	sec	32 / (39) *	32 / (39) *	32 / (39) *				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	12						

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

* (nur bei Kühlzentrifuge)

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.




1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

* (only with cooling centrifuges)


12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4474		4275							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles 40 000									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 50 000							
		max. Beladung / max. load: 370 g							
		4276-B	4277	0771	0703				
									
0531		0528							
	 8)	 8)	 8)						
Kapazität / capacity	ml	100	100	100	50				
Maße / dimensions	∅ x L	mm	37 x 200	44 x 168	58 x 161	36,5 x 185			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	4				
Drehzahl / speed	RPM	2000	2000	2000	2000				
RZB / RCF	³⁾	961	961	984	912				
Radius / radius	mm	215	215	220	204				
 9 (97%)	sec	14							
 9	sec	17							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 8							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	4							

4489-A		---	2031	2023	2024					
Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times  45° mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾			 13)							
								 + 		
		Kapazität / capacity	ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,4	0,2	0,5
		Maße / dimensions	∅ x L	mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 45	6 x 18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		30	30	30	30	30	30	15		
Drehzahl / speed	RPM	15000								
RZB / RCF	³⁾	max. 24400						23394		
Radius / radius	mm	max. 97						93		
 9 (97%)	sec	65								
 9	sec	63								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4								
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	19								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 13) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 13) recommended for high-speed centrifugation


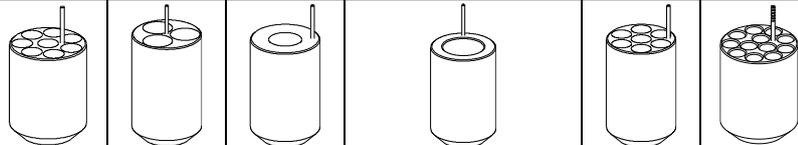
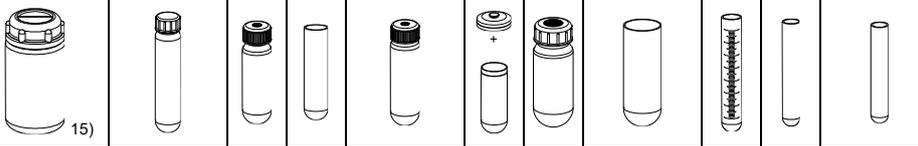
5615													
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\angle 45^\circ$ mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾		---	1454		1446		1447		1466		1451		1448
Verwendungsdauer / service life	Jahre / years	5											
Max. Laufzyklen / max. cycles		15 000											
Kapazität / capacity	ml	94	85	50	50	25	30	15	15	7,5 - 8,2	9 - 10	10	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	38 x 110	38 x 106	29 x 115	29 x 107	24 x 100	26 x 95	17 x 120	17x100	15 x 92	16 x 92	16 x 80	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6		6	6	6		6	6	6		12	
Drehzahl / speed	RPM	11500											
RZB / RCF	³⁾	18038	17595	17299	16560	17299		17003	17003	17003		17003	
Radius / radius	mm	122	119	117	112	117		115	115	115		115	
9 (97%)	sec	58											
9	sec	64											
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	6											
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	22											

5615												
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\angle 45^\circ$ mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾		1451			1463			---	1476		1403	
Verwendungsdauer / service life	Jahre / years	5										
Max. Laufzyklen / max. cycles		15 000										
Kapazität / capacity	ml	8,5 - 10	10	15	50	75	85	5	4			
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	16 x 100	15 x 102	17 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 102	17 x 51	12 x 40			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6								24		
Drehzahl / speed	RPM	11 500										
RZB / RCF	³⁾	17003	17003	17003	17743	17743	18038	16856	17003			
Radius / radius	mm	115	115	115	120	120	122	114	115			
9 (97%)	sec	58										
9	sec	64										
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	6										
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	22										

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

5615		1449				5645		5637	5638
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  ∠ 45° mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾		 ∠ 25° mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾				Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  ∠ 25° mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾			
Verwendungsdauer / service life	Jahre / years	5				Verwendungsdauer / service life	Jahre / years	5	
Max. Laufzyklen / max. cycles		15000				Max. Laufzyklen / max. cycles		15000	
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	0,5	3	Kapazität / capacity	ml	15	50
Maße / dimensions	∅ x L mm	11 x 38		10,7 x 46		10 x 60		17 x 120	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24				Anzahl p. Rotor / number p. rotor		30	6
Drehzahl / speed	RPM	11500				Drehzahl / speed	RPM	8500 (9500)*	
RZB / RCF	³⁾	17299				RZB / RCF	³⁾	10824 (13521)*	9532 (11906)*
Radius / radius	mm	117				Radius / radius	mm	134	118
 9 (97%)	sec	58				 9 (97%)	sec	98 / (115)*	
 9	sec	64				 9	sec	105 (120)*	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	6				Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7	
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	22				Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	21	

5645		---									
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  ∠ 25° mit Bioabdichtung / with bio-containment ¹²⁾											
											
Verwendungsdauer / service life	Jahre / years	5									
Max. Laufzyklen / max. cycles		15 000									
Kapazität / capacity	ml	250	10	30	25	50	94	85	85	15	5 ml
Maße / dimensions	∅ x L mm	61,5 x 122	16 x 80	26 x 95	24 x 100	29 x 107	38 x 110	38 x 106	38 x 102	17 x 100	12 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	48	18	6	6	6	6	42	72	
Drehzahl / speed	RPM	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*	8500 (9500)*
RZB / RCF	³⁾	11228 (14025)*	10743 (13420)*	10339 (12915)*	9693 (12108)*	9855 (12310)*	9855 (12310)*	9855 (12310)*	10662 (13319)*	10420 (13016)*	
Radius / radius	mm	139	133	128	120	122	122	122	132	129	
 9 (97%)	sec	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	98 / (115)*	
 9	sec	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	105 (120)*	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	7									
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	21									

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrenherstellers beachten.

* (nur bei Kühlzentrifuge)

12) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

15) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

* (only with cooling centrifuges)

12) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

15) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.